

1/110



**1.0 Fabricante do Produto:**

**Erimar Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Eireli**

**CNPJ:** 11.463.608/0001-79

**Endereço:** Rua Antonio Siloti, nº 495, Miniparque Industrial, CEP 85.935-000, Assis Chateaubriand, Paraná.

**Fone:**(44)3528-2540

**E-mail:** vendas@erimax.com.br

**Home Page:** www.erimax.com.br

**Responsável Técnico:** Pâmella Tatiane de Almeida Cazaqui – COREN PR 000.365.415

**CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:**

**1.1 Nome técnico do produto:**

Atadura de crepom, não estéril.

**1.2 Apresentação Comercial do Produto:**

Atadura crepom, 06cm x1,20mt  
Atadura crepom, 08cm x1,20mt  
Atadura crepom, 10cm x1,20mt  
Atadura crepom, 12cm x1,20mt  
Atadura crepom, 15cm x1,20mt  
Atadura crepom, 20cm x1,20mt  
Atadura crepom, 25cm x1,20mt  
Atadura crepom, 30cm x1,20mt

Atadura crepom, 06cm x1,80mt  
Atadura crepom, 08cm x1,80mt  
Atadura crepom, 10cm x1,80mt  
Atadura crepom, 12cm x1,80mt  
Atadura crepom, 15cm x1,80mt  
Atadura crepom, 20cm x1,80mt  
Atadura crepom, 25cm x1,80mt  
Atadura crepom, 30cm x1,80mt

Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente tecido 100% algodão. Produto embalado em material Filme BOPP 100% virgem coex. Fios: 13 Fios e 18 Fios por cm2.

**1.3 Registro Regulamentador:**

As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme a RDC 185/2021 - Registro pela ANVISA/MS. Cadastro nº 80698130001

**1.4 Descrição Geral do Produto:**

A atadura de crepom/crepe Erimax é utilizada em terapia compressiva, aplicações ortopédicas como imobilizações e enfeixamentos, fixação de curativos e prevenção de contusões em atividades esportivas.



#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

Recomenda-se uso por pessoas habilitadas na área de ortopedia e fisioterapia; Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido e verificando a largura da atadura de acordo com o diâmetro da superfície do corpo a ser enfaixada; Realize a limpeza e secagem da pele onde a Atadura de Crepom será aplicada; Aplique a atadura, fixando a parte inicial para que a atadura não solte; A Atadura de Crepom deve ser aplicada esticada, deixando-a sem pregas e rugas, evitando assim que se crie qualquer tipo de escoriação na pele ou desconforto durante o uso; A cada volta, cubra apenas de 1/2 a 1/3 da Atadura de Crepom; Não deve ser exercida força na hora da aplicação. A Atadura de Crepom não deve fazer grande compressão no membro a que foi aplicada, evitando problemas circulatórios. Deixar sempre que possível a extremidade do membro descoberta, a fim de verificar as condições de circulação sanguínea; Fazer uma pequena dobra na extremidade terminal para realizar a fixação; Realize a fixação utilizando o Esparadrapo; Em caso de eventual irritação causada pelo uso da Atadura de Crepom, suspender o uso e procurar auxílio médico imediato.

#### **PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, VALIDADE E REUTILIZAÇÃO:**

Não utilize a atadura de crepom diretamente sobre a pele ferida; não pressione a atadura de crepom ao aplicá-la, a fim de evitar problemas circulatórios; não utilizar caso a embalagem esteja violada. O fabricante recomenda uso único. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico. Este produto deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. As Ataduras de Crepom possuem **5 anos**.

#### **O fabricante recomenda uso único.**

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

O produto deve ser armazenado nas seguintes condições: Em local seco e arejado; Em locais onde o acesso de raios solares é restrito; A embalagem deve estar protegida contra danos físicos; embalagem deve estar protegida contra intempéries; Deve evitar fontes de ignição. Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o armazenamento da Atadura de Crepom. Sendo assim, pode ser armazenado em ambientes sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima.

Devem-se estabelecer critérios para assegurar o transporte seguro e adequado evitando trocas, avarias, deterioração ou outros efeitos adversos nos produtos nas seguintes condições: Conservação e limpeza do caminhão; Controle de Pragas; Quantidades de volumes.

Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o transporte da Atadura de Crepom. Sendo assim, pode ser transportado em veículos sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima.

#### **DESCARTE:**

O descarte do produto deve seguir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, para manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC N° 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 – que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.

8/11/11



#### 1.0 Fabricante do Produto:

**Erimar Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Eireli**

CNPJ: 11.463.608/0001-79

Endereço: Rua Antonio Siloti, nº 495, Miniparque Industrial, CEP 85.935-000, Assis Chateaubriand, Paraná.

Fone:(44)3528-2540

E-mail: vendas@erimax.com.br

Home Page: www.erimax.com.br

Responsável Técnico: Pâmella Tatiane de Almeida Cazaqui – COREN PR 000.365.415

#### CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

##### 1.1 Nome técnico do produto:

Atadura de crepom, não estéril,

##### 1.2 Apresentação Comercial do Produto:

Atadura crepom, 06cm x1,20mt  
Atadura crepom, 08cm x1,20mt  
Atadura crepom, 10cm x1,20mt  
Atadura crepom, 12cm x1,20mt  
Atadura crepom, 15cm x1,20mt  
Atadura crepom, 20cm x1,20mt  
Atadura crepom, 25cm x1,20mt  
Atadura crepom, 30cm x1,20mt

Atadura crepom, 06cm x1,80mt  
Atadura crepom, 08cm x1,80mt  
Atadura crepom, 10cm x1,80mt  
Atadura crepom, 12cm x1,80mt  
Atadura crepom, 15cm x1,80mt  
Atadura crepom, 20cm x1,80mt  
Atadura crepom, 25cm x1,80mt  
Atadura crepom, 30cm x1,80mt

Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente tecido 100% algodão. Produto embalado em material Filme BOPP 100% virgem coex. Fios: 13 Fios e 18 Fios por cm2.

##### 1.3 Registro Regulamentador:

As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme a RDC 185/2021 - Registro pela ANVISA/MS. Cadastro nº 80698130001

##### 1.4 Descrição Geral do Produto:

A atadura de crepom/crepe Erimax é utilizada em terapia compressiva, aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, fixação de curativos e prevenção de contusões em atividades esportivas.



#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

Recomenda-se uso por pessoas habilitadas na área de ortopedia e fisioterapia; Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido e verificando a largura da atadura de acordo com o diâmetro da superfície do corpo a ser enfaixada; Realize a limpeza e secagem da pele onde a Atadura de Crepom será aplicada; Aplique a atadura, fixando a parte inicial para que a atadura não solte; A Atadura de Crepom deve ser aplicada esticada, deixando-a sem pregas e rugas, evitando assim que se crie qualquer tipo de escoriação na pele ou desconforto durante o uso; A cada volta, cubra apenas de 1/2 a 1/3 da Atadura de Crepom; Não deve ser exercida força na hora da aplicação. A Atadura de Crepom não deve fazer grande compressão no membro a que foi aplicada, evitando problemas circulatórios. Deixar sempre que possível a extremidade do membro descoberta, a fim de verificar as condições de circulação sanguínea; Fazer uma pequena dobra na extremidade terminal para realizar a fixação; Realize a fixação utilizando o Esparadrapo; Em caso de eventual irritação causada pelo uso da Atadura de Crepom, suspender o uso e procurar auxílio médico imediato.

#### **PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, VALIDADE E REUTILIZAÇÃO:**

Não utilize a atadura de crepom diretamente sobre a pele ferida; não pressione a atadura de crepom ao aplicá-la, a fim de evitar problemas circulatórios; não utilizar caso a embalagem esteja violada. O fabricante recomenda uso único. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico. Este produto deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. As Ataduras de Crepom possuem **5 anos**.

O fabricante recomenda uso único.

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

O produto deve ser armazenado nas seguintes condições: Em local seco e arejado; Em locais onde o acesso de raios solares é restrito; A embalagem deve estar protegida contra danos físicos; embalagem deve estar protegida contra intempéries; Deve evitar fontes de ignição. Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o armazenamento da Atadura de Crepom. Sendo assim, pode ser armazenado em ambientes sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima.

Devem-se estabelecer critérios para assegurar o transporte seguro e adequado evitando trocas, avarias, deterioração ou outros efeitos adversos nos produtos nas seguintes condições: Conservação e limpeza do caminhão; Controle de Pragas; Quantidades de volumes.

Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o transporte da Atadura de Crepom. Sendo assim, pode ser transportado em veículos sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima.

#### **DESCARTE:**

O descarte do produto deve seguir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, para manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 – que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.



8/2 D

**INSTRUÇÃO DE USO  
PHARMAPAD CARBON SILVER**

Curativo absorvente não aderente com prata e carvão ativado



**Descrição**

O Pharmapad Carbon Silver é um curativo formado por 5 camadas, sendo uma camada de carvão ativado prensado entre 2 camadas de lã absorvente. Os 2 lados exteriores do curativo são cobertos com filme PE contendo íons de prata não aderente. A camada de carvão ativado é responsável pela adsorção de odores fétidos, as 2 camadas de lã absorventes são responsáveis pela absorção do exsudato, as camadas não aderentes de PE contendo íons de prata são responsáveis pela proteção da ferida, impedindo que a camada absorvente grude na mesma e agindo como uma barreira antimicrobiana que impede a colonização de microrganismos no curativo, aumentando assim o tempo de uso e propiciando um efeito profilático contra a infecção, especialmente no caso de feridas com alto risco de infecção. Os íons de prata contidos no curativo não são migratórios. Quando o curativo contendo prata foi testado para a zona de inibição, não houve inibições do crescimento em torno da amostra, mas apenas sob a amostra. Isso significa que os íons de prata não vazam da base e atuam apenas na superfície do curativo quando entram em contato com os microrganismos.

**Composição**

Tecido não tecido de viscose/poliamida, tecido não tecido de carvão ativado e camada perfurada não aderente de filme de polietileno com prata.

**Apresentação comercial**

O curativo Pharmapad Carbon Silver é embalado em envelope de papel grau cirúrgico e papel laminado com filme PE.

Cada envelope contém 1 (um) curativo.

O produto é esterilizado por óxido de etileno.

O curativo Pharmapad Carbon Silver possui os seguintes modelos comerciais:

| Modelo (Código) | Conteúdo       | Apresentação comercial |
|-----------------|----------------|------------------------|
| Pad C Ag 5050   | 5 cm x 5 cm    | 100/caixa              |
| Pad C Ag 5010   | 5 cm x 10 cm   | 100/caixa              |
| Pad C Ag 5075   | 5 cm x 7,5 cm  | 100/caixa              |
| Pad C Ag 7510   | 7,5 cm x 10 cm | 100/caixa              |
| Pad C Ag 7515   | 7,5 cm x 15 cm | 50/caixa               |
| Pad C Ag 7520   | 7,5 cm x 20 cm | 50/caixa               |
| Pad C Ag 1010   | 10 cm x 10 cm  | 50/caixa               |
| Pad C Ag 1015   | 10 cm x 15 cm  | 50/caixa               |
| Pad C Ag 1020   | 10 cm x 20 cm  | 40/caixa               |

**Indicações**

Pharmapad Carbon Silver é um curativo primário de tecido não tecido que promove a absorção rápida e controlada de exsudatos leves. É indicado para feridas superficiais como queimaduras e abrasões de espessura parcial, feridas cirúrgicas fechadas com bordas aproximadas; feridas pós-operatórias; úlceras arteriais de espessura parcial; úlceras por pressão em estágio I. A camada de carvão ativado presente na sua composição tem a função de adsorver os odores e a camada de prata age como uma barreira antimicrobiana que impede a colonização de microrganismos no curativo, aumentando assim o tempo de uso e propiciando um efeito profilático contra a infecção, especialmente no caso de feridas com alto risco de infecção. Para feridas altamente exsudativa deve ser utilizado em conjunto com um curativo secundário absorvente, como uma gaze, espuma ou um curativo adesivo não-tecido.

**Contraindicações**

Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte

- a) **Precauções:** Nenhuma pomada antimicrobiana deve ser usada, pois isso interfere com as propriedades antimicrobianas da prata.
- b) **Restrições:** Não se aplica
- c) **Advertências:** Uso Único – Descartar após o Uso – Produto Estéril.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. **Tempo máximo de permanência no paciente:** O Pharmapad Carbon Silver é eficaz por até 7 dias, mas os profissionais de saúde devem ser advertidos a trocar os curativos quando os mesmos estiverem sem prata. Quando utilizados em feridas muito exsudativas, orienta-se troca a cada 3 dias, devido à saturação da camada de carvão.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

#### Instruções de utilização

1. Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo interno.
2. Abrir a embalagem do produto.
3. Aplicar o curativo Pharmapad Carbon Silver no local desejado. O curativo pode ser cortado conforme necessário.
4. Fixar o curativo sobre a pele com a ajuda de um curativo secundário, como por exemplo, fita adesiva, esparadrapo ou filme adesivo.

#### Segurança e eficácia

O produto Pharmapad Carbon Silver é considerado seguro conforme resultados dos testes de biocompatibilidade realizados em conformidade com a norma ISO 10993. Os resultados do teste indicam que o produto possui uma boa biocompatibilidade, onde todos os resultados se encontram dentro das especificações e não mostraram indicação de liberação de concentrações significativas de substâncias citotóxicas.

#### Validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em local seco, temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

#### Descarte

O produto deve ser descartado em ambiente adequado, conforme Resolução RDC 306 de 07/12/2004.

#### PRODUTO ESTÉRIL

ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE

PRODUTO. DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

DESCARTAR A EMBALAGEM APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Não reutilize o produto. A reutilização pode representar risco de infecção.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.

Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.

Lote, Data de fabricação e Data de validade: Vide embalagem

Registro ANVISA: MS 81606090040

Fabricante: Pharmaplast S.A.E.; Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria, Egypt.

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME

Avenida Barão Homem de Melo 4500 Salas 1122/1123 – Estoril – Belo Horizonte/MG

CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | contato@goldmedimport.com.br

CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | Pharmapad Carbon Silver                             |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| Pad C Ag 2040         |
| Pad C Ag 4040         |
| Pad C Ag 5010         |
| Pad C Ag 5050         |
| Pad C Ag 5075         |
| Pad C Ag 7510         |
| Pad C Ag 7515         |
| Pad C Ag 7575         |
| Pad C Ag 9595         |
| Pad C Ag 2030         |
| Pad C Ag 520          |
| Pad C Ag 1010         |
| Pad C Ag 1015         |
| Pad C Ag 1020         |
| Pad C Ag 105105       |
| Pad C Ag 1520         |
| Pad C Ag 2020         |
| Pad C Ag 3040         |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                                     | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Pharmapad Carbon Silver Instrução de Uso.pdf | 4288539218 - 29/10/2021 15:49:03    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Nome Técnico     | Curativo          |
| Registro         | 81606090040       |
| Processo         | 25351513731201980 |
| Fabricante Legal | PHARMAPLAST S.A.E |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Classificação de Risco</b> | III - ALTO RISCO        |
| <b>Vencimento do Registro</b> | 20/04/2030              |
| <b>Situação</b>               | [sem dados cadastrados] |
| <b>Data de Publicação</b>     | [sem dados cadastrados] |



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

10/1/21



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | PHARMA ALGI F                                       |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| PAD ALGI F 1010       |
| PAD ALGI F 1015       |
| PAD ALGI F 1020       |
| PAD ALGI F 230 cavity |
| PAD ALGI F 240 CAVITY |
| PAD ALGI F 5010       |
| PAD ALGI F 5050       |
| PAD ALGI F 5075       |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                                 | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Pharma-Algi F Instrução Uso Produto .pdf | 4403195211 - 08/11/2021 12:43:20    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nome Técnico           | Curativo                |
| Registro               | 81606090044             |
| Processo               | 25351678904201912       |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E.      |
| Classificação de Risco | III - ALTO RISCO        |
| Vencimento do Registro | 22/06/2030              |
| Situação               | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados] |

*[Handwritten signature]*

**INSTRUÇÃO DE USO PHARMA-ALGI F**  
Curativo hemostático absorvente com alginato de cálcio

**Descrição**

O Pharma-Algi F é um curativo estéril, não adesivo, em placa ou fita, macio, de tonalidade marrom, composto de não tecido impregnado com de Alginato de Cálcio, que são cardadas e perfuradas com agulha para formar um não tecido de ação hemostática e absorvente. O efeito hemostático é obtido pela troca de íons cálcio-sódio, onde os íons de cálcio se depositam na ferida, provocando uma reação com o sódio presente no exsudato e no sangue da ferida, resultando na formação de um gel que mantém o meio úmido para a cicatrização e induz a hemostasia, o debridamento autolítico e a granulação. Possui elevada capacidade de absorção, impedindo a fuga de exsudatos da ferida devido ao gel que se forma, impedindo assim a maceração da pele e favorecendo ao processo de cicatrização. O curativo se adapta ao contorno da ferida e impede a adesão do curativo aos tecidos recém-formados. O curativo Pharma-Algi F necessita de adesivo secundário, como por exemplo, fita adesiva, filme adesivo, para manter o mesmo no local da ferida. O adesivo secundário não acompanha o produto.

**Composição**

Fibras de alginato de cálcio.

**Apresentação comercial**

O curativo Pharma-Algi F é embalado em envelope de papel grau cirúrgico.

Cada envelope contém 1 (um) curativo.

O produto é esterilizado por óxido de etileno.

O curativo Pharma-Algi F possui os seguintes modelos comerciais:

| <b>Modelo (Código)</b>       | <b>Dimensões</b> |
|------------------------------|------------------|
| Pad Algi F 5050              | 5 cm x 5 cm      |
| Pad Algi F 5075              | 5 cm x 7,5 cm    |
| Pad Algi F 1010              | 10 cm x 10 cm    |
| Pad Algi F 1015              | 10 cm x 15 cm    |
| Pad Algi F 1020              | 10 cm x 20 cm    |
| Pad Algi F 5010              | 5 cm x 10 cm     |
| Pad Algi F 230 cavity – Fita | 2 x 30 cm        |
| Pad Algi F 240 cavity – Fita | 2 x 40 cm        |

**Indicações**

O produto é um curativo primário composto de fibras de alginato, utilizado para o tratamento de feridas superficiais e profundas, com exsudatos moderados e intensos, que podem também ter tendência para pequenas hemorragias. Pode ser usado em: feridas de pressão, úlceras na perna, úlceras diabéticas e isquêmicas, feridas pós-operatórias, locais de doação para enxerto de pele.

**Contraindicações**

Não utilizar em pacientes com alergia a alginatos. Não utilizar em ferida superficiais com pouca ou nenhuma secreção ou com tecido necrosado. Não utilizar em queimaduras. Não se destina para uso como esponja cirúrgica ou a obter hemostasia em feridas com sangramento intenso. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo interno.

**Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte**

- Precauções:** O curativo pode aderir se utilizado em feridas com pouco exsudato. Poderá lesar as bordas da ferida devido a sua função autolítica.
- Restrições:** Não se aplica.
- Advertências:** Uso Único – Descartar após o Uso - Produto Estéril – Proibido Reprocessar.
- Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.
- Armazenamento** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.



- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.



#### Instruções de uso

1. Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição.
2. Abrir a embalagem do produto.
3. Aplicar o curativo Pharma-Algi F no local desejado. O curativo pode ser cortado conforme desejado. Modelar o curativo no interior da ferida, umedecendo a fibra com solução fisiológica se necessário. Não deixar que a fibra ultrapasse a borda da ferida.
4. Fixar o curativo sobre a pele com a ajuda de um curativo secundário preferencialmente estéril. Trocar o curativo secundário sempre que estiver saturado.
5. O curativo pode permanecer por até sete dias ou até saturar em feridas limpas ou com elevado exsudato, porém em feridas infectadas trocar a cada 24 horas e em feridas limpas com sangramento trocar a cada 48 horas. A indicação para o tempo de troca deverá ser de responsabilidade de um profissional de saúde.

#### Segurança e Eficácia

O produto Pharma-Algi F é considerado seguro conforme resultados dos testes de biocompatibilidade realizados em conformidade com a norma ISO 10993. Os resultados do teste indicam que o produto possui uma boa biocompatibilidade, onde todos os resultados se encontram dentro das especificações e não mostraram indicação de liberação de concentrações significativas de substâncias citotóxicas.

Tabela 1 – Especificações Finais do Produto

| Teste                         | Especificação |
|-------------------------------|---------------|
| Gramatura (g/m <sup>2</sup> ) | 160±20%       |
| Capacidade de absorção (%)    | ≥ 1400%       |
| Tempo de absorção (seg.)      | 4±1           |
| Taxa de absorção (mm/seg.)    | ≥ 1.2         |
| Força de vedação (N/15mm)     | ≥ 1.2         |

#### Validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

#### PRODUTO ESTÉRIL

**ARMAZENAR EM LOCAL SECO E TEMPERATURA AMBIENTE**

**PRODUTO DE USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO**

**Não reutilize o produto. A reutilização pode representar risco de infecção.**

**Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.**

**Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.**

Lote: Vide embalagem

Data de fabricação: Vide embalagem

Data de validade: Vide embalagem

Fabricante: Pharmaplast S.A.E. Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria, Egypt.

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME Avenida Barão Homem de Melo 4.444, Bloco II, Sala 601 – Estoril – Belo Horizonte/MG CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | contato@goldmedimport.com.br CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120

Registro ANVISA: MS 81606090044



# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



11/8/21

| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | PHARMA ALGI F                                       |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| PAD ALGI F 1010       |
| PAD ALGI F 1015       |
| PAD ALGI F 1020       |
| PAD ALGI F 230 cavity |
| PAD ALGI F 240 CAVITY |
| PAD ALGI F 5010       |
| PAD ALGI F 5050       |
| PAD ALGI F 5075       |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                                 | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Pharma-Algi F Instrução Uso Produto .pdf | 4403195211 - 08/11/2021 12:43:20    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nome Técnico           | Curativo                |
| Registro               | 81606090044             |
| Processo               | 25351678904201912       |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E.      |
| Classificação de Risco | III - ALTO RISCO        |
| Vencimento do Registro | 22/06/2030              |
| Situação               | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados] |

Handwritten signature

**INSTRUÇÃO DE USO PHARMA-ALGI F**  
Curativo hemostático absorvente com alginato de cálcio

**Descrição**

O Pharma-Algi F é um curativo estéril, não adesivo, em placa ou fita, macio, de tonalidade marrom, composto de não tecido impregnado com de Alginato de Cálcio, que são cardadas e perfuradas com agulha para formar um não tecido de ação hemostática e absorvente. O efeito hemostático é obtido pela troca de íons cálcio-sódio, onde os íons de cálcio se depositam na ferida, provocando uma reação com o sódio presente no exsudato e no sangue da ferida, resultando na formação de um gel que mantém o meio úmido para a cicatrização e induz a hemostasia, o debridamento autolítico e a granulação. Possui elevada capacidade de absorção, impedindo a fuga de exsudatos da ferida devido ao gel que se forma, impedindo assim a maceração da pele e favorecendo ao processo de cicatrização. O curativo se adapta ao contorno da ferida e impede a adesão do curativo aos tecidos recém-formados. O curativo Pharma-Algi F necessita de adesivo secundário, como por exemplo, fita adesiva, filme adesivo, para manter o mesmo no local da ferida. O adesivo secundário não acompanha o produto.

**Composição**

Fibras de alginato de cálcio.

**Apresentação comercial**

O curativo Pharma-Algi F é embalado em envelope de papel grau cirúrgico.

Cada envelope contém 1 (um) curativo.

O produto é esterilizado por óxido de etileno.

O curativo Pharma-Algi F possui os seguintes modelos comerciais:

| <b>Modelo (Código)</b>       | <b>Dimensões</b> |
|------------------------------|------------------|
| Pad Algi F 5050              | 5 cm x 5 cm      |
| Pad Algi F 5075              | 5 cm x 7.5 cm    |
| Pad Algi F 1010              | 10 cm x 10 cm    |
| Pad Algi F 1015              | 10 cm x 15 cm    |
| Pad Algi F 1020              | 10 cm x 20 cm    |
| Pad Algi F 5010              | 5 cm x 10 cm     |
| Pad Algi F 230 cavity – Fita | 2 x 30 cm        |
| Pad Algi F 240 cavity – Fita | 2 x 40 cm        |

**Indicações**

O produto é um curativo primário composto de fibras de alginato, utilizado para o tratamento de feridas superficiais e profundas, com exsudatos moderados e intensos, que podem também ter tendência para pequenas hemorragias. Pode ser usado em: feridas de pressão, úlceras na perna, úlceras diabéticas e isquêmicas, feridas pós-operatórias, locais de doação para enxerto de pele.

**Contraindicações**

Não utilizar em pacientes com alergia a alginatos. Não utilizar em ferida superficiais com pouca ou nenhuma secreção ou com tecido necrosado. Não utilizar em queimaduras. Não se destina para uso como esponja cirúrgica ou a obter hemostasia em feridas com sangramento intenso. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo interno.

**Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte**

- Precauções:** O curativo pode aderir se utilizado em feridas com pouco exsudato. Poderá lesar as bordas da ferida devido a sua função autolítica.
- Restrições:** Não se aplica.
- Advertências:** Uso Único – Descartar após o Uso - Produto Estéril – Proibido Reprocessar.
- Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.
- Armazenamento** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.



- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

#### Instruções de uso

1. Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição.
2. Abrir a embalagem do produto.
3. Aplicar o curativo Pharma-Algi F no local desejado. O curativo pode ser cortado conforme desejado. Modelar o curativo no interior da ferida, umedecendo a fibra com solução fisiológica se necessário. Não deixar que a fibra ultrapasse a borda da ferida.
4. Fixar o curativo sobre a pele com a ajuda de um curativo secundário preferencialmente estéril. Trocar o curativo secundário sempre que estiver saturado.
5. O curativo pode permanecer por até sete dias ou até saturar em feridas limpas ou com elevado exsudato, porém em feridas infectadas trocar a cada 24 horas e em feridas limpas com sangramento trocar a cada 48 horas. A indicação para o tempo de troca deverá ser de responsabilidade de um profissional de saúde.

#### Segurança e Eficácia

O produto Pharma-Algi F é considerado seguro conforme resultados dos testes de biocompatibilidade realizados em conformidade com a norma ISO 10993. Os resultados do teste indicam que o produto possui uma boa biocompatibilidade, onde todos os resultados se encontram dentro das especificações e não mostraram indicação de liberação de concentrações significativas de substâncias citotóxicas.

Tabela 1 – Especificações Finais do Produto

| Teste                         | Especificação |
|-------------------------------|---------------|
| Gramatura (g/m <sup>2</sup> ) | 160±20%       |
| Capacidade de absorção (%)    | ≥ 1400%       |
| Tempo de absorção (seg.)      | 4±1           |
| Taxa de absorção (mm/seg.)    | ≥ 1.2         |
| Força de vedação (N/15mm)     | ≥ 1.2         |

#### Validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

**PRODUTO ESTÉRIL**  
**ARMAZENAR EM LOCAL SECO E TEMPERATURA AMBIENTE**  
**PRODUTO DE USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO**  
**Não reutilize o produto. A reutilização pode representar risco de infecção.**  
**Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.**  
**Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.**

Lote: Vide embalagem

Data de fabricação: Vide embalagem

Data de validade: Vide embalagem

Fabricante: Pharmaplast S.A.E. Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria, Egypt.

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME Avenida Barão Homem de Melo 4.444, Bloco II, Sala 601 – Estoril – Belo Horizonte/MG CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | contato@goldmedimport.com.br CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120

Registro ANVISA: MS 81606090044



13/8 D/



### Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | FIBROSOL NON ADHESIVE                               |

| Modelo Produto Médico                            |
|--|
| Fibrosol Non Adhesive: Fib 5050                  |
| Fib 68   |
| Fib 75   |
| Fib 76   |
| Fib 1010   |
| Fib 1012   |
| Fib 1015   |
| Fib 1020   |
| Fib 1025 Fib 1030                                |
| Fib 1515   |
| Fib 16518  |
| Fib 2222   |
| Fib 245. Fibrosol Extra Non Adhesive: FibEx 5050 |
| FibEx 68   |
| FibEx 75   |
| FibEx 76   |
| FibEx 1010                                       |
| FibEx 1012                                       |
| FibEx 1015                                       |
| FibEx 1020                                       |
| FibEx 1025                                       |
| FibEx 1030                                       |
| FibEx 1515                                       |
| FibEx 16518                                      |
| FibEx 2222                                       |
| FibEx 245  |

*[Handwritten signature]*

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|   |   |                                  |
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Instrução Uso - Fibrosol Non-Adhesive.pdf | 4442400229 - 19/07/2022 08:45:23 |

|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| Nome Técnico           | Curativo                |  |
| Registro               | 81606090061             |  |
| Processo               | 25351041590202112       |  |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E       |  |
| Classificação de Risco | III - ALTO RISCO        |  |
| Vencimento do Registro | 13/06/2032              |  |
| Situação               | [sem dados cadastrados] |  |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados] |  |

**INSTRUÇÃO DE USO  
 FIBROSOL NON ADHESIVE**

Curativo não aderente superabsorvente de hidrofibra

**Descrição:**

Curativos primário constituídos de fibras de carboximetilcelulose, que são cardadas e perfuradas para produzir um tecido não tecido. Esta fibra possui a capacidade de absorver o exsudato quando em contato com a ferida que é rapidamente retido em sua estrutura e convertido para um gel macio. Desta forma, cria-se um ambiente úmido, favorecendo a cicatrização e auxiliando no desbridamento autolítico. Pode ser facilmente removido com pouco ou nenhum dano ao tecido recém-formado. O modelo Extra possui camada dupla que dá suporte à camada de hidrofibra após a formação do gel.

**Composição:**

Fibras de carboximetilcelulose, cardadas e perfuradas para produzir um tecido não tecido, contendo fio de sustentação na dupla camada.

**Apresentação comercial:**

Os curativos são embalados em papel adesivo de selagem térmica/laminado PE ou PET/PE e papel envernizado quadriculado. Cada envelope contém 1 (um) curativo.

O produto é esterilizado por óxido de etileno.

Fibrosol Non Adhesive possui os seguintes modelos comerciais:

| Fibrosol Non Adhesive | Fibrosol Extra Non Adhesive | Dimensões       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Fib 5050              | FibEx 5050                  | 5 cm x 5 cm     |
| Fib 1010              | FibEx 1010                  | 10 cm x 10 cm   |
| Fib 1015              | FibEx 1015                  | 10 cm x 15 cm   |
| Fib 1020              | FibEx 1020                  | 10 cm x 20 cm   |
| Fib 1025              | FibEx 1025                  | 10 cm x 25 cm   |
| Fib 1030              | FibEx 1030                  | 10 cm x 30 cm   |
| Fib 1515              | FibEx 1515                  | 15 cm x 15 cm   |
| Fib 16518             | FibEx 16518                 | 16,5 cm x 18 cm |
| Fib 2222              | FibEx 2222                  | 22 cm x 22 cm   |
| Fib 245               | FibEx 245                   | 2 cm x 45 cm    |

**Indicações:**

Indicado para manejo de feridas exsudativas, queimaduras de segundo grau, úlceras de pés diabéticos, lesão por pressão, úlceras de perna, feridas cirúrgicas, feridas traumáticas, feridas com tendência a hemorragias, feridas oncológicas, locais de enxerto.

**Contraindicações:**

Não deve ser utilizado por pessoas com alergia à carboximetilcelulose. Não usar em queimaduras de terceiro grau, músculos e ossos.

**Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte:**

- Precauções:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Realizar controle da glicemia para monitorar as úlceras do pé diabético. Vasos sanguíneos recém-formados e delicados podem produzir exsudatos com sangue.
- Restrições:** Não se aplica.
- Advertências:** Uso Único – Descartar após o Uso - Produto Estéril.
- Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.
- Armazenamento:** O produto deve ser mantido em temperatura de 0°C a 40°C (conforme estudo de estabilidade), em local seco (umidade relativa a ≤ 75%), fresco e ao abrigo da luz.
- Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de armazenamento.



**Instruções de utilização:**

1. Higienize as mãos. Realizar a limpeza da ferida e secar bem a pele ao redor.
2. Abrir a embalagem do curativo.
3. Aplicar o curativo Fibrosol Non Adhesive no local desejado. Deve-se selecionar um curativo que se sobreponha à margem da ferida em pelo menos 1 cm (um centímetro).
4. Em caso de feridas profundas, preencher pelo menos 80% (oitenta por cento) e deixar pelo menos 2,5 cm (dois centímetros e meio) do curativo à margem da ferida;
5. Fixar sobre o curativo Fibrosol Non Adhesive a um curativo secundário absorvente (não acompanha o produto).

**Remoção:**

1. O Fibrosol Non Adhesive pode permanecer sobre a ferida por até 7 dias.
2. Remover o curativo quando a ferida estiver prestes a fechar.
3. Remover o curativo quando indicado clinicamente.
4. Irrigue com soro fisiológico se ocorrer presença residual do curativo na ferida.

**Segurança e Eficácia:**

O produto Fibrosol Non Adhesive é considerado seguro conforme resultados dos testes de biocompatibilidade realizados em conformidade com a norma ISO 10993. Os resultados do teste indicam que o produto possui uma boa biocompatibilidade, onde todos os resultados se encontram dentro das especificações e não mostraram indicação de liberação de concentrações significativas de substâncias citotóxicas.

**Especificações Finais do Produto**

| Teste                         | Especificação         |                             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                               | Fibrosol Non Adhesive | Fibrosol Extra Non Adhesive |
| Gramatura (g/m <sup>2</sup> ) | 100±10                | 200±20                      |
| Espessura (mm)                | 1 ± 2                 | 2 ± 2                       |
| Capacidade de absorção (%)    | ≥ 2000                | ≥ 1500                      |
| Força de vedação (N/15mm)     | ≥1,2                  | ≥1,2                        |

**Validade:**

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em temperatura de 0°C a 40°C, em local seco (umidade relativa ≤75%), fresco e ao abrigo da luz.

**PRODUTO ESTÉRIL**  
**PRODUTO DE USO ÚNICO**

**Não reutilize o produto. A reutilização pode representar risco de infecção.**  
**Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.**  
**Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.**

Lote | Data de fabricação | Data de validade: Vide Embalagem

Fabricante: Pharmaplast S.A.E. Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria, Egypt.

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME Avenida Barão Homem de Melo 4444, Bloco II, Sala 601 – Estoril – Belo Horizonte/MG CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | contato@goldmedimport.com.br CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120

Registro ANVISA: MS 81606090061



# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

14/3/21



| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | ProMed Film   |

| Modelo Produto Médico             |
|-----------------------------------|
| PRFS 1012                         |
| PRFS 1015                         |
| PRFS 1020                         |
| PRFS 1025                         |
| PRFS 1030                         |
| PRFS 1515                         |
| PRFS 1520                         |
| PRFS 180165                       |
| PRFS 2020                         |
| PRFS 2030                         |
| PRFS 220220                       |
| PRFS 4545                         |
| PRFS 4867                         |
| PRFS 67                           |
| ProMed Film: Prot 76              |
| Prot 1012                         |
| Prot 1014                         |
| Prot 1016                         |
| Prot 7510                         |
| Prot 7512                         |
| Prot 755                          |
| Prot 825                          |
| Prot 8565                         |
| PFZ 67ADH 6 X 7 cm 100 /caixa     |
| PFZ 1010ADH 10 x 10 cm 100/ caixa |
| PFZ 1012ADH 10 x 12 cm 100/ caixa |
| PFZ 1515ADH 15 x 15 em 50/ caixa  |



|                                     |
|-------------------------------------|
| PFZ 2020ADH 20 x 20 cm 25/ caixa    |
| PFZ 67ADHSI 6 X 7 cm 100, caixa     |
| PFZ 1010ADHSI 10 x 10 cm 100/ caixa |
| PEZ 1012ADHSI 10 x 12 cm 100/ caixa |
| PFZ 1515ADHSI 15 x 15 cm 50/ caixa  |
| PFZ 2020ADHSI 20 x 20 cm 25/ caixa  |
| PRFS 7510 7.5 x 10 cm 100/ caixa    |
| Prot 1010 10 x 10 cm 150/ caixa     |
| Prot 1015 10 x 15 em 150/ caixa     |
| Prot 1025 10 x 25 cm 75/ caixa      |
| Prot 1030 10 x 30 cm 75/ caixa      |
| Prot 1515 15 x 15 em 25/ caixa      |
| Prot 2020 20 x 20 cm 25/ caixa      |
| Prot 2030 20 x 30 cm 25/ caixa      |
| Prot 180165 18 x 16.5 cm 25/ caixa  |
| Prot 220220 22 x 22 cm 25/ caixa    |
| PFZ 18165-01FS                      |
| PFZ 18165-02.                       |
| PFZ 2020-01FS                       |
| PFZ 2020-02                         |
| PFZ 2030-01FS                       |
| PFZ 2030-02                         |
| PFZ 2222-01FS                       |
| PFZ 2222-02                         |
| PFZ 4545-01FS                       |
| PFZ 4545-02                         |
| PFZ 4867-01FS                       |
| PFZ 1515-01FS                       |
| PFZ 1515-02                         |
| PFZ 1520-01FS                       |
| PFZ 1520-02                         |
| PFZ 4867-02                         |
| PFZ 67-01FS                         |
| PFZ 67-02                           |
| PRFS 1010                           |
| PFZ 1010-02                         |
| PFZ 1010-01FS                       |
| PFZ 1012-01FS                       |



|               |
|---------------|
| PFZ 1012-02   |
| PFZ 1015-01FS |
| PFZ 1015-02   |
| PFZ 1020-01FS |
| PFZ 1020-02   |
| PFZ 1025-01FS |
| PFZ 1025-02   |
| PFZ 1030-01FS |
| PFZ 1030-02   |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                         | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | ProMed Film Instrução de Uso.pdf | 4269754214 - 28/10/2021 15:32:29    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nome Técnico           | Curativo                |
| Registro               | 81606090011             |
| Processo               | 25351756084201818       |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E.      |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO         |
| Vencimento do Registro | VIGENTE                 |
| Situação               | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados] |

## Instrução de Uso ProMed Film

### Representação gráfica

ProMed Film



ProMed Film Frame Style



ProMed Film 7000



### Descrição

Os curativos ProMed Film são transparentes, elásticos, adaptáveis, impermeáveis a líquidos e permeáveis ao vapor. Proporcionando um ambiente úmido ideal para o tratamento de lesões. Curativo estéril de proteção, em filme de poliuretano transparente, impermeável, elástico e adaptável, coberto com adesivo hipoalergênico. Possui alta taxa de transmissão de vapores úmido, é antibacteriano e à prova de vírus. Protege a pele de maceração, fácil de aplicar. Permite observar o processo de cicatrização sem remover o curativo. O paciente pode tomar banho sem risco de contaminação ou perda do curativo. O curativo pode ser deixado no local por até 7 dias, minimizando a interferência.

ProMed Film: filme transparente de poliuretano com forma quadriculada e adesivo hipoalergênico em todo o curativo.

ProMed Film Frame Style: filme transparente de poliuretano e adesivo hipoalergênico em todo o curativo.

ProMed Film 7000: filme transparente de poliuretano e adesivo hipoalergênico na borda do curativo (área central não adesiva).

### Apresentação comercial

| ProMed Film | Dimensões    | ProMed Film Frame Style | Dimensões    | ProMed Film 7000 | Dimensões  |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Prot 76     | 7x 6 cm      | PRFS 4545               | 4.5 x 4.5 cm | PFZ 67 ADHSI     | 6 x 7 cm   |
| Prot 755    | 7.5 x 5 cm   | PRFS 4867               | 7.5 x 5 cm   | PFZ 1010 ADHSI   | 10 x 10 cm |
| Prot 7510   | 7.5 x 10 cm  | PRFS 67                 | 6 x 7 cm     | PFZ 1012 ADHSI   | 10 x 12 cm |
| Prot 7512   | 7.5 x 12 cm  | PRFS 7510               | 7.5 x 10 cm  | PFZ 1515 ADHSI   | 15 x 15 cm |
| Prot 825    | 8.2 x 5 cm   | PRFS 1010               | 10 x 10 cm   | PFZ 2020 ADHSI   | 20 x 20 cm |
| Prot 8565   | 8.5 x 6.5 cm | PRFS 1012               | 10 x 12 cm   | PFZ 67 ADH       | 6 x 7 cm   |
| Prot 1010   | 10 x 10 cm   | PRFS 1015               | 10 x 15 cm   | PFZ 1010 ADH     | 10 x 10 cm |
| Prot 1012   | 10 x 12 cm   | PRFS 1020               | 10 x 20 cm   | PFZ 1012 ADH     | 10 x 12 cm |
| Prot 1014   | 10 x 14 cm   | PRFS 1025               | 10 x 25 cm   | PFZ 1515 ADH     | 15 x 15 cm |
| Prot 1016   | 10 x 16 cm   | PRFS 1030               | 10 x 30 cm   | PFZ 2020 ADH     | 20 x 20 cm |
| Prot 1015   | 10 x 15 cm   | PRFS 1515               | 15 x 15 cm   | -                | -          |
| Prot 1025   | 10 x 25 cm   | PRFS 1520               | 15 x 20 cm   | -                | -          |
| Prot 1030   | 10 x 30 cm   | PRFS 180165             | 18 x 16.5 cm | -                | -          |
| Prot 1515   | 15 x 15 cm   | PRFS 2020               | 20 x 20 cm   | -                | -          |
| Prot 2020   | 20 x 20 cm   | PRFS 220220             | 22 x 22 cm   | -                | -          |
| Prot 2030   | 20 x 30 cm   | -                       | -            | -                | -          |
| Prot 180165 | Côncavo      | -                       | -            | -                | -          |
| Prot 220220 | Sacral       | -                       | -            | -                | -          |

### Indicação

Curativo para tratamento primário e secundário de feridas secas e levemente secretantes. Fixação de cateteres intravenosos, cobertura para outros curativos.

### Contraindicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte:

- a) **Precauções:** Em caso de irritação, suspender o uso.
- b) **Restrições:** Não se aplica.
- c) **Advertências:** Produto estéril de uso único. Proibido reprocessamento.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.



#### Instrução de uso

Limpar o local em torno da ferida conforme protocolo da instituição. Abrir a embalagem de forma asséptica, retirar o papel protetor 1, aplicar sobre a ferida, fixar a 2 cm da borda da ferida, retirar o papel protetor 2, fazer leve pressão sobre as bordas do curativo e retirar o papel de reforço 3 (com ou sem grade).

**Produto esterilizado por gás óxido de etileno.**

**Data de fabricação validade e Lote:** Vide embalagem

**Cadastro ANVISA: Registro ANVISA:** MS 81606090011

Fabricante: Pharmaplast S.A.E.  
Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria,  
Egypt,

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME  
Avenida Barão Homem de Melo 4.444, Bloco II, Sala 601 – Estoril –  
Belo Horizonte/MG | CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619  
[comercial@goldmedimport.com.br](mailto:comercial@goldmedimport.com.br) | CNPJ: 28.215.470/0001-91  
Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120

90/3 D/



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | Pharmapro PU  |

| Modelo Produto Médico                                  |
|--|
| Fix PU 1010 (10 cm x 10m)                              |
| fix PU 1045 (10 cm x 4.55 m)                           |
| Fix PU 1050 (10cm x 5 m)                               |
| Fix PU 1091 (10cm x 9.14m)                             |
| Fix PU 1510 (15cm x 10m)                               |
| Fix PU 1545 (15 cm x 4.55m) Fix PU 2045 (20cm x 4.55m) |
| Fix PU 1550 (15 cm x 5m)                               |
| Fix PU 1591 (15cm x 9.14m)                             |
| Fix PU 2010 (20 cm x 10m)                              |
| Fix PU 2050 (20 cm x 5 m )                             |
| Fix PU 2091 (20cm x 9.14m)                             |
| Fix PU 2510 (2.5 cm x 10m)                             |
| Fix PU 2545 (2.5 cm x 4.55m)                           |
| Fix PU 2550 (2.5 cm x 5m)                              |
| Fix PU 2591 (2.5 cm x 9.14m)                           |
| Fix PU 3010 (30cm x 10m).                              |
| Fix PU 3045 (30 cm x 4.55m)                            |
| Fix PU 3050 (30 cm x 5 m)                              |
| Fix PU 3091 (30 cm x 9.14m)                            |
| Fix PU 5010 (5cm x 10 m)                               |
| Fix PU 5045 (5cm x 4.55m)                              |
| Fix PU 5050 (5cm x 5m)                                 |
| Fix PU 5091 (5cm x 9.14 m)                             |
| Fix PU 510 (5cm x 10m)                                 |
| Fix PU 7510 (7.5cm x 10m)                              |
| Fix PU 7545 (7.5 cm x 4.55 m)                          |
| Fix PU 7550 (7.5cm x 5 m)                              |

|                              |
|------------------------------|
| Fix PU 7591 (7.5 cm x 9.14m) |
| FIX PU 550                   |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                            | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Instrução de Uso - Pharmapro PU.pdf | 4442388229 - 19/07/2022 08:42:11    |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nome Técnico           | Esparadrapos e Fitas Adesivas |
| Registro               | 81606090002                   |
| Processo               | 25351824201201883             |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E             |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO               |
| Vencimento do Registro | VIGENTE                       |
| Situação               | [sem dados cadastrados]       |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados]       |





## Instrução de Uso

### Pharmapro PU

#### Descrição

Filme adesivo transparente em rolo, à prova d'água, não estéril, revestido com adesivo acrílico hipoalergênico. De fácil aplicação, é altamente flexível, conformável e pode ser recortado no tamanho desejado. Sua alta taxa de transmissão de vapores úmidos, 700g/m<sup>2</sup>/24hrs, evita o acúmulo de transpiração e fluidos sob o filme, é impermeável a líquidos e previne a contaminação bacteriana.

#### Composição

Filme de poliuretano e adesivo acrílico. Película branca: papel branco revestido de argila. Película quadriculada: silicone de polietileno.

#### Apresentação Comercial

O curativo Pharmapro PU é embalado em papel cartonado constituído por papel-cartão, folha de alumínio e plástico (polietileno). Possui os seguintes modelos comerciais:

Possui os seguintes modelos comerciais:

| Códigos    | Dimensões     | Códigos    | Dimensões     |
|------------|---------------|------------|---------------|
| Fix PU2550 | 2,5 x 500 cm  | Fix PU7510 | 7,5 x 1000 cm |
| Fix PU550  | 5 x 500 cm    | Fix PU1010 | 10 x 1000 cm  |
| Fix PU7550 | 7,5 x 500 cm  | Fix PU1510 | 15 x 1000 cm  |
| Fix PU1050 | 10 x 500 cm   | Fix PU2010 | 20 x 1000 cm  |
| Fix PU2510 | 2,5 x 1000 cm | Fix PU3010 | 30 x 1000 cm  |
| Fix PU510  | 5 x 100 cm    | -          | -             |

#### Indicação

Filme para retenção de curativos pós-operatórios, gases e curativos absorventes, para proteger cateteres, tubos ou drenos. Proteção para regiões de pressão e cisalhamento.

#### Contraindicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

#### Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte:

- Precauções:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável.
- Restrições:** Não se aplica.
- Advertências:** Produto não estéril em rolo, pode ser recortado no tamanho desejado e reutilizado.
- Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.
- Armazenamento:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

**Instrução de uso**

Limpar e secar a pele. Cortar o Pharmapro PU no tamanho desejado. Remover a película branca, do centro para as extremidades e, aplicar o filme sobre a pele exercendo delicada pressão sobre o mesmo, para garantir perfeita adesividade. Remover o filme de suporte.

**Segurança e eficácia**

Os resultados do teste de biocompatibilidade demonstraram conformidade de acordo com a especificação, não demonstrando indicação de liberação de concentrações citotóxicas da substância, conforme norma ISO 10993-5.

Os resultados do teste de sensibilidade foram negativos para sensibilização de contato tardia (dermatite alérgica de contato), conforme norma ISO 10993-10.

O teste de Bioburden é realizado rotineiramente pelo fabricante para monitoramento nas amostras dos produtos de acordo com a norma ISO 11737-1. Bioburden (carga microbiana) é definido como o número de microrganismos presentes em uma superfície que não tenha sido esterilizada.

**Condições de armazenamento**

Mantenha longe da luz e calor.  
Armazenar abaixo de 25 ° C.  
Evite qualquer choque térmico.

**Prazo de validade**

Prazo de validade de 05 anos.

**Fabricante:** Pharmaplast S.A.E. | Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria Egypt.

**Importador:** Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME

Avenida Barão Homem de Melo 4444 Bloco II, Sala 601 – Estoril – Belo Horizonte/MG

CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | E-mail: comercial@goldmedimport.com.br


CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120

Registro ANVISA: MS 81606090002

# PHARMAFIX<sup>®</sup> PU



890 / 10 D

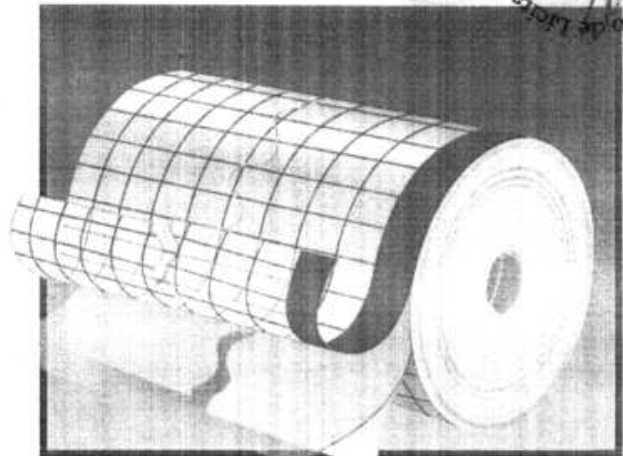

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Descrição:

Pharmafix PU é um curativo em filme transparente de poliuretano autoadesivo em rolo, flexível e moldável, recortável, hipoalérgico, livre de látex, impermeável a líquidos e fluidos corporais e semipermeável a trocas gasosas, promovendo barreira bacteriana e viral, com uma face adesiva de acrílate hipoalérgico suportado em papel siliconado e na face superior uma grade demarcadora destacável em toda extensão (planimétrica) com borda sem adesivo, permitindo uma fácil aplicação sobre os mais diversos tipos de dispositivos, curativos, tubos e cateteres.

### Composição:

Elaborado a base de poliuretano de alta permeabilidade e revestido em um dos lados com adesivo hipoalérgico, possui adesão de longa duração e tem como ganho em relação às fitas comuns, não causar trauma a região durante sua remoção.

### Indicações:

- Proteção e retenção de curativos primários e secundários ou curativos de baixa aderência;
- Fixação de tubulação e/ou dreno;
- Fixação de dispositivos de ostomia, bolsas, etc.;
- Prevenção de úlceras por pressão;
- Prevenção de infecções e proteção de tatuagens recentes;



### Benefícios:

- A sua elevada permeabilidade ao vapor de água impede o acúmulo de umidade da transpiração e de fluidos sobre o curativo, evitando assim contaminação microbiana;
- Projetado para permitir uma fácil aplicação do filme sobre curativos e tubos;
- O formato único e inovador do rolo permite o uso rápido e econômico do filme PU criando uma fixação confortável e segura para o paciente, permitindo a colocação de curativos em articulações sem limitar os movimentos.

# PHARMAFIX<sup>®</sup> PU

## INSTRUÇÕES DE USO:

- O produto deverá ser utilizado na pele do paciente após limpeza e remoção de umidade residual (secagem) da área onde será aplicado o curativo;
- Cortar o pedaço de acordo com o tamanho da área requerida;
- Suavemente esticar o papel de suporte siliconado, em direções oposta para retirar o mesmo pelo corte central;
- Suavemente esticar a película protetora, expor a superfície adesiva e aplicar na área desejada.

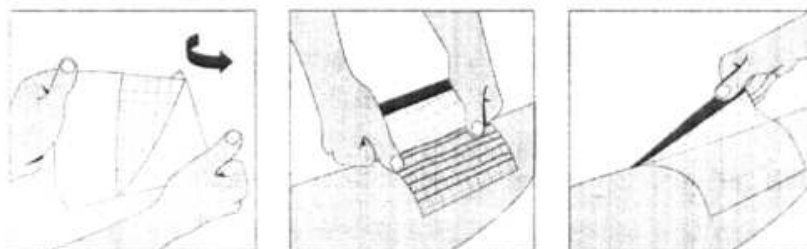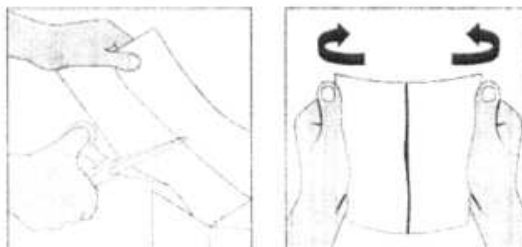

## EMBALAGEM:

Descrição do produto, data de validade, número do lote e armazenamento.

## CONSERVAÇÃO:

Armazenar abaixo de 30°C

## GARANTIA DA QUALIDADE:

GLOBAL STANDART FOR CONSUMER PRODUCTS (SGS)  
ISO 9001/ISO 13485/EN ISO 13485  
MARCA CE 0086

## TAMANHOS E CÓDIGOS

| Código    | Tamanho      | Apresentação                                  |
|-----------|--------------|---|
| FIXPU510  | 5 x 1000 cm  | 2 Rolos por embalagem,<br>72 rolos por caixa. |
| FIXPU1010 | 10 x 1000 cm | 1 Rolo por embalagem,<br>36 rolos por caixa.  |
| FIXPU1510 | 15 x 1000 cm | 1 Rolo por embalagem,<br>36 rolos por caixa.  |

## Cadastro / Registro M.S.:

10369460065

## Modelos cadastrados:

- L2 - Câmara macrogotas com filtro, conexão de duas vias (Y), regulador de fluxo e entrada de ar; L6 - Câmara microgotas com filtro, conexão de duas vias (Y), regulador de fluxo e entrada de ar; L11 - Câmara macrogotas com filtro, simples, flash ball, regulador de fluxo e entrada de ar; L22 - Câmara microgotas tipo bureta, 150mL, clamp, com válvula, com membrana de injeção, regulador de fluxo e entrada de ar.
- L2R - Câmara Macrogotas com filtro, conexão em (Y), regulador de fluxo e entrada de ar; L2V - Câmara Macrogotas com filtro, conexão valvulada, regulador de fluxo e entrada de ar.

## Indicação de Uso:

O Equipos para infusão de uso único é utilizado na administração de soluções intravenosa em ambiente hospitalar, clínicas ou unidades de saúde por profissional devidamente habilitado.

## Instrução de uso:

1. Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de abertura.
2. Verificar a data de validade do produto.
3. Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.
4. Instalar equipos para infusão de uso único no paciente seguido os procedimentos padronizados da unidade de saúde.
5. **Não re-esterilizar e não reutilizar. O seu reprocessamento é proibido.**

## Conservação, Armazenamento e Transporte:

- **Condições de armazenamento:** armazenar a temperatura ambiente em local fresco e seco.
- **Condições de transporte:** transportar a temperatura ambiente em local fresco e seco.
- **Condições de manipulação:** manipular a temperatura ambiente em local fresco e seco.

## Advertência/Precaução:

- **Advertências:**  
O fabricante recomenda o uso único. Reprocessamento proibido.
- **Precauções:**
  1. Não utilizar se a embalagem apresentar sinais de danos ou estiver aberta.
  2. Não utilizar após a data de validade do produto.

## Validade:

Prazo de validade: 5 anos.

## Contraindicação:

Não se aplica desde que utilizado de acordo com as instruções de uso.

## Importado e Distribuído:

## Importador:

**Matriz:** Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.  
Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP  
**CNPJ:** 01.005.728/0001-79  
**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40  
**SAC:** 0800 6658007  
**Resp. Técnica:** Luciana J Lanzillo – CRF/SP: 41067  
**Fabricante:**  
**Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd**  
312, Shichang Road  
Weihai City  
Shandong Province  
República Popular da China.

Versão 1 resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525

96/9 7

## INSTRUÇÕES DE USO



### ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL

#### DESCRIÇÃO

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL** é composto por duas espátulas anatômicas dispostas paralelamente, unidas em suas extremidades distais por um parafuso. Este, ao ser rosqueado, possui a função de promover gradualmente a abertura das espátulas.

**COMPOSIÇÃO**- Poliestireno (PS) e Polietileno (PE)

Lote/Partida: vide embalagem

Fabricação: vide embalagem

Validade: vide embalagem

#### FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL** é apresentado em 4 diferentes tamanhos, sendo eles: Virgem, Pequeno (P), Médio (M) e Grande (G). Podem ser dispostos em caixas com 50, 100, 125, 200 e 250 unidades, e embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

#### FINALIDADE

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL** é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

#### INSTRUÇÕES DE USO

1. O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.
2. Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
3. Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.
4. Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

#### PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento.

#### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE





Transportar o produto em sua embalagem original e armazenar em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

**DESCARTE**

Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

**ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.  
DESCARTAR APÓS O USO.**

**PRODUTO ESTERILIZADO POR: RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO**

**Fabricado por:**

**CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**

Rua San José, nº 361 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

**BRASIL**

CNPJ. 48.740.849/0004-70

☎ SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 2712-7000  
e-mail: [sac@cralplast.com.br](mailto:sac@cralplast.com.br)

**Distribuído por:**

**CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**

Rua San José, nº 305 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

**BRASIL**

CNPJ. 48.740.849/0001-28

Responsável Técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim – COREN-SP - 151479

Revisão 00 de 27/08/2021



gt  
18  
D/



## INSTRUÇÕES DE USO

### ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL

#### DESCRIÇÃO

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL** é composto por duas espátulas anatômicas dispostas paralelamente, unidas em suas extremidades distais por um parafuso. Este, ao ser rosqueado, possui a função de promover gradualmente a abertura das espátulas.

**COMPOSIÇÃO-** Poliestireno (PS) e Polietileno (PE)

Lote/Partida: vide embalagem

Fabricação: vide embalagem

Validade: vide embalagem

#### FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL** é apresentado em 4 diferentes tamanhos, sendo eles: Virgem, Pequeno (P), Médio (M) e Grande (G). Podem ser dispostos em caixas com 50, 100, 125, 200 e 250 unidades, e embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

#### FINALIDADE

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL** é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

#### INSTRUÇÕES DE USO

1. O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.
2. Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
3. Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.
4. Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

#### PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento.

#### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

*[Handwritten signature]*



Transportar o produto em sua embalagem original e armazenar em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

**DESCARTE**

Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

**ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.  
DESCARTAR APÓS O USO.**

**PRODUTO ESTERILIZADO POR: RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO**

**Fabricado por:**

**CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**

Rua San José, nº 361 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

**BRASIL**

CNPJ. 48.740.849/0004-70

☎ SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 2712-7000  
e-mail: [sac@cralplast.com.br](mailto:sac@cralplast.com.br)

**Distribuído por:**

**CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**

Rua San José, nº 305 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

**BRASIL**

CNPJ. 48.740.849/0001-28

Responsável Técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim – COREN-SP - 151479

Revisão 00 de 27/08/2021

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | Cavidagel   |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| Cav T15               |
| Cav T20               |
| Cav T25               |
| Cav T30               |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                       | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Cavidagel Instrução de Uso.pdf | 4745428219 - 02/12/2021 17:07:41    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nome Técnico           | Curativo                |
| Registro               | 81606090034             |
| Processo               | 25351513728201966       |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E       |
| Classificação de Risco | III - ALTO RISCO        |
| Vencimento do Registro | 10/02/2030              |
| Situação               | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados] |




- b) **Restrições:** Apenas para uso externo.
- c) **Advertências:** Produto Estéril. Não reutilize o produto. A reutilização pode representar risco de infecção.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não usar se a embalagem estiver violada.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado nas condições de temperatura ambiente por empresa regularizada para esta atividade.




#### Instruções de utilização

1. Lavar a ferida com soro fisiológico ou conforme protocolo médico.
2. Secar suavemente a pele ao redor da ferida.
3. Preencher a ferida com o curativo Cavidagel conforme mostrado na figura abaixo.

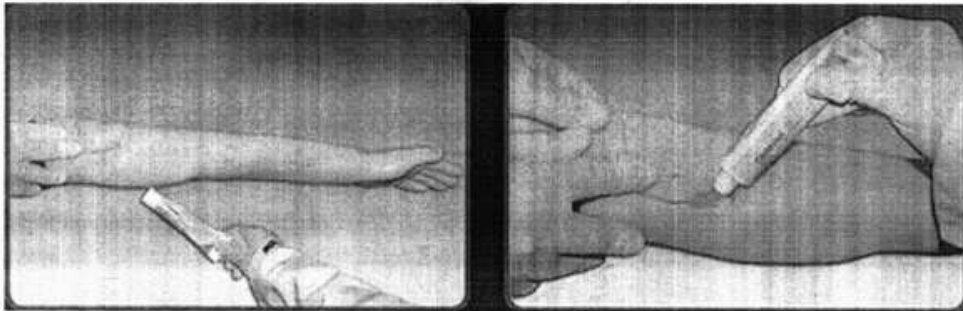

4. A ferida não deve ser preenchida até um nível superior ao da pele circundante.
5. Cubra com um curativo secundário, conforme figura abaixo.

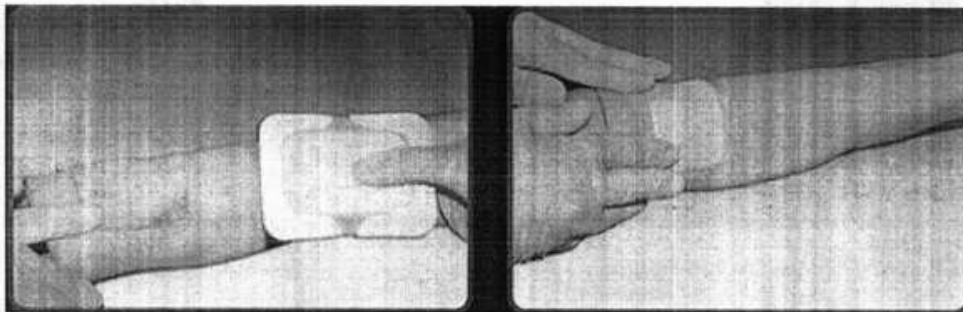

Para feridas com pouco a médio exsudato, utilizar um curativo hidrocolóide. Para feridas com médio a muito exsudato, usar um curativo altamente absorvente e altamente permeável para cobrir a ferida. Para feridas ligeiramente ou não exsudativas, o Cavidagel pode ser coberto com curativo filme transparente.

6. Para otimizar a limpeza de feridas necróticas e exsudativas, recomenda-se a troca do curativo pelo menos a cada 3 dias, devido à maior quantidade de exsudado. Em caso de feridas secas, o Cavidagel deve ser trocado conforme a quantidade de exsudado.
7. O gel pode ser removido da ferida por enxague com soro fisiológico ou conforme protocolo médico.
8. Recomenda-se trocar o curativo a cada 3 dias ou conforme necessário.

#### Segurança e eficácia

O produto Cavidagel é considerado seguro conforme resultados dos testes de biocompatibilidade realizados em conformidade com a norma ISO 10993. Os resultados do teste indicam que o produto possui uma boa biocompatibilidade, onde todos os resultados se encontram dentro das especificações e não mostraram indicação de liberação de concentrações significativas de substâncias citotóxicas.

#### Apresentação comercial

O produto Cavidagel é embalado em tubo maleável, feitos de estrutura trilaminada. A camada exterior do tubo é impressa com as informações do produto. A camada intermediária isola o gel para evitar o ressecamento, enquanto a camada mais interna é

responsável pela vedação do tubo durante o processo de selagem a quente.

O produto é esterilizado por radiação gamma.

O produto Cavidagel possui os seguintes modelos comerciais:

| Modelo (Código) | Conteúdo | Apresentação comercial |
|-----------------|----------|------------------------|
| Cav T15         | 15 g     | 48/caixa               |
| Cav T20         | 20 g     | 48/caixa               |
| Cav T25         | 25 g     | 48/caixa               |
| Cav T30         | 30 g     | 48/caixa               |

#### Validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em local seco, temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

**PRODUTO ESTÉRIL**

**PRODUTO DE USO ÚNICO**

**NÃO REUTILIZE O PRODUTO. A REUTILIZAÇÃO PODE REPRESENTAR RISCO DE INFECÇÃO.**

**DESCARTAR A EMBALAGEM APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO.**

**Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.**

**Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.**

Lote, Data de fabricação e Data de validade: Vide embalagem

Registro ANVISA: MS 81606090034

Fabricante: Pharmaplast S.A.E. ; Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria, Egypt.

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME

Avenida Barão Homem de Melo 4444, Bloco II, Sala 601 – Estoril – Belo Horizonte/MG

CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | contato@goldmedimport.com.br

CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120



# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

35 / 1 / D



| Detalhes do Produto |   |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa     | GoldMed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME |
| CNPJ                | 28.215.470/0001-91                                  |
| Autorização         | 8.16.060-9  |
| Produto             | Cavidagel   |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| Cav T15               |
| Cav T20               |
| Cav T25               |
| Cav T30               |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                       | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Cavidagel Instrução de Uso.pdf | 4745428219 - 02/12/2021 17:07:41    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nome Técnico           | Curativo                |
| Registro               | 81606090034             |
| Processo               | 25351513728201966       |
| Fabricante Legal       | PHARMAPLAST S.A.E       |
| Classificação de Risco | III - ALTO RISCO        |
| Vencimento do Registro | 10/02/2030              |
| Situação               | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados] |

INSTRUÇÃO DE USO  
CAVIDAGEL  
Hidrogel Estéril com Alginato



#### Descrição

Cavidagel é um hidrogel amorfo límpido com alginato que hidrata gentilmente o tecido necrótico, facilitando o desbridamento autolítico, enquanto possibilita que o esfacelo se solte ao mesmo tempo que é absorvido juntamente com o exsudato. Ele também pode ser usado para fornecer um ambiente ideal de gerenciamento de feridas úmidas durante os últimos estágios do fechamento da ferida.

#### Características

- Ação desbridante: o Cavidagel reidrata o tecido necrótico e auxilia no desbridamento.
- Ação de absorção: o Cavidagel absorve o esfacelo e o exsudado sem danificar o tecido de granulação frágil.
- Cria um ambiente úmido para cicatrização de feridas: o Cavidagel ajuda a criar um ambiente de gerenciamento de feridas úmido ideal que promove a cura, reduz a probabilidade de cicatrizes e ajuda a aliviar a dor.
- Estável e neutraliza vazamentos e macerações: a textura viscosa do gel faz com que ele permaneça no lugar, e mesmo após a absorção de detritos e exsudação, o gel permanece coeso e neutraliza o vazamento e a maceração.
- Fácil de remover: o gel é fácil de remover devido à alta coesão, mesmo após a absorção de detritos e exsudato.

#### Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação

Cavidagel é um hidrogel amorfo límpido com alginato que hidrata cuidadosamente o tecido necrótico, facilitando o desbridamento autolítico. Possibilita que o esfacelo se solte ao mesmo tempo que é absorvido juntamente com o exsudato. Fornece um ambiente ideal para feridas úmidas durante os últimos estágios do fechamento da ferida.

#### Funcionamento e Ação

- Ação desbridante: o Cavidagel reidrata o tecido necrótico e auxilia no desbridamento eficaz de maneira suave.
- Ação de absorção: o Cavidagel absorve o esfacelo e o exsudado sem danificar o tecido de granulação frágil.
- Cria um ambiente úmido para cicatrização de feridas: o Cavidagel ajuda a criar um ambiente úmido ideal para promover a cura, reduzindo a probabilidade de cicatrizes e aliviar a dor.
- Propriedades superiores de reidratação, gelificação e coesão: a textura viscosa do gel faz com que ele permaneça no lugar, e mesmo após a absorção de detritos e exsudação, o gel permanece coeso e neutraliza o vazamento e a maceração.
- Fácil de remover: o gel é fácil de remover devido à alta coesão, mesmo após a absorção de detritos e exsudato.

#### Composição

Água purificada, Alginato, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol e Carbômero.

#### Indicações

O Cavidagel destina-se principalmente ao tratamento de feridas necróticas, com crosta ou escaras, por exemplo, úlceras na perna, úlceras por pressão e úlceras diabéticas não infectadas. Também pode ser usado em queimaduras de 1ª e 2ª graus. O gel pode ser usado durante todo o processo de cicatrização para fornecer um ambiente úmido para cicatrização de feridas em todos os tipos de feridas. Pode ser usado em pacientes com infecções locais e sistêmicas, a critério de um profissional de saúde.

#### Contraindicações

Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso e consulte o seu médico.


Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte

- a) Precauções: Não se aplica.


- b) **Restrições:** Apenas para uso externo.
- c) **Advertências:** Produto Estéril. Não reutilize o produto. A reutilização pode representar risco de infecção.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não usar se a embalagem estiver violada.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado nas condições de temperatura ambiente por empresa regularizada para esta atividade.

#### Instruções de utilização

1. Lavar a ferida com soro fisiológico ou conforme protocolo médico.
2. Secar suavemente a pele ao redor da ferida.
3. Preencher a ferida com o curativo Cavidagel conforme mostrado na figura abaixo.

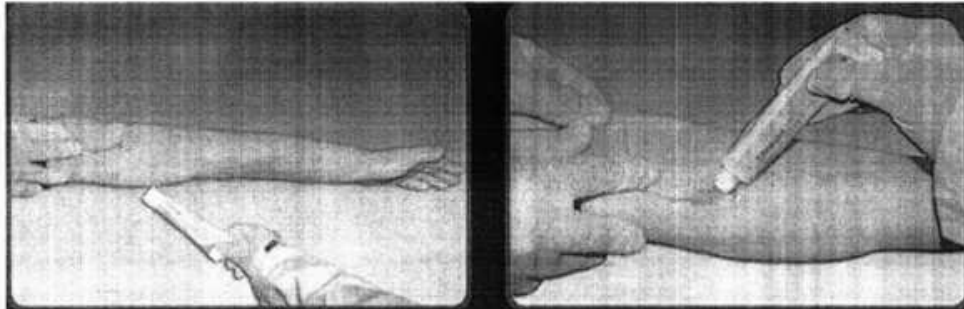

4. A ferida não deve ser preenchida até um nível superior ao da pele circundante.
5. Cubra com um curativo secundário, conforme figura abaixo.

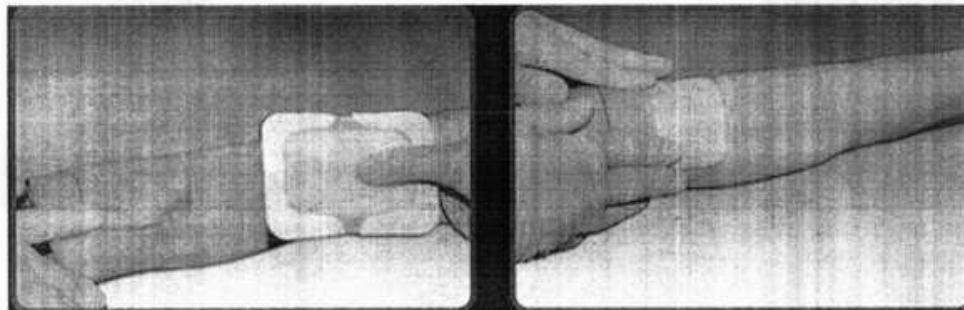

Para feridas com pouco a médio exsudato, utilizar um curativo hidrocolóide. Para feridas com médio a muito exsudato, usar um curativo altamente absorvente e altamente permeável para cobrir a ferida. Para feridas ligeiramente ou não exsudativas, o Cavidagel pode ser coberto com curativo filme transparente.

6. Para otimizar a limpeza de feridas necróticas e exsudativas, recomenda-se a troca do curativo pelo menos a cada 3 dias, devido à maior quantidade de exsudado. Em caso de feridas secas, o Cavidagel deve ser trocado conforme a quantidade de exsudado.
7. O gel pode ser removido da ferida por enxague com soro fisiológico ou conforme protocolo médico.
8. Recomenda-se trocar o curativo a cada 3 dias ou conforme necessário.

#### Segurança e eficácia

O produto Cavidagel é considerado seguro conforme resultados dos testes de biocompatibilidade realizados em conformidade com a norma ISO 10993. Os resultados do teste indicam que o produto possui uma boa biocompatibilidade, onde todos os resultados se encontram dentro das especificações e não mostraram indicação de liberação de concentrações significativas de substâncias citotóxicas.

#### Apresentação comercial

O produto Cavidagel é embalado em tubo maleável, feitos de estrutura trilaminada. A camada exterior do tubo é impressa com as informações do produto. A camada intermediária isola o gel para evitar o ressecamento, enquanto a camada mais interna é



responsável pela vedação do tubo durante o processo de selagem a quente.

O produto é esterilizado por radiação gamma.

O produto Cavidagel possui os seguintes modelos comerciais:

| Modelo (Código) | Conteúdo | Apresentação comercial |
|-----------------|----------|------------------------|
| Cav T15         | 15 g     | 48/caixa               |
| Cav T20         | 20 g     | 48/caixa               |
| Cav T25         | 25 g     | 48/caixa               |
| Cav T30         | 30 g     | 48/caixa               |



#### Validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em local seco, temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

#### PRODUTO ESTÉRIL

#### PRODUTO DE USO ÚNICO

**NÃO REUTILIZE O PRODUTO. A REUTILIZAÇÃO PODE REPRESENTAR RISCO DE INFECÇÃO.**

**DESCARTAR A EMBALAGEM APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO.**

**Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.**

**Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.**

Lote, Data de fabricação e Data de validade: Vide embalagem

Registro ANVISA: MS 81606090034

Fabricante: Pharmaplast S.A.E. ; Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria, Egypt.

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME

Avenida Barão Homem de Melo 4444, Bloco II, Sala 601 – Estoril – Belo Horizonte/MG

CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 | contato@goldmedimport.com.br

CNPJ: 28.215.470/0001-91 | Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120

38  
11 D




FRONT

cut

fold


100 x 50mm

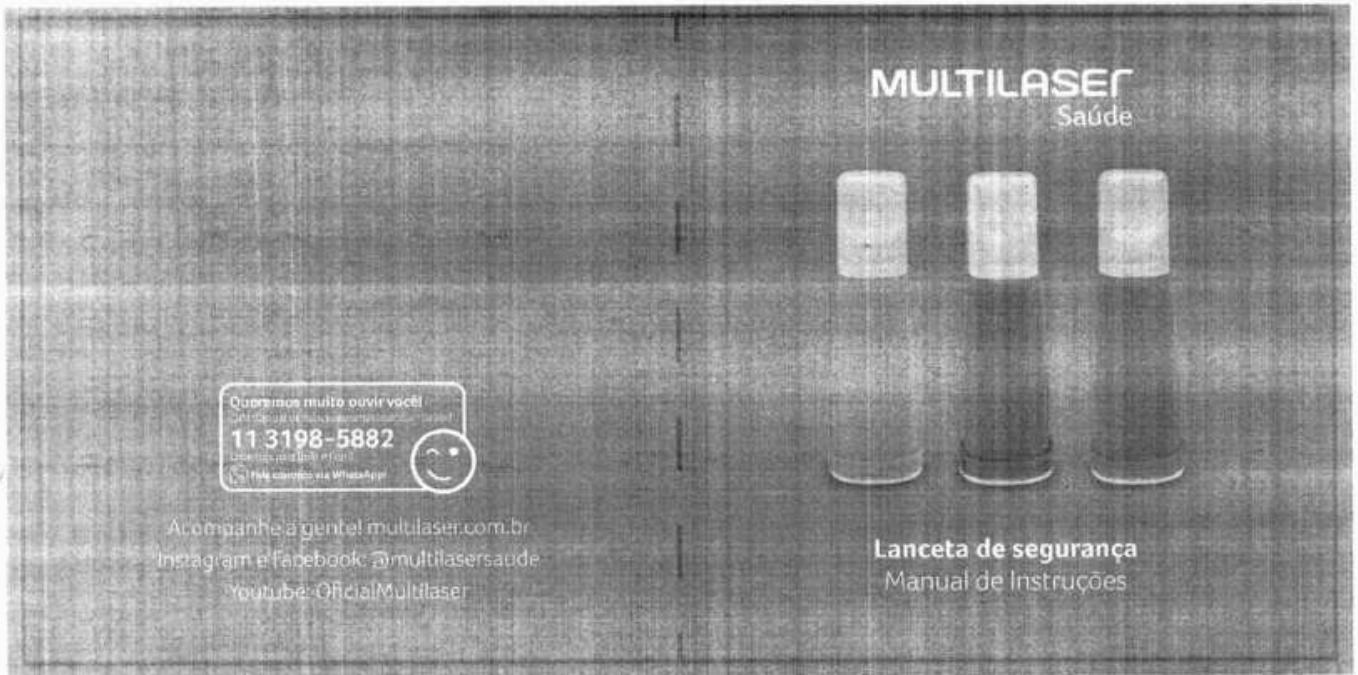

Queremos muito ouvir você!  
Atendimento personalizado e rápido!  
**11 3198-5882**  
Gratuito em todo o Brasil  
Fale conosco via WhatsApp

acompanhe a gente! [multilaser.com.br](http://multilaser.com.br)  
Instagram e Facebook: @multilasersaude  
YouTube: OficialMultilaser

MULTILASER  
Saúde

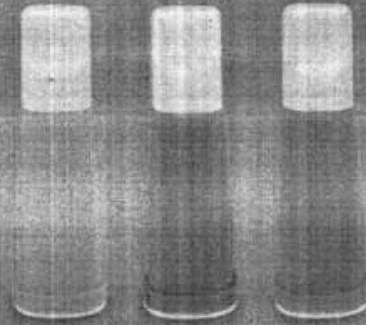

Lanceta de segurança  
Manual de Instruções

BACK

#### MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Produto:** Lancetas de Segurança Descartável

Este manual possui orientações para os seguintes modelos de lanceta de segurança: HC429, HC430, HC431, HC433, HC434, HC435, HC436, HC437, HC438 e HC439.

**Utilização:** Utilizado para fazer punções e obter pequenas amostras de sangue e para perfurar a pele e obter testes de alergias.

**Materiais:** Corpo: ABS, Agulha: OCl 19Ni19

**Método de esterilização:** Esterilizado por radiação gama Co-60 de 25 kGy

#### Método de operação:

1. Ajuste o comprimento da proteção da lanceta de segurança;
2. Posicione a extremidade frontal da lanceta de segurança no local de punção;
3. Pressione a ponta da lanceta para disparar; ao término da perfuração a ponta da agulha e a ponta da proteção retornam ao invólucro;
4. A agulha é bloqueada após o disparo, sendo impossível de disparar novamente, o que garante que não seja reutilizada.

#### Recomendações:

1. Que a lanceta de segurança assim que abrir a embalagem;
2. A lanceta de segurança é de uso único; após sua utilização deve ser descartada para incineração ou devem ser seguidas as normas do hospital para descarte de materiais.

#### Armazenamento:

1. Deve ser armazenado em temperatura ambiente, longe de luz direta e água;
2. Evitar umidade e outros danos ao material da embalagem;

3. Verifique a data de validade do produto. Descarte se estiver vencido. Também descarte as lancetas de segurança que não forem utilizadas após muito tempo de descompactamento. **Validade:** Este produto pode ser utilizado até cinco anos após a data de produção, tal como indicado no rótulo da embalagem, desde que seja mantido em armazenamento adequado.

**Aviso:** 1. Se o pacote estiver quebrado, seu uso se torna proibido;

2. Se a ponta da lanceta para coleta de sangue estiver dobrada ou quebrada, seu uso se torna proibido;

3. A lanceta de segurança deve ser utilizada dentro o prazo de validade.

Confiamos tanto em nosso produto que damos garantia de 3 meses. É nossa Central de relacionamento Multi-laser porque resolve o seu problema rapidinho. Pode contar com a gente. **#tamojunto!** **GARANTIA:** Este produto possui 3 meses de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto/ troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

**Fabricado por:** Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., Ltd.  
Erlong, Beijing Town, Xiangheng District, Suzhou City Código Postal: 215144  
Tel: 86-512-65412557 Fax: 86-512-65417126

**Importado por:** Multilaser Industrial S.A. CNPJ: 09.717.553/0006-17 R. Josépha Gomes de Souza, 352 Itaipava, Curitiba - PR, 81760-000

Lancetas de Segurança - Manual de Instruções

Lancetas de Segurança - Manual de Instruções



39 / 10 D

## INSTRUÇÕES DE USO PINÇA DE CHERRON ESTÉRIL

- Contém \_\_\_\_ unidades



A **PINÇA DE CHERRON ESTÉRIL** é formada por duas hastes plásticas articuladas entre si através de encaixe, permitindo a prensão de compressas de gaze através do afastamento e posterior aproximação destas hastes.

**Composição:** Poliestireno de alto impacto.

**Finalidade:** Indicada para limpeza física do canal vaginal e do colo uterino, através da prensão de compressas de gaze, e para procedimentos ginecológicos diversos.

**Modo de usar:**

Para uso exclusivo do Médico ou Enfermeiro responsável, de acordo com o protocolo médico da unidade de saúde.

**Precauções, Cuidados e Advertências**

Não utilizar o produto caso esteja fora do prazo de validade.  
Verificar se o travamento está correto.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Armazenar e transportar o produto à temperatura ambiente em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo do sol.

**DESCARTE**

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

**ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.  
DESCARTAR APÓS O USO.**

ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA ou ÓXIDO DE ETILENO

Lote: vide embalagem

Fabricação e validade: vide embalagem

**Fabricado por:**

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.  
Rua San José, 361 - Parque Industrial San José  
06715-862 - Cotia - SP  
Brasil  
CNPJ 48.740.849/0004-70

**Distribuído por:**

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.  
Rua San José, 305 - Parque Industrial San José  
06715-862 - Cotia - SP  
Brasil  
CNPJ 48.740.849/0001-28

Responsável técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim - COREN-SP N° 151479  
Cadastro ANVISA

☎ SAC (Serviço de atendimento ao consumidor):  
(11) 2712-7000 - e-mail: sac@cralplast.com.br

Revisão 00 de 27/08/2021



16  
11  
D

**IODOPOLIVIDONA 10% - Tópico**

Código: FT 008

Revisão: 04

Emissão: Agosto/2018

**DESCRIÇÃO**

Iodopolividona 10% Tópico (PVPI Tópico) é um antisséptico a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, é um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, sem irritar nem sensibilizar a pele, sendo facilmente removível em água.

Sinônimos Químicos e Comerciais: PVPI Tópico, Iodopolividona, Iodopovidona, Povidona Iodo, Pirrolidil Iodo Povidona.

**INDICAÇÕES**

Iodopolividona 10% Tópico é um antisséptico indicado para uso tópico.

**CONTRAINDICAÇÕES**

Pessoas sensíveis a compostos à base de iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção e iodo) e em curativos oclusivos.

**RESTRIÇÕES DE USO**

Neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado.

**INSTRUÇÕES DE USO**

Uso externo. Aplicar Iodopolividona 10% Tópico, topicamente nas áreas afetadas ou a critério médico, após limpeza prévia do local a ser tratado com o auxílio de uma gaze estéril.

**APRESENTAÇÕES**

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos litro.

100 ml - Caixa contendo 24 frascos almotolias.

**IODOPOLIVIDONA 10% - Tópico**

Código: FT 008

Revisão: 04

Emissão: Agosto/2018

**PRIMEIROS SOCORROS**

Em contato com os olhos, lavá-los abundantemente com água corrente.

Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou clara de ovos batidas em água.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

**COMPOSIÇÃO**

Iodopolividona..... 100 mg

Excipientes \* q.s.p..... 1 ml

\*Excipientes: Ácido Cítrico, Glicerina, Iodato de Potássio, Sódio neutralizador e Água Deionizada.

**PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Cor da solução:..... Castanho avermelhado.

Odor:..... Característico de iodo.

Aparência:..... Líquida e livre de impurezas.

pH:..... 2,50 a 6,50.

Densidade:..... 1,025 a 1,035 g/ml.

Teor de Iodo disponível:..... 0,80 a 1,20 %.

**PRAZO DE VALIDADE**

02 anos.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz e calor excessivo.

**IODOPOLIVIDONA 10% - Tópico**

Código: FT 008

Revisão: 04

Emissão: Agosto/2018

#### DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

#### REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda  
R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial - Taquaritinga - SP.  
CNPJ: 39.032.974/0001-92  
Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815  
SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)

54/8 D



## 11 INSTRUÇÕES DE USO

SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA  
Estrada da Graciosa, 5711, Canguiri - CEP 83.412-460. Colombo PR

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

|  |  |
|--|--|
| PRODUTO                                      | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL  |
| Nome Técnico                                 | Sonda  |
| Registro Anvisa                              | 80019160013  |
| Classificação de risco                       | Classe II  |
| TAMANHO (diâmetro em FR e comprimento em cm) | 6 FR x 60 cm. 8 FR x 60 cm e 100 cm<br>10 FR, 12 e 14 FR x 120 cm                                    |
| Radiopacidade                                | Totalmente radiopaca com marcações (tamanhos 6 e 8 FR) e com marcação numérica (tamanhos 10 e 12 FR) |
| Esterilidade                                 | Estérel. Esterilizada a óxido de etileno   |
| Uso  | Uso único, somente por recomendação médica   |
| Armazenamento                                | Armazenar em local limpo, seco, ao abrigo da luz solar e fontes de radiação                          |
| Prazo máximo de utilização                   | 30 dias - Uso de curto prazo   |

### APRESENTAÇÃO

A Sonda para Nutrição Enteral Solumed é confeccionada em material atóxico e biocompatível, composto por tubo flexível em poliuretano. O peso distal é formado por ogiva em PVC preenchida com esferas de aço inox. Conector proximal em forma de Y em PVC na extremidade com duas entradas distintas, sendo uma para a dieta alimentar e outra para medicamentos. Contém internamente um fio guia feito em aço inox lubrificado. Esterilizada a óxido de etileno e embalada em papel grau cirúrgico.

### INDICAÇÃO

O produto é indicado para a Terapia de Nutrição Enteral como dispositivo de acesso ao estômago ou duodeno com finalidade de oferecer suporte nutricional e/ou medicamentoso a pacientes com trato gastrointestinal que funcione, mas apresente dificuldades para ingestão. Podem ser administrados alimentos e medicamentos líquidos.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Ler atentamente todas as advertências e precauções antes de abrir a embalagem do produto e fazer sua colocação.



Após uso o produto deve ser destruído e descartado conforme procedimentos da instituição de saúde.

Verifique o prazo de validade impresso na embalagem antes de uso. Caso a validade esteja vencida, NÃO utilizar o produto.

Antes do uso, verificar atentamente as condições da embalagem. Caso existam sinais de violação ou quaisquer outros que ponham em dúvida sua integridade, o produto não deve ser utilizado.

Só abra a embalagem no momento em o produto estiver prestes a ser utilizado e todos os procedimentos técnicos de preparo e assepsia tiverem sido tomados.

A colocação do produto no paciente deve obrigatoriamente ser realizada por médico ou enfermeiro devidamente habilitado e capacitado, seguindo rigorosamente procedimentos técnicos específicos aprovados por equipe multidisciplinar conforme as boas práticas vigentes na instituição. Esses procedimentos devem estar documentado nos procedimentos operacionais da instituição de saúde.

Certifique-se de que todo o material necessário para colocação da sonda no paciente esteja devidamente preparado e disponível no local e no momento da colocação.

Antes de iniciar a colocação da sonda no paciente, teste o deslize do fio guia enrolando a sonda em torno da mão, formando um círculo de aproximadamente 15 cm de diâmetro. Puxe-o suavemente com movimentos rotacionais, retire e reinsira cerca de 15 cm do mesmo e atestando o deslize satisfatório. Caso não deslize, realize o teste com outra sonda e só inicie a colocação no paciente após atestar o deslize do cabo guia.

NÃO dobre nenhuma parte da sonda para sua inserção e colocação no paciente.

NÃO utilize nenhum outro instrumento para auxiliar a inserção e colocação da sonda no paciente.

NÃO coloque a sonda no paciente se o mesmo estiver fazendo uso de quaisquer outros dispositivos inseridos nas vias por onde a sonda passará.

#### CONTRA INDICAÇÕES

Pacientes que apresentem anomalias ou que tenham doenças no nariz, garganta e/ou esôfago e/ou apresentem alergia a algum componente.

Pacientes que usam dispositivo endotraqueal necessitam de maiores cuidados durante a colocação da sonda, pois o mesmo pode guiá-la para a traquéia.

Para realização de exames de ressonância magnética a sonda deverá ser retirada do paciente.

#### INSTRUÇÕES DE USO

1 - Explicar ao paciente consciente o procedimento que será realizado. O mesmo deve ser mantido calmo e tranquilo. No caso de pacientes comatosos, semi comatosos ou não colaborativos, a colocação da sonda deverá ser feita sob fluoroscopia.

2 - Posicionar o paciente sentado ou semi sentado, sem inclinar sua cabeça para frente. A cabeceira do leito deverá estar a 45 graus de inclinação.

3 - Para calcular a profundidade da inserção, colocar a ponta distal (ogiva) da sonda na ponta do nariz, estendendo o tubo até o lóbulo da orelha e daí até o apêndice xifóide, caso deseje posicionar no



estômago. Acrescente a essa marca mais 25 a 35 cm para posicionamento na 2ª ou 3ª porção do duodeno ou no início do jejuno.

4 - Escolha a narina adequada para inserção da sonda.

5 - Lubrificar a sonda externamente com geléia anestésica.

6 - Iniciar a inserção da sonda. Quando a mesma atingir a orofaringe, incentivar o paciente a engolir. Casos necessários, podem ser dados alguns goles de água em temperatura ambiente para ajudar na passagem da sonda.

7 - Continuar até a ponta da sonda atingir o ponto desejado.



#### VERIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO

A verificação do posicionamento da sonda pode ser realizada por ausculta, raio X e endoscopia.

1 - Para verificar o posicionamento por meio da verificação do seu posicionamento por meio da ausculta do quadrante superior esquerdo do abdômen, usando seringa de 50 ml, realizar a instilação cuidadosa de pequenas porções de água e aspiração de suco gástrico. A passagem transpilórica da ponta é espontânea e ocorre num período que varia entre 24 e 48 horas.

2 - Para verificar o posicionamento da sonda por meio de raio X, certifique-se que o aparelho de raio X esteja ajustado com a frequência e intensidade suficientes para reflexão da região radiopaca e da ponta distal da sonda, bem como quaisquer outros que se façam necessários. Para uma melhor visualização, recomenda-se que a verificação via raio X seja realizada ainda com o cabo guia inserido na sonda.

3 - Retirar cuidadosamente o fio guia. Puxá-lo delicadamente, devagar, com movimentos leves e rotacionais. CASO O CABO GUIA NÃO DESLIZE SUAVEMENTE, NÃO FORCE. Retire toda a sonda, descarte-a e com uma nova, reinicie todo o processo.

4 - Após retirada do fio guia, fixar a sonda no paciente no dorso do nariz ou na face.

#### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1 - A dieta e os medicamentos devem estar líquidos e homogêneos. Não ministrar alimentos e medicamentos no estado sólido ou em qualquer outro que possa entupir a sonda.

2 - Para limpeza da sonda, injetar 50 ml água morna (30 a 40°C) com auxílio de uma seringa:

- antes e depois de cada alimentação ou a cada 4 horas durante alimentação contínua.
- cada vez que houver desconexão da sonda com o equipo ou substituição do frasco reservatório.
- cada vez que a bomba de infusão for parada.

3 - O prazo máximo de uso do produto é de 30 dias. Após esse período, o mesmo deve ser substituído.

#### ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido dentro de sua embalagem original em ambiente seco, limpo, protegido da ação da luz solar e da umidade, isento da presença de insetos e roedores.

#### VALIDADE

O prazo de validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.





## EFEITOS ADVERSOS

O produto não causa efeitos adversos desde que seguidas todas as instruções de uso, seja manipulado por profissionais capacitados, sob procedimentos técnicos e apenas para o fim a que se destina.

## CONTATO

Caso sejam necessárias informações adicionais ou queira comunicar um eventual desvio de qualidade, entre em contato:



|  |  |
|--|--|
| <br><b>SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA</b> |  |
| Estrada da Graciosa, 5711, Canguiri -<br>CEP 83.412-460; Colombo PR<br>SAC (41) 3663 7235<br>sac@solumed.ind.br            | Responsável Técnico<br>Eng. Químico Ricardo Barbosa<br>CRQ 9.302.673 - 9ª Região<br>qualidade@solumed.ind.br |

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

54/8 7/1



## Descrição

## Avaliações (00)

Termômetro Digital Máxima e Mínima

Marca: JProLab

Modelo: Com Extensão (-20+70/-50+70)

Preço por Unidade

Imagem Ilustrativo

Termômetro Digital Máxima e Mínima

Marca: JProLab

Modelo: Com Extensão (-20+70/-50+70)

**NOME DO PRODUTO: TORNEIRA 3 VIAS PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - POLYMED**

Registro MS: 10150470354

#### **DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Torneira

Matéria Prima: Policarbonato

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: ( x ) Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

#### **FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A torneira 3 vias para infusão intravenosa – POLYMED, é um dispositivo multivias que auxilia na infusão venosa, transparente, rígido e com dispositivo para abrir e fechar com setas indicatórias. Apresenta duas vias de entrada luer e um para conexão ao cateter do tipo luer lock ou luer slip

#### **INDICAÇÃO DE USO**

A Torneirinha 03 Vias para Infusão Intravenosa Polymed é um dispositivo indicado para ser incorporado entre a linha de infusão e o dispositivo de venopunção, com o objetivo de:

infusão de Soluções Intravenosas

Administração intermitente de medicamentos intravenosos.





## **INSTRUÇÃO DE USO**

Inspecionar visualmente para garantir que a embalagem está intacta.

Remover a torneirinha da embalagem estéril.

Conectar uma ou duas linhas de infusão venosa como requerido para os ports.

Remover o protetor do conector macho e segurá-lo na vertical.

Abrir os clamps das linhas de infusão e deslocar o ar interno por rotação na tampa na posição aberta.

Girar a tampa para posição fechada.

Conectar o dispositivo de venopunção e firmá-lo com a rotação da trava.

Girar a tampa para posição aberta e ajustar o fluxo da infusão.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

A Torneirinha 03 Vias para Infusão Intravenosa Polymed é um dispositivo construído em 3 vias com a seguinte constituição:

- Corpo em Policarbonato
- 1 Asa de Abertura / Fechamento em Polietileno
- 2 Tampas em polietileno para os 2 conectores Luer Lock Fêmea
- 1 Conector Luer (lock, slip ou lock/slip) em Policarbonato.
- 1 Tampa de Conexão Luer macho em Polipropileno





**Características do Produto:**


- Mínimo espaço morto para precisão na administração de medicamentos.
- Conectores Luer Lock facilitam a segurança e garantia da conexão entre os conectores Luer e outros sistemas.
- Selas indicativas na asa de abertura e fechamento indicam a direção do fluxo.
- Apresenta Conectores Luer aceitos internacionalmente por serem compatíveis com todos os produtos padrão.
- Descartável, estéril e apirogênico.
- Fornecido em tamanho único

Representação esquemática do Produto:

Torneirinha 03 Vias para Infusão Intravenosa Polymed Comum

| Quantidade | Componente   | Matéria-prima |
|------------|--|---------------|
| 1          | Tampa da Conexão Luer Macho                                | Polipropileno |
| 1          | Corpo de Infusão da Torneirinha                            | Polycarbonato |
| 1          | Conector Luer Macho  | Polycarbonato |
| 1          | Asa de Abertura/ Fechamento de Linha com setas indicativas | HDPE          |
| 1          | Tampa para conector Luer Lock Fêmea                        | HDPE          |

**FOTO**

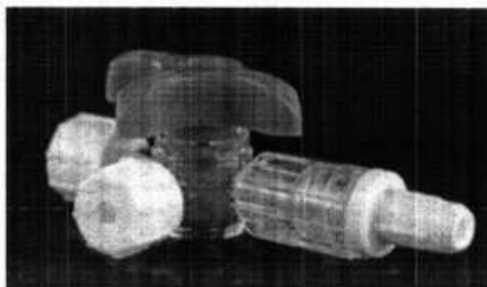

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   |
|---------------|--|
| 13007LL       | Torneira 3 vias para infusão intravenosa – LUER LOCK - POLYMED |
| 13048LS       | Torneira 3 vias para infusão intravenosa – LUER SLIP - POLYMED |

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

A Torneirinha 03 Vias para Infusão Intravenosa Polymed é fornecida esterilizada a Óxido de Etileno, embalada individualmente em Blíster de PVC com T-vek

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco e arejado, abrigado da luz solar

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Leia as instruções antes de usar.

○ produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

*[Handwritten signature]*





A Poly Medicure rejeita qualquer responsabilidade por possíveis consequências resultantes de uso impróprio.

O produto não deve ser reprocessado.

Inspecionar visualmente e checar cuidadosamente o produto e embalagem antes do uso.

Transporte ou manuseio impróprio podem causar danos estruturais e funcionais ao dispositivo ou a embalagem.

O produto é garantido não-tóxico, estéril e apirogênico, se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Não lave ou reesterilize. Somente para uso único. Descarte após o uso.

Estocar em local seco e arejado.

Não exponha a calor ou luz do sol direta.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1/6

Cliente: 5364-PREF. MUNIC. DE VICOSA DO CEARA  
Pregoeiro: FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA  
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  
Endereço: RUA SILVA JARDIM 436, 436 - CENTRO  
CEP: 62300-000 - VICOSA DO CEARA/CE  
Att: 20264



Pregão: N° PE 15/2023/SESA/SRP  
Dt Abert: 27/09/2023 Hora: 08:30

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO  
Data Doc: 26/09/2023

Licitante:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.

| Item  | Descrição  | Marca/Fab. | Qtde  | Und | R\$ Unt | R\$ Total |
|---|--|------------|-------|-----|---------|-----------|
| 1   | 00 ATADURA DE CREPOM 15CM X 1.80M. CONTENDO 13 FIOS/CM². FESO 19,5G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS ELASTICIDA DE ALFQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | TEXCARE    | 40000 | ROL | 0,7400  | 29.600,00 |
| R\$ Unit Item: SETENTA E QUATRO CENTAVOS          |  |            |       |     |         |           |
| R\$ Total Item: VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS REAIS |  |            |       |     |         |           |

**Total Global**

**R\$ Global 29.600,00**

VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.


PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES A EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

FORTALEZA/CE, 27 DE SETEMBRO DE 2023.

Validade da Proposta: 60  
Prazo de Entrega: 10 DIAS  
Condição de Pagamento

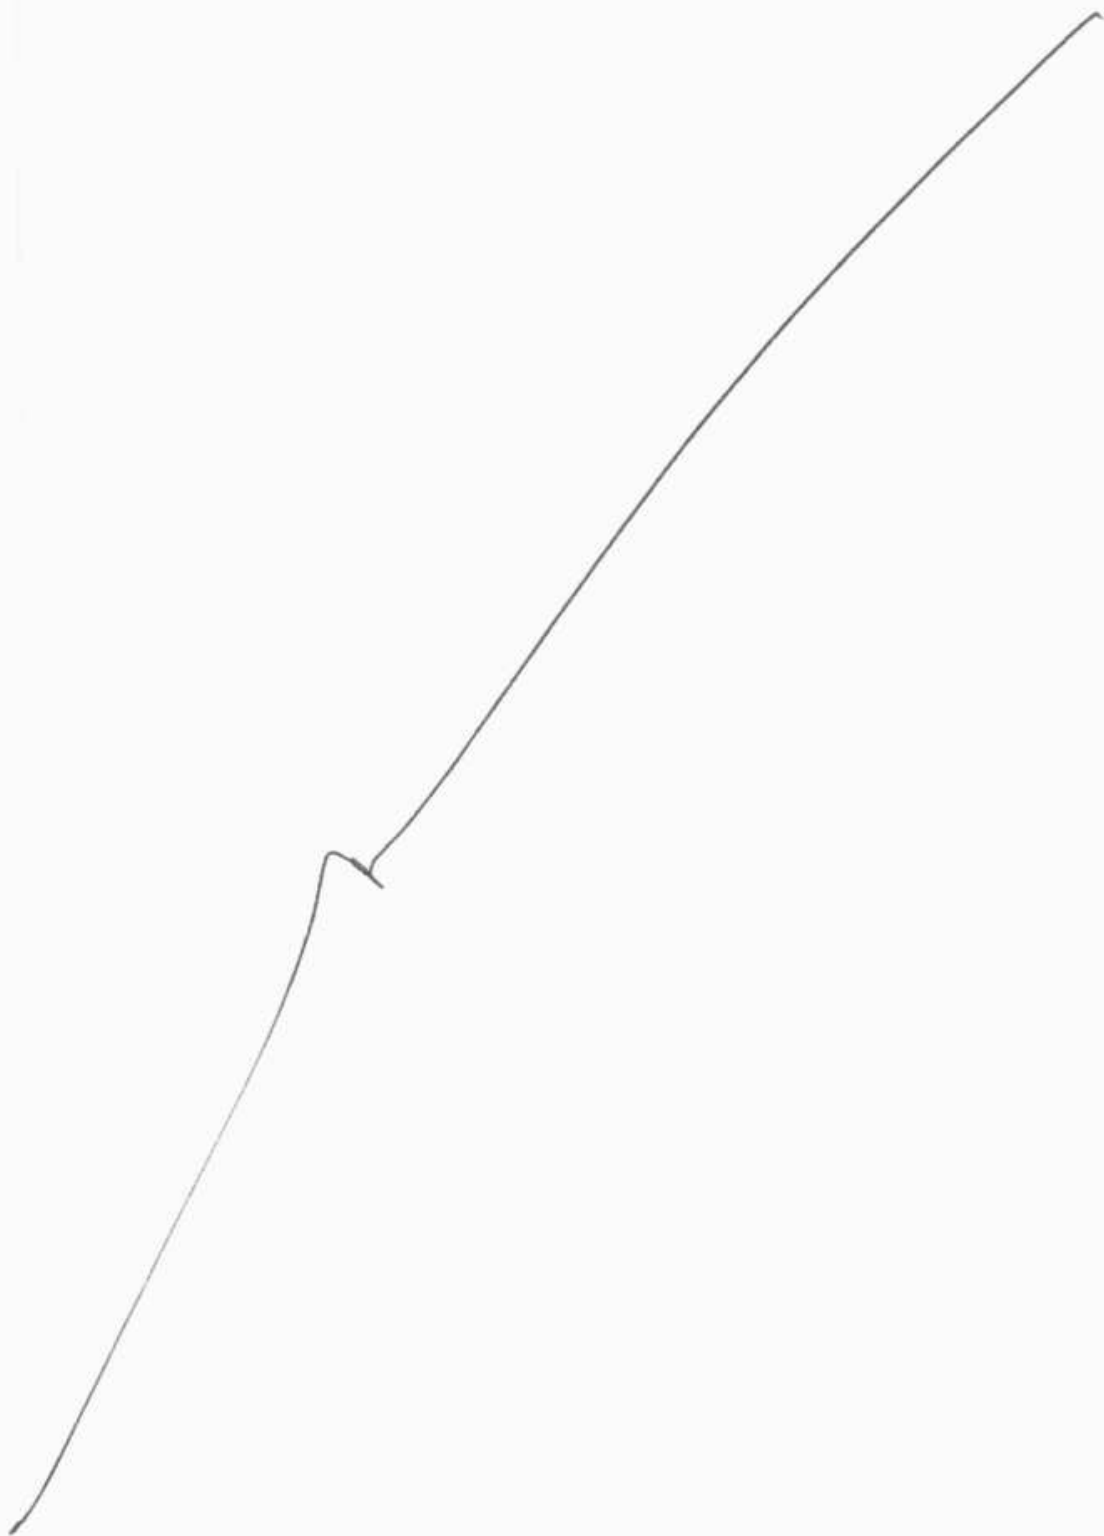

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ,  
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ,  
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 1512023-SESAISRP  
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 de setembro de 2023 às 08h30 horas  
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 27 de setembro de 2023 a partir das 09h00 horas



Al. Sr. (a) Pregoeiro (a):

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido prego, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM                | ESPECIFICAÇÃO  | UND  | QUAND | MARÇA     | V. UNITÁRIO | EXTENSO UNITÁRIO             | V. TOTAL                               | EXTENSO TOTAL                          |
|---------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------------------------------|--|--|
| 1                   | ATADURA DE CREPOM 16CMX 180M. CONTENDO 13 HOS/CM. PESO 19,56. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS. ELASTICIDADE ADEQUADA. ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | ROLO | 40000 | BIOTEXTIL | R\$ 1,17    | um real e dezessete centavos | R\$ 46.800,00                          | quarenta e seis mil e oitocentos reais |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |      |       |           |             |                              | R\$ 46.800,00                          |  |
|                     |  |      |       |           |             |                              | quarenta e seis mil e oitocentos reais |  |

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;

b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

27 de Setembro de 2023.

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA    | VAL. UNIT. R\$ | VALOR TOTAL  | VAL. UNIT. EXTENSO                                 | VAL. TOTAL EXTENSO                                     |
|------|--|---------|------------|----------|----------------|--------------|--|--|
| 1    | ATADURA DE CREPOM 15CM X 1.80M. CONTENDO 13 FIOS/CM. PESO 19.5G. CONFEC-CIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS ESCLATICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EMFORMA CILINDRICA)SENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | ROLO    | 40 000     | NEVE     | 1,58           | R\$63.200,00 | um real e cinquenta e oito centavos                | sessenta e três mil e duzentos reais                   |
| 2    | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1.80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13.0G. CONFEC-CIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM BORDAS DELIMITADAS ESCLATICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EMFORMA CILINDRICA)SENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | ROLO    | 49.240     | ANAPOLIS | 1,84           | R\$90.601,60 | um real e oitenta e quatro centavos                | noventa mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos |
| 5    | BOTA DE UNNA-BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO. BANDAGEM DE VISCOSE E POLIAMIDA COM ELASTICIDADE BIDIRECIONAL IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR OXIDO DE ZINCO. PROPILA-HIDROXIBENZOATO. METIL-4-HIDROXIBENZOATO. GELATINA. CLORETO DE CALCIO. GLICEROL 85%. ALCOOL SECUNDARIO. EMULSÃO ANTIESPUMANTE DE SILICONE E AGUA. EMBALADA UNITARIAMENTE EM ENVELOPE LAMINADO POR POLIETILENO E ALUMINIO. ROLO DE 10 CM X 10 ME-TROS. | UNID.   | 150        | HELIANTO | 74,52          | R\$11.178,00 | setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos | onze mil, cento e setenta e oito reais                 |
| 6    | CREME DE BARRIEIRA. COMPOSTO POR AGUA, PARAFINA LIQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ALCOOL DE LANOLINA, ACIDO CITRICO. CITRATO DE MAGNESIO CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL INDICADO PARA CRIAR BARRIEIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVO. HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE RESSECADA EMBALAGEM COM 100G                              | UNID.   | 250        | HELIANTO | 84,00          | R\$21.000,00 | oitenta e quatro reais                             | vinte e um mil reais                                   |



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**  
**Pregão Eletrônico nº. 15/2023**

**Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min**

|    |   |       |     |          |       |              |  |                                      |
|----|---|-------|-----|----------|-------|--------------|--|--------------------------------------|
| 7  | <p>CREME HIDRATANTE COM UREIA E ACIDO LACTICO.CREME BRANCO, VISCOSO,NÃO ESTERIL,COMPOSTO POR AGUA,10% URÉIA(CARBAMIDA),PALMITATO DEISOPROPILO,PALMITATO DE OCTILA,ESTEARATO DE GLICERILA,4% DE ALFA HI-DROXIACIDO(ACIDO LACTICO), ALCOOL, ESTEARILICO, SORBITOL, LACTATO DEAMONIO, ACIDO ESTEARICO,CETEARETE-25 E CETEARETE-6,INDICADO PARA HI-DRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DI-ABÉTICOS.OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRE-SENTEM RESSECAMENTO, ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS.SEM CONSERVANTES,CORANTES OU PERFUME.REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍ-VEL DO DIABÉTICO.EMBALAGEM COM 100 ML.</p> | UNID. | 250 | HELIANTO | 54,88 | R\$13.720,00 | cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos | treze mil, setecentos e vinte reais  |
| 8  | <p>CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DECARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREG-NADO COM PRATA(25UG/CM2),ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXAADERENCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRUDAR NO LEITO DA LESÃO), FLEXIVEL E RESIS-TENTE.SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICA,HIPOALERGENICA, ESTÉRIL.TAMANHO: 10,5 CM X 19 CM.</p>  | UNID. | 100 | MISSNER  | 64,20 | R\$6.420,00  | sessenta e quatro reais e vinte centavos           | seis mil, quatrocentos e vinte reais |
| 10 | <p>CURATIVO DE ALGINATO DE CALÇIO E SODIO.COBERTURAS COMPOSTAS POR FIBRAS DE ACIDO ALGINICO(ACIDO GULURÔNICO E ACIDO MANURÔNICO) EXTRAÍ-DO DAS ALGAS MARINHAS MARRONS (LAMINARIA), CONTEM TAMBEM IONS DECALCIO E SODIO.CAMADA EXTERNA DE POLIUTERANO E CAMADA INTERNA COM-POSTA DE GELATINA,PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA. PROMOVE AHEMOSTASIA,ABSORVE EXSUDATO,FORMA UM GEL QUE MANTEM A UMIDADE,NHO:10 X 10 CM.</p>   | UNID. | 200 | MISSNER  | 14,40 | R\$2.880,00  | quatorze reais e quarenta centavos                 | dois mil, oitocentos e oitenta reais |



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**  
 Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min

|    |   |       |       |          |       |              |  |   |
|----|---|-------|-------|----------|-------|--------------|--|---|
| 12 | <p>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA 10 X 10 CM-<br/>                 CURATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE ESCARAS E FERIDAS<br/>                 EM GERAL. ALTA PERFORMANCE.ABSORVE MAIS EDURA<br/>                 MAIS, INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM<br/>                 LEVE A MODERA-DA EXSUDAÇÃO COMO ABRASOES E<br/>                 LACERACOES SUPERFICIAIS,RACHADURASDA<br/>                 PELE,ULCERAS DE PERNA(VENOSAS,ARTERIAIS E<br/>                 MISTAS),ULCERAS DIABETI-CAS E POR PRESSAO<br/>                 (PARCIAL E TOTAL). PREVENÇÃO DE ULCERAS POR<br/>                 PRESSÃO.EXCISOES DERMATOLÓGICAS,ÁREAS<br/>                 DOADORAS.INCISOES CIRURGICAS E FERI-DAS<br/>                 EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS,CAIXA COM 5<br/>                 UNIDADES.</p>  | CAIXA | 200   | MISSNER  | 60,00 | R\$12.000,00 | sessenta reais                           | doze mil reais                                    |
| 18 | <p>CURATIVO NAO ADERENTE QUE ESTIMULA A<br/>                 CICATRIZAÇÃO-COMPRESSA COM<br/>                 EMULSAO DE PETROLATUM 7.5X7.5</p>  | UNID. | 150   | HELIANTO | 12,04 | R\$1.806,00  | doze reais e quatro centavos             | mil oitocentos e seis reais                       |
| 20 | <p>CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X<br/>                 10M</p>   | UNID. | 100   | MISSNER  | 88,40 | R\$8.840,00  | oitenta e oito reais e quarenta centavos | oitomil, oitocentos e quarenta reais              |
| 23 | <p>EQUIPO FOTOSSENSIVEL-EQUIPO DE INFUSAO DE USO<br/>                 UNICO, CONSTITUIDO DEPONTA PERFUROCORANTE<br/>                 ADAPTAVEL AO SISTEMA FECHADO COM FILTRO AN-<br/>                 TIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA,CAMARA DE<br/>                 GOTEJAMENTO FLEXIVELTRANSPARENTE EM PVC COM<br/>                 COMPONENTE FOTOPROTETOR (20<br/>                 GOTAS/ML)COMFILTRO DE SOLUÇÃO DE 15MICRA,TUBO<br/>                 FLEXIVEL EM PVC COM COMPONENTE FO-<br/>                 TOPROTETOR,PINÇA CORTA FLUXO(TIPO<br/>                 ROLETE)INTERMEDIARIO POR SEGMENTO DE SILICONE<br/>                 GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO<br/>                 FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE,INJETOR LATERAL<br/>                 TIPO Y CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK,COM CAPA<br/>                 PROTETORA UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA PARENTERAL<br/>                 DELIQUIDOS FOTO SENSIVEIS COMPATIVELIS COM<br/>                 PVC.EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU<br/>                 CIRURGICO SELADO.ESTERELIZADO A OXIDO DE<br/>                 ETILENO.</p> | UNID  | 8.000 | LAMEDID  | 8,56  | R\$68.480,00 | oito reais e cinquenta e seis centavos   | sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais |
| 24 | <p>EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLUCOES<br/>                 PARENTERAIS,DE USO UNICO,ESTERILIZADO POR<br/>                 RADIAÇÃO GAMA, COM MATERIAL A TOXICO E<br/>                 APIROGÊNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ADAPTAVEL<br/>                 PARA AMPOLAS DE SISTEMA FECHADO.</p>   | UNID. | 2.800 | TKL      | 3,10  | R\$8.680,00  | três reais e dez centavos                | oitomil, seiscentos e oitenta reais               |





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO DE PREGÕES

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min

|    |  |       |        |           |        |             |  |  |
|----|--|-------|--------|-----------|--------|-------------|--|--|
| 25 | EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSAO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE,CAMARA GOTEJAMENTO TRANSPARENTE PROJETADA PARA 20ML,FILTROCOM POROS DE 200 MICRA,REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE,DUPLA CAMARAFLEXIVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 1.20M,LUER MACHO,ESTERIL,ATOXICO,APIROGENICO.EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICOCOM FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOSDE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,PRAZO DEVALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. | UNID. | 2.000  | LAMEDID   | 9,04   | RS18.080,00 | nove reais e quatro centavos             | dezoito mil e oitenta reais                    |
| 26 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO 119MM,ESTERIL,ATOXICO E APIROGENICO.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,PRODUTO DE USO UNICO.   | UNID. | 26.000 | KOLPLAST  | 2,76   | RS71.760,00 | dois reais e setenta e seis centavos     | setenta e um mil, setecentos e sessenta reais  |
| 27 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO 107MM,ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,PRODUTO DE USO UNICO.  | UNID. | 11.000 | KOLPLAST  | 2,40   | RS26.400,00 | dois reais e quarenta centavos           | vinte e seis mil e quatrocentos reais          |
| 28 | ETER SULFURICO LIQUIDO INCOLOR,DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL  | LITRO | 160    | VIVPHARMA | 72,40  | RS11.584,00 | setenta e dois reais e quarenta centavos | onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais  |
| 29 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO O COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM. FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO. ABSORVIVEL,SINTETICO.EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.  | CAIXA | 120    | SHALON    | 444,00 | RS53.280,00 | quatrocentos e quarenta e quatro reais   | cinquenta e três mil, duzentos e oitenta reais |
| 30 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM FIOCOM 90 CM DE COMPRIMENTO.ABSORVIVEL,SINTETICO.EMBALAGEM ESTERIL EMPAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. COM DADOS DE IDENTIFI-CAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE1 UNIDADE.  | CAIXA | 160    | SHALON    | 444,00 | RS71.040,00 | quatrocentos e quarenta e quatro reais   | setenta e um mil e quarenta reais              |



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min

|    |  |         |         |             |        |              |  |   |
|----|--|---------|---------|-------------|--------|--------------|--|---|
| 31 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4.0CM.COM FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO.ABSORVIVEL.SINTETICO.EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA.COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.TIPO DE ESTERELIZAÇÃO.APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.                         | CAIXA   | 80      | SHALON      | 406,00 | R\$32.480,00 | quatrocentos e seis reais                                    | trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais           |
| 32 | FIO PARA SUTURA EM MONOCRYL 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 19MM COM 45 CM DE COMPRIMENTO.ABSORVIVEL.INCOLOR, SINTETICO.EMBALAGEM ESTÉRIL EMPAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA.COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.TIPO DE ESTERELIZAÇÃO   | CAIXA   | 40      | ATRAMATT    | 268,76 | R\$10.750,40 | duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos   | dez mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos |
| 33 | GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO.HIDROGEL OU GEL HIDRATANTE COMPOSTO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO.CARBOXIMETILCELULOSE(CMC),PROPILENOGLICOL E GRANDE QUANTIDADE DE AGUA. CAPAZ DE PROMOVER O DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E FAVORECENDO A REMOÇÃO DAS ESCARASE DO TECIDO NECROTICO, EMBALAGEM COM 30 GRAMAS. | UNID.   | 200     | HELIANTO    | 33,60  | R\$6.720,00  | trinta e três reais e sessenta centavos                      | seis mil, setecentos e vinte reais                        |
| 36 | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G  | UNID.   | 200     | CASEX       | 33,60  | R\$6.720,00  | trinta e três reais e sessenta centavos                      | seis mil, setecentos e vinte reais                        |
| 37 | HIDROGEL COM PHMB. GEL AQUOSO OU HIDROGEL A BASE DE POLIHEXA METILBIGUANIDA (PHMB),HIDROCOLOIDES NATURAIS (PECTINA E CELULOSE), PROPILE-NOGLICOL E AGUA PURIFICADA.ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.  | UNID.   | 200     | HELIANTO    | 106,00 | R\$21.200,00 | cento e seis reais   | vinte e um mil e duzentos reais                           |
| 38 | LANCETA ESTÉRIL, DESCARTAVEL TAMANHO 0.4MM. PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE)  | UNIDADE | 119.000 | MEDLEVENSON | 0,34   | R\$40.460,00 | trinta e quatro centavos de real                             | quarenta mil, quatrocentos e sessenta reais               |
| 39 | PINÇA DESCARTAVEL CHERRON.ESTÉRIL, ATOXICA E APIROGENICA ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UNID.   | 6.600   | KOLPLAST    | 3,84   | R\$25.344,00 | três reais e oitenta e quatro centavos                       | vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais    |
| 40 | PINCETA(ALMOTOLIA)MARRON 250ML-RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO OU SIMILAR.COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UNID.   | 230     | JPROLAB     | 6,74   | R\$1.550,20  | seis reais e setenta e quatro centavos                       | mil quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos         |
| 41 | PINCETA(ALMOTOLIA) MARRON 500ML-RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO OU SIMILAR.COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.  | UNID.   | 206     | JPROLAB     | 9,96   | R\$2.051,76  | noventa e seis reais e novecentos e sessenta e seis centavos | dois mil, cinquenta e um reais e setenta e seis centavos  |

  
 Comissão de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará




A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO DE PREGÕES

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 as 08h:25min

|    |   |       |       |           |        |               |   |   |
|----|---|-------|-------|-----------|--------|---------------|---|---|
| 42 | PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ML-RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UNID. | 196   | J'PROLAB  | 9,96   | R\$1.952,16   | nove reais e noventa e seis centavos            | mil novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos            |
| 45 | POVIDINE DEGERMANTE-POLIVINIL PIRROLIDONA-IODO EM SOLUÇÃO DEGER-MANTE UM COMPLEXO ESTAVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE.E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VI-RUS E FUNGOS,EM ASSOCIAÇÃO COM TENSOATIVOS PROMOVE LIMPEZA E DESIN-FECCÃO DE MÃOS, BRAÇOS E CAMPO CIRÚRGICO 1000ML.  | UNID. | 1.312 | VIVPHARMA | 99,60  | R\$130.675,20 | noventa e nove reais e sessenta centavos        | cento e trinta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos |
| 46 | POVIDINE TOPICO-SOLUCAO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA-IODO(PVP-10% DE IODO ATIVO).ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS,VIRUS.FUNGOS,SEM IRRITAR A PELE 1000ML.  | UNID. | 812   | VIVPHARMA | 97,20  | R\$78.926,40  | noventa e sete reais e vinte centavos           | setenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos |
| 47 | PROTETOR CUTANEO SPRAY FRASCO DE NO MINIMO 280ML. FORMA UMA PELICULAPROTETORA DURADORA SOBRE A PELE INTACTA OU LESIONADA, EVITANDO OCONTATO DIRETO DA PELE COM LIQUIDOS.FLUIDOS CORPORAIS E FEZES POR ATE72 HORAS.PRODUTO INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DE OSTOMI-AS,FERIDAS, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECALAO REDOR DE CANULAS DE EN-TUBAÇÃO,TRAQUEOSTOMIA,DERMATITE E IRRITAÇÃO DA PELE,PODE SER USA-DO POR BEBÉS.CRIANÇAS E ADULTOS. | UNID. | 200   | MISSNER   | 72,28  | R\$14.456,00  | setenta e dois reais e vinte e oito centavos    | quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais                     |
| 48 | SOLUÇÃO DE PHMB. LIQUIDO A BASE DE AGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BE-TAINA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB)0,1%.PROMOVE LIMPEZA,HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITODE LESOES CRONICAS E AGUDAS.ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO POR-PORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO.INDICADOPARA LIMPEZA,HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS. EMBALAGEM COM 350 ML.          | UNID. | 130   | HELIANTO  | 157,20 | R\$20.436,00  | cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos | vinte mil, quatrocentos e trinta e seis reais                           |



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 COMISSÃO DE PREGÕES

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min

|    |   |       |     |          |       |              |  |  |
|----|---|-------|-----|----------|-------|--------------|--|--|
| 49 | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR N°14,CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SIS-TEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTA, MINAÇÃO OCUZADA, APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECRECOES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMI-TINDO SUCÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.</p> | UNID  | 300 | BE CARE  | 63,48 | R\$19.044,00 | sessenta e três reais e quarenta e oito centavos | dezenove mil e quarenta e quatro reais                 |
| 50 | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR N°16,CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA Sonda SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SIS-TEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTA, MINAÇÃO OCUZADA, APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECRECOES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMI-TINDO SUCÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.</p> | UNID  | 300 | BE CARE  | 63,48 | R\$19.044,00 | sessenta e três reais e quarenta e oito centavos | dezenove mil e quarenta e quatro reais                 |
| 51 | <p>SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 22 LONGA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM BATOC, SILICONIZADA, COM ORIFICIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA.</p>   | UNID. | 120 | MARK MED | 3,12  | R\$374,40    | três reais e doze centavos                       | trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos |



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h.-25min

|    |  |      |     |          |       |              |                                   |  |
|----|--|------|-----|----------|-------|--------------|-----------------------------------|--|
| 52 | <p>SONDA NASOENTERAL N°06 FR-CONFECCIONADA EM POLIURUTANO BRANCO. RADIOPACO. A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MA-LEAVEL, DURAVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DOESTOMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILAS EM DUPLA DERIVAÇÃO(FORMATOY), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRASDISTAIS DE PESO. OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PO AO POLIURUTANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTACÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO. EUM FIO GUIA DE CONDUÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PER-MITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTERIL</p> | UNID | 520 | MARK MED | 19,90 | R\$10.348,00 | dezenove reais e noventa centavos | dez mil, trezentos e quarenta e oito reais |
| 53 | <p>SONDA NASOENTERAL N°08 FR-CONFECCIONADA EM POLIURUTANO BRANCO. RADIOPACO. A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MA-LEAVEL, DURAVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DOY), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRASDISTAIS DE PESO. OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PO AO POLIURUTANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTACÃO NO ESTOMAGO/DUODENO. EUM FIO GUIA DE CONDUÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PER-MITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTERIL.</p>  | UNID | 120 | MARK MED | 19,90 | R\$2.388,00  | dezenove reais e noventa centavos | dois mil, trezentos e oitenta e oito reais |



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min

|    |   |      |       |          |       |              |   |  |
|----|---|------|-------|----------|-------|--------------|---|--|
| 54 | <p>SONDA NASOENTERAL N°12 FR-CONFECCIONADA EM POLIURUTANO BRANCO.RADIOPACO A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL.MA-LEAVEL.DURAVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DOESTOMAGO.COM CONECTOR PROXIMAL LILAS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATOY),QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRASDISTAIS DE PESO.OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PO AO POLIURUTANO PARA FACILITAR A MIGRACAO E SUA SUSTENTACÃO NO ESTOMAGO/DUODENO.EUM FIO GUIJA DE CONDUÇÃO.FABRICADO EM AÇO INOX.SEU CALIBRE FINO PER-MITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES(CARDIA E PILORO)DURANTE O TRAJETO.PRODUTO ESTERIL.</p>    | UNID | 1.280 | MARK MED | 19,90 | R\$25.472,00 | dozenove reais e noventa centavos           | vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais |
| 55 | <p>SONDA NASOENTERAL N°14 FR-CONFECCIONADA EM POLIURUTANO BRANCO.RADIOPACO A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MA-LEAVEL.DURAVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DOESTOMAGO.COM CONECTOR PROXIMAL LILAS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATOY),QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRASDISTAIS DE PESO.OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PO AO POLIURUTANO PARA FACILITAR A MIGRACÃO E SUA SUSTENTACÃO NO ESTOMAGO/DUODENO.EUM FIO GUIJA DE CONDUÇÃO.FABRICADO EM AÇO INOX.SEU CALIBRE FINO PER-MITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO.PRODUTO ESTERIL.</p> | UNID | 200   | SOLUMED  | 25,26 | R\$5.052,00  | vinte e cinco reais e vinte e seis centavos | cinco mil e cinquenta e dois reais                     |





**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**COMISSÃO DE PREGÕES**  
**Pregão Eletrônico nº. 15/2023**  
**Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min**

|  |  |       |        |          |        |              |   |  |
|--|--|-------|--------|----------|--------|--------------|---|--|
| 57   | <p>TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA-PRINCIPAIS CARACTERISTICAS-MEDETEMPORATURA EXTERNA E INTERNA;-POSSUI FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA;-UMIDADE INTERNA;-POSSUI BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO:°C OU °F;-POSSUI BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA;- MATERIAL:PLASTICO ABS;ATENDE AS PORTARIAS RDC 21/2004 (SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) E RDC 44/2009(FARMACIAS DROGARIAS E OUTROS);ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA:0°C A 50°C(32°F A 122°F);FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA:-50°A+70°C(-58°F A 58°F); RESOLUÇÃO:0.1°C/°F;EXATIDÃO INT/EXT:±1°C DE 0°C A 50°C,±2°C PARA O RESTANTE DA FAIXA, FAIXA DA UMIDADE: 15% A 95% UR; RE-SOLUÇÃO:1% UR; EXATIDAO:±5% UR; COMPRIMENTO DO CABO:±2.40M; FONTE DEALIMENTAÇÃO:PILHAS 1.5V-AAA;(INCLUSAS); DIMENSOES: 86X64X22MM;PESO:85G;</p> | UNID  | 90     | J,PROLAB | 201,60 | R\$18.144,00 | duzentos e um reais e sessenta centavos   | dezoito mil, cento e quarenta e quatro reais |
| 58   | <p>TORNEIRA DESCARTAVEL(3 VIAS)COM LUER LOCK.CONFECCIONADA EM POLI-CARBONATO.BIOCOMPATIVEL, MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS E CORPO DETORNEIRA FORMANDO PEÇA ÚNICA.ESTERILIZADA A GÁS ÓXIDO DE ETILENO.COM CONECTOR LOCK.COM VIA ADICIONAL DE PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO.ESSIMULTANEAS.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.NR.DO LOTE E REGISTRO NO MS. PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>   | UNID. | 16.000 | ABL      | 1,20   | R\$19.200,00 | um real e vinte centavos  | dezenove mil e duzentos reais                |
| <b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$1.073.738,12</b> |  |       |        |          |        |              | <b>um milhão e setenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos</b> |  |

**CONDIÇÕES:**  
**FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)**  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) DIAS a contar da data de sua apresentação.  
**PRazo DE FORNECIMENTO :** Conforme o edital.  
**PRazo DE GARANTIA DO PRODUTO :** Conforme o edital.  
**PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** Conforme o edital.  
 Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.  
**DECLARAMOS** cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



*[Handwritten signature]*



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO DE PREGÕES**

Pregão Eletrônico nº. 15/2023

**Data de ABERTURA: 27 de SETEMBRO de 2023 às 08h:25min**

**DECLARAMOS que entregaremos os produtos em até 10 (DEZ) dias UTEIS CONFORME O EDITAL**

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital.

Declaramos inteira responsabilidade por todos os prejuízos, perdas e danos que venham ocorrer referentes a entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desta certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;

Declaramos que cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854 de 27 /10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

Declaramos, sob as penas da Lei, principalmente a disposta no Art. 7º da Lei 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no Art. 4º, VII da Lei 10.520/2022.

**27 de SETEMBRO de 2023.**





À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. SETOR DE LICITAÇÕES  
At. Sr.(a) Pregoeiro(a)

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 15/2023-SESA/SRP  
Espécie: REGISTRO DE PREÇOS

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Peço presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Pregão Eletrônico nº PE 15/2023-SESA/SRP, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

3. **Objeto:** Constitui o objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

1. **Formação do Preço:**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | MARCA     | UNID | QUANT  | VL UNIT    | VL TOTAL       | VL UNIT (EXTENSO)                                  | VL TOTAL (EXTENSO)  |
|------|--|-----------|------|--------|------------|----------------|--|---|
| 1    | ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M, CONTENDO 13 FIOS/CM², PESO 19,5G, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADES ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | ANAPOLIS  | ROLO | 40.000 | R\$ 1,65   | R\$ 66.000,00  | um real e sessenta e cinco centavos                | sessenta e seis mil reais   |
| 2    | ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M, CONTENDO 13 FIOS/CM², PESO 13,5G, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADES ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | ANAPOLIS  | ROLO | 49.240 | R\$ 2,04   | R\$ 100.449,60 | dois reais e quatro centavos                       | cem mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos |
| 3    | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTES OU OPAÇA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.   | COLOPLAST | UNID | 3.200  | R\$ 102,00 | R\$ 326.400,00 | cento e dois reais                                 | trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos reais                  |
| 4    | BOLSA PARA COLOSTOMIA/ TELOSTOMIA DE UMA PEÇA DRENÁVEL, INFANTIL, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, 8-50MM (5/16-2") DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTES OU OPAÇA E RECONFORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.   | COLOPLAST | UNID | 480    | R\$ 93,00  | R\$ 44.640,00  | noventa e três reais                               | quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais                |
| 5    | BOTA DE UNNA - BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO, BANDAGEM DE VISCOSE E POLIAMIDA COM ELASTICIDADE BIDIRECIONAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR OXÍDO DE ZINCO, PROPIL 4-HIDROXIBENZOATO, GELATINA, CLORETO DE CÁLCIO, GLICEROL 85%, ÁLCOOL SECUNDÁRIO, EMULSÃO ANTIESPUMANANTE DE SILICONE E ÁGUA, EMBALADA UNITARIAMENTE EM ENVELOPE LAMINADO POR POLIETILENO E ALUMÍNIO, ROLO DE 10 CM X 10 METROS.   | CASEX     | UNID | 150    | R\$ 75,00  | R\$ 25,00      | setenta e cinco reais                              | vinte e cinco reais   |
| 6    | CREME DE BARREIRA, COMPOSTO POR ÁGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLIATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE JABONINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL, INDICADO PARA CRIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVO, HIDRATAR E REGULAR O PH PELE RESSECADA EMBALAGEM COM 100G.  | DBS       | UNID | 250    | R\$ 141,00 | R\$ 35.250,00  | cento e quarenta e um reais                        | trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais                    |
| 7    | CREME HIDRATANTE COM UREIA E ÁCIDO LÁTICO, CREME BRANCO, VISCOSO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁGUA, 10% UREIA (CARBAMIDA), PALMITO DE ISOPROPIL, PALMITO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, ESTEARÍLICO, SORBITOL, LACTADO DE AMÔNIO, ÁCIDO ESTEARÍCO, CETEARETE-25 E CETEARETE-6, INDICADO PARA HIDRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS, OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRESENTEM RESSECAIMENTO, ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS, SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME, REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO, EMBALAGEM COM 100G. | COLOPLAST | UNID | 250    | R\$ 255,00 | R\$ 63.750,00  | duzentos e cinquenta e cinco reais                 | sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais                 |
| 8    | CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA (25UG/CM2), ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLONDE BAIXA ADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/ GRUDAR NO LEITO DA LESÃO), FLEXÍVEL E RESISTENTE, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, ESTÉRIL, TAMANHO: 10,5CM X 19CM.   | CASEX     | UNID | 100    | R\$ 47,10  | R\$ 4.710,00   | quarenta e sete reais e dez centavos               | quatro mil, setecentos e dez reais                                |
| 9    | CURATIVO ANTIMICROBIANO NÃO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA, COBERTURANO ADESIVO COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA, ESPESSURA MÍNIMA 4MM, SEM ADESIVO, RECORTÁVEL, NÃO DEIXA RESÍDUO NA LESÃO, TAMANHO: 15 CM X 15 CM.   | ASKINA    | UNID | 150    | R\$ 309,84 | R\$ 46.476,00  | trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos | quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais          |
| 10   | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COBERTURAS COMPOSTAS POR FIBRAS DE ÁCIDO ALGÍNICO (ÁCIDO GULURÔNICO E ÁCIDO MANURÔNICO) EXTRAÍDO DAS ALGAS MARINHAS MARRONS (LAMINARIA), CONTÉM TAMBÉM IONS DE CÁLCIO E SÓDIO, CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO E CAMADA INTERNA COMPOSTA DE GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROMOVE A HEMOSTASIA, ABSORVE EXSUDATO, FORMA UM GEL QUE MANTÉM A UMIDADE, PROMOVE A GRANULAÇÃO E AUXILIA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, TAMANHO: 10X10 CM.  | ASKINA    | UNID | 200    | R\$ 65,01  | R\$ 13.002,00  | sessenta e cinco reais e um centavo                | treze mil e dois reais  |

|    |  |              |       |        |            |                |   |   |
|----|--|--------------|-------|--------|------------|----------------|---|---|
| 11 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PARA FERIDAS COM BAIXA E MÉDIO EXUDATO 10X20CM.   | ASKINA       | UNID  | 120    | R\$ 112,38 | R\$ 13.485,60  | cento e doze reais e trinta e oito centavos       | treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos |
| 12 | CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA 10X10CM - CURATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE ESCARAS E FERIDAS EM GERAL. ALTA PERFORMANCE, ABSORVE MAIS E DURA MAIS. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL) PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. CAIXA COM 5 UNIDADES.  | JOÃO MED     | CAIXA | 200    | R\$ 66,45  | R\$ 13.290,00  | sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos | treze mil, duzentos e noventa reais                                 |
| 13 | CURATIVO DE HIDROFIBRA. COBERTURA DE FIBRAS GELIFICANTES, COMPOSTO POR 100% DE NÃO TECIDO ESTÉRIL DE FIBRAS DE ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA) ENTRELACADAS QUE POSSUEM UM ALTO PODER DE ABSORÇÃO VERTICAL, REDUZINDO O RISCO DE MACERAÇÃO. CAPAZ DE PROMOVER A UMIDADE NECESSÁRIA, AUXILIANDO NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA, PODE SER MANTIDO POR ATÉ 7 DIAS NA LESÃO. TAMANHO 15X15 CM.   | COLOPLAST    | UNID  | 100    | R\$ 409,20 | R\$ 40.920,00  | quatrocentos e nove reais e vinte centavos        | quarenta mil, novecentos e vinte reais                              |
| 14 | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE PARA PROFILAXIA LLP 06 X 07   | MISSNER      | UND   | 150    | R\$ 102,60 | R\$ 15.390,00  | cento e dois reais e sessenta centavos            | quinze mil, trezentos e noventa reais                               |
| 15 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA - A CÉTICO), COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME. COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME, COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTEADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM EXSUDATO. TAMANHO 10X10CM.  | COLOPLAST    | UND   | 200    | R\$ 219,00 | R\$ 43.800,00  | duzentos e dezenove reais                         | quarenta e três mil, oitocentos reais                               |
| 16 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA - A CÉTICO), COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME. COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME, COM COSTURAS DE CELULOSE, REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL. PODE SER RECORTEADO EM QUALQUER DIREÇÃO, ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM EXSUDATO. TAMANHO 10X10CM.  | CASEX        | UND   | 100    | R\$ 195,00 | R\$ 19.500,00  | cento e noventa e cinco reais                     | dezenove mil, quinhentos reais                                      |
| 17 | CURATIVO HIDROPOLÍMERO OU HIDROCELULAR COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS, SENDO UM CENTRAL DE ESPUMA HIDROCELULAR OU HIPROPOLÍMERO (AMBOS EM POLIURETANO) QUE CONTROLA A ABSORÇÃO DO FLUÍDO PELA EXPANSÃO DAS CÉLULAS A MEDIDA QUE ABSORVE O EXSUDATO, E DUAS OUTRAS NÃO ADERENTES, A AGRSSÃO AOS TECIDOS NA SUA REMOÇÃO, FUNCIONAM PELA MANUTENÇÃO DA UMIDADE ABSORVENDO E RETENDO O EXCESSO DE EXSUDATO EM SUA ESTRUTURA POROSA QUE SE EXPANDE MOLDANDO-SE AO LEITO DA FERIDA.   | ASKINA       | UND   | 150    | R\$ 101,04 | R\$ 15.156,00  | cento e um reais e quatro centavos                | quinze mil, cento e cinquenta e seis reais                          |
| 20 | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 10CM.  | VITALMEDICAL | UND   | 100    | R\$ 435,00 | R\$ 43.500,00  | quatrocentos e trinta e cinco reais               | quarenta e três mil, quinhentos reais                               |
| 21 | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL - EQUIPO DE INFUSÃO DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDO DE PONTA PERFURADORA ADAPTÁVEL AO SISTEMA FECHADO COM FILTRO ANTIBACTERICIDA DE AR E CAPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR (20 GOTAS/ML COM FILTRO DE SOLUÇÃO DE 15MICRA, TUBO LEXÍVEL EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLLETE) INTERMEDIÁRIA POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE, INJETOR LATERAL TIPO Y CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK, COM CAPA PROTETORA UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA PARENTERAL DE LÍQUIDOS FOTO SENSÍVEIS COMPATÍVEIS COM PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO SELADO, ESTERELIZADO A OXÍDO DE ETILENO. | MEDIX        | UND   | 8.000  | R\$ 2,34   | R\$ 18.720,00  | dois reais e trinta e quatro centavos             | dezoito mil, setecentos e vinte reais                               |
| 24 | EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, COM ATERIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADPTÁVEL PARA AMPOLAS DE SISTEMA FECHADO.  | MEDIX        | UND   | 2.800  | R\$ 3,60   | R\$ 10.080,00  | três reais e sessenta centavos                    | dez mil e oitenta reais   |
| 25 | EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÃO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE, CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE PROJETADA PARA 20 ML, FILTRO COM POROS DE 200 MICRA, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLLETE, DUPLA CÂMARA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20ML, LUER MACHO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORNÃO COMPETENTE.  | MEDIX        | UND   | 2.000  | R\$ 1,65   | R\$ 3.300,00   | um real e sessenta e cinco centavos               | três mil, trezentos reais   |
| 26 | ESPELULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MÉDIO 119MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO.  | KOLPLAST     | UND   | 26.000 | R\$ 4,17   | R\$ 108.420,00 | quatro reais e dezessete centavos                 | cento e oito mil, quatrocentos e vinte reais                        |
| 27 | ESPELULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MÉDIO 107MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO.  | KOLPLAST     | UND   | 11.000 | R\$ 4,17   | R\$ 45.870,00  | quatro reais e dezessete centavos                 | quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais                    |

*[Handwritten signature]*

|    |   |              |       |         |            |                |   |   |
|----|---|--------------|-------|---------|------------|----------------|---|---|
| 28 | ETER SULFURICO LÍQUIDO INCOLOR, DE ODORE PENETRANTE, INFLAMÁVEL E VOLÁTIL.  | RIOQUIMICA   | LITRO | 160     | R\$ 135,00 | R\$ 21.600,00  | cento e trinta e cinco reais                          | vinte e um mil, seiscentos reais                                    |
| 29 | FIO PARA SUTURA EM ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM, FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.   | SHALON       | CAIXA | 120     | R\$ 705,00 | R\$ 84.600,00  | setecentos e cinco reais                              | oitenta e quatro mil, seiscentos reais                              |
| 30 | FIO PARA SUTURA EM ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM, FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.   | SHALON       | CAIXA | 160     | R\$ 705,00 | R\$ 112.800,00 | setecentos e cinco reais                              | cento e doze mil, oitocentos reais                                  |
| 31 | FIO PARA SUTURA EM ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM, FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.   | SHALON       | CAIXA | 80      | R\$ 705,00 | R\$ 56.400,00  | setecentos e cinco reais                              | cinquenta e seis mil, quatrocentos reais                            |
| 33 | GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, HIDROGEL OU GEL HIDRATANTE COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE(CMC), PROPILENOGLICOL E GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA. CAPAZ DE PROMOVER O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO E FAVORECIDO A REMOÇÃO DAS ESCARAS E DO TECIDO NECRÓTICO, EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.   | CASEX        | UNID  | 200     | R\$ 29,88  | R\$ 5.976,00   | vinte e nove reais e oitenta e oito centavos          | cinco mil, novecentos e setenta e seis reais                        |
| 34 | HIDROCOLÓIDE - CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE E IMPERMEABILIZÁVEL A ÁGUA - COMPOSTO POR UMA CAMADA EXTERNA AUTOADESIVANTE CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI - ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO. TAMANHO 15CM X 15CM.  | CASEX        | UNID  | 100     | R\$ 48,00  | R\$ 4.800,00   | quarenta e oito reais                                 | quatro mil, oitocentos reais  |
| 36 | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G   | CASEX        | UNID  | 200     | R\$ 40,56  | R\$ 8.112,00   | quarenta reais e cinquenta e seis centavos            | oito mil, cento e doze reais  |
| 37 | HIDROGEL COM PHMB. GEL AQUOSO OU HIDROGEL À BASE DE POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) HIDROCOLÓIDES NATURAIS (PECTINA E CELULOSE), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA, ANTIMICRIBIANO DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.  | CASEX        | UNID  | 200     | R\$ 50,88  | R\$ 10.176,00  | cinquenta reais e oitenta e oito centavos             | dez mil, cento e setenta e seis reais                               |
| 38 | LANCETA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE)   | MEDLEVENSOHN | UNID  | 119.000 | R\$ 0,36   | R\$ 42.840,00  | trinta e seis centavos                                | quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais                    |
| 39 | PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | CRAL         | UNID  | 6.600   | R\$ 12,87  | R\$ 84.942,00  | doze reais e oitenta e sete centavos                  | oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais            |
| 40 | PINCETA (ALMOTÓLIA) MARROM 250ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | JPROLAB      | UNID  | 230     | R\$ 7,23   | R\$ 1.662,90   | sete reais e vinte e três centavos                    | um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos       |
| 41 | PINCETA (ALMOTÓLIA) MARROM 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | JPROLAB      | UNID  | 206     | R\$ 10,68  | R\$ 2.200,08   | dez reais e sessenta e oito centavos                  | dois mil, duzentos reais e oito centavos                            |
| 42 | PINCETA (ALMOTÓLIA) TRANSPARENTE 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | JPROLAB      | UNID  | 196     | R\$ 10,68  | R\$ 2.093,28   | dez reais e sessenta e oito centavos                  | dois mil e noventa e três reais e vinte e oito centavos             |
| 43 | PIPETA PASTEUR PLÁSTICA 3ML - PIPIETA PASTEUR ESTERIL PARA TRANSFERÊNCIA DE SEGURA DE AMOSTRAS. FABRICADO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E NÃO TÓXICO - BULBO MOLDADO EM UMA ÚNICA PEÇA, ELIMINANDO CONTAMINAÇÃO. TRANSPARENTES E COM PAREDES UNIFORMES. GRADUAÇÃO PRECISA DE 0,5-3,0 ML.   | NEOLAB       | UNID  | 8.000   | R\$ 0,42   | R\$ 3.360,00   | quarenta e dois centavos                              | três mil, trezentos e sessenta reais                                |
| 44 | PÓ DE HIDROCOLÓIDE - PÓ QUE PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES NO LOCAL DO ESTOMA.  | CASEX        | UNID  | 200     | R\$ 94,44  | R\$ 18.888,00  | noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos   | dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais                      |
| 45 | POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VÍRUS E FUNGOS, EM ASSOCIAÇÃO COM TENSIOATIVOS PROMOVE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MÃOS, BRAÇOS E CAMPO CIRÚRGICO 1000ML.  | RIOQUIMICA   | UNID  | 1.312   | R\$ 56,70  | R\$ 74.390,40  | cinquenta e seis reais e setenta centavos             | setenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos |
| 46 | POVIDINE TÓPICO - SOLUÇÃO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 1-% DE IODO ATIVO), ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VÍRUS, FUNGOS, SEM IRRITAR A PELE 1000ML.   | RIOQUIMICA   | UNID  | 812     | R\$ 56,70  | R\$ 46.040,40  | cinquenta e seis reais e setenta centavos             | quarenta e seis mil e quarenta reais e quarenta centavos            |
| 47 | PROTETOR CUTANEO SPRAY FRASCO DE NO MÍNIMO 28ML. FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA DURADORA SOBRE A PELE INTACTA OU LESIONADA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DA PELE COM LÍQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS E FEZES POR ATÉ 72 HORAS. PRODUTO INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DE OSTOMIAS, FERIDAS, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, AO REDOR DE CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO, TRAQUEOSTOMIA, DERMATITE E IRRITAÇÃO DA PELE, PODE SER USADO POR BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS. | 3M           | UNID  | 200     | R\$ 294,00 | R\$ 58.800,00  | duzentos e noventa e quatro reais                     | cinquenta e oito mil, oitocentos reais                              |
| 48 | SOLUÇÃO DE PHMB, LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BETAIRINA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) 0,1%, PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO PROPORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICRIBIANO, INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS. EMBALAGEM COM 350ML.           | CASEX        | UNID  | 130     | R\$ 136,86 | R\$ 17.791,80  | cento e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos | dezessete mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos   |



|    |   |         |      |       |     |       |     |           |   |   |
|----|---|---------|------|-------|-----|-------|-----|-----------|---|---|
| 49 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR N º14, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA IRRIGAÇÃO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.  | WILTEX  | UNID | 300   | R\$ | 2,28  | R\$ | 684,00    | dois reais e vinte e oito centavos      | seiscentos e oitenta e quatro reais                           |
| 50 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR N º16, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA IRRIGAÇÃO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.  | MEDIX   | UNID | 300   | R\$ | 2,64  | R\$ | 792,00    | dois reais e sessenta e quatro centavos | setecentos e noventa e dois reais                             |
| 51 | SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA Nº 22 LONGA DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOÇ SILICONIZADA, COM RIFÍCIDOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASÉPTICA.   | FOYOMED | UNID | 120   | R\$ | 13,98 | R\$ | 1.677,60  | treze reais e noventa e oito centavos   | um mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos |
| 52 | SONDA NASOENTERAL Nº 06 FR - CONFECCIONADA EM POLIETILÉNO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y) QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIETILÉNO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO / DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX, SEU CALIVRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESCINTERES (CARDA E BUBO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | MEDIX   | UNID | 520   | R\$ | 29,40 | R\$ | 15.288,00 | vinte e nove reais e quarenta centavos  | quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais                   |
| 53 | SONDA NASOENTERAL Nº 08 PH - CONFECCIONADA EM POLIETILÉNO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y) QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIETILÉNO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO / DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX, SEU CALIVRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESCINTERES (CARDA E BUBO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | MEDIX   | UNID | 120   | R\$ | 29,40 | R\$ | 3.528,00  | vinte e nove reais e quarenta centavos  | três mil, quinhentos e vinte e oito reais                     |
| 54 | SONDA NASOENTERAL Nº 12 FR - CONFECCIONADA EM POLIETILÉNO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y) QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIETILÉNO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO / DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX, SEU CALIVRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESCINTERES (CARDA E BUBO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | MEDIX   | UNID | 1.280 | R\$ | 29,40 | R\$ | 37.632,00 | vinte e nove reais e quarenta centavos  | trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais           |
| 55 | SONDA NASOENTERAL Nº 14 FR - CONFECCIONADA EM POLIETILÉNO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y) QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIETILÉNO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO / DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX, SEU CALIVRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESCINTERES (CARDA E BUBO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | MEDIX   | UNID | 200   | R\$ | 29,40 | R\$ | 5.880,00  | vinte e nove reais e quarenta centavos  | cinco mil, oitocentos e oitenta reais                         |
| 56 | SONDA NASOENTERAL Nº 16 FR - CONFECCIONADA EM POLIETILÉNO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y) QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIETILÉNO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO / DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX, SEU CALIVRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESCINTERES (CARDA E BUBO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | MEDIX   | UNID | 200   | R\$ | 29,40 | R\$ | 5.880,00  | vinte e nove reais e quarenta centavos  | cinco mil, oitocentos e oitenta reais                         |

*[Assinatura]*

|                                 |   |          |      |        |     |        |     |                                 |  |   |  |
|---------------------------------|---|----------|------|--------|-----|--------|-----|---------------------------------|--|---|--|
| 57                              | TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADERA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - MEDE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; POSSUI FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA; - UMIDADE INTERNA; - POSSUI BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO; °C OU °F; POSSUI BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA; - MATERIAL: PLÁSTICO ABS; ATENDE AS PORTARIAS RDC 21/2004 (SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) E RDC 44/2009 (FARMÁCIAS DROGARIAS E OUTROS); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F); FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50° A +70°C (-58°F A 158°F); RESOLUÇÃO: 0,1°C / ° F; EXATIDÃO INT/EXT: ± 1°C DE 0°C A 50°C, ± 2° C PARA O RESTANTE DA FAIXA, FAIXA DA UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 1%UR; EXATIDÃO: ±5%UR; COMPRIMENTO DO CABO: ±2,40M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; PILHAS 1,5V - AAA; (INCLUSAS) - DIMENSÕES: | INCOTERM | UNID | 90     | R\$ | 216,00 | R\$ | 19.440,00                       | duzentos e dezesseis reais   | dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais |  |
| 58                              | TORNEIRA DESCARTÁVEL (3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, BIOCOMPATÍVEL, MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS E CORPO DE TORNEIRA FORMANDO PEÇA ÚNICA, ESTERILIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO, COM CONECTOR LOCK, COM VIA ADICIONAL DE PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÕES SIMULTÂNEAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NACIONAL  | MEDIX    | UNID | 16.000 | R\$ | 1,50   | R\$ | 24.000,00                       | um real e cinquenta centavos   | vinte e quatro mil reais                    |  |
| <b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b> |   |          |      |        |     |        | R\$ | <b>1.864.408,66</b>             | <b>um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e seis centavos</b> |   |  |
|                                 |   |          |      |        |     |        |     | <b>TOTAL GLOBAL POR EXTENSO</b> |  |   |  |





**AO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 15/2023-SESA/SRP**  
**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANT | UNIDADE | MARCA      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|------|---|-------|---------|------------|----------------|----------------|
| 1    | ATADURA DE CREPOM 15CMX 1.80M. CONTENDO 13 FIOS/CM. PESO 19.5G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | 40000 | ROLO    | BIOTEXTIL  | R\$ 1,72       | R\$ 68.800,00  |
| 2    | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1.80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13.0G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | 49240 | ROLO    | BIOTEXTIL  | R\$ 2,29       | R\$ 112.759,60 |
| 3    | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | 3200  | UNID    | MASTER WIN | R\$ 21,68      | R\$ 69.376,00  |
| 4    | BOLSA PARA COLOSTOMIA/IELOSTOMIA DE UMA PEÇA DRENÁVEL INFANTIL, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL 8-50MM (5/16-2") DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | 480   | UNID    | CONVATEC   | R\$ 69,28      | R\$ 33.254,40  |
| 5    | BOTA DE UNNA - BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO BANDAGEM DE VISCOSE E POLIAMIDA COM ELASTICIDADE BIDIRECIONAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR OXIDO DE ZINCO, PROPIL4-HIDROXIBENZOATO1D.METIL-4-HIDROXIBENZOATO, GELATINA. CLORETO DE CALDO, GLICEROL 85%, ÁLCOOL SECUNDÁRIO, EMULSÃO ANTIESPUMANTE DE SILICONE E AGUA, EMBALADA UNITARIAMENTE EM ENVELOPE LAMINADO POR POLIETILENO E ALUMINIO. ROLO DE 10 CM 10 METROS.   | 150   | UNID    | CONVATEC   | R\$ 83,37      | R\$ 12.505,50  |
| 7    | CREME HIDRATANTE COM UREIA E ACIDO LACTICO. CREME BRANCO. VISCOSO. NÃO ESTERIL. COMPOSTO POR AGUA, 10% UREIA (CARBAMIDA), PALMITATO DE ISOPROPILIO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁCTICO), ÁLCOOL ESTEARILICO, SORBITOL LACTATO DE AMÔNIO, ÁCIDO ESTEÁRICO, CETEARETE-25 E CETEARETE-6. INDICADO PARA HIDRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOUÇAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRESENTEM RESSECAMENTO. ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME. REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. EMBALAGEM COM 100 ML. | 250   | UNID    | CIMED      | R\$ 69,28      | R\$ 17.320,00  |
| 8    | CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA (25UG/CM2). ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRUDAR NO LEITO DA LESÃO). FLEXIVEL E ESISTENTE. SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATOXICA. HIPOALERGENICA, ESTÉRIL TAMANHO: 10.5 CM 19 CM.  | 100   | UNID    | CONVATEC   | R\$ 70,99      | R\$ 7.099,00   |
| 9    | CURATIVO ANTIMICROBIANO NÃO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA. COBERTURA NÃO ADESIVA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA, ESPESSURA MÍNIMA 4MM. SEM ADESIVO, RECORTÁVEL. NÃO DEIXA RESÍDUO NA LESÃO. TAMANHO: 15 CM X 15 CM.  | 150   | UNID    | COLOPLAST  | R\$ 405,16     | R\$ 60.774,00  |





|    |   |       |       |             |              |  |               |   |
|----|---|-------|-------|-------------|--------------|--|---------------|---|
| 10 | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. COBERTURAS COMPOSTAS POR FIBRAS DE ÁCIDO ALGÍNICO (ÁCIDO GULURÔNICO E ÁCIDO HIALURÔNICO) EXTRAÍDO DAS ALGAS MARINHAS MARRONS (LAMINÁRIA). CONTEM TAMBÉM IONS DE CÁLCIO E SÓDIO. CAMADA EXTERNA DE POLIETERANO E CAMADA INTERNA COMPOSTA DE GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. PROMOVE A HEMOSTASIA. ABSORVE EXSUDATO. FORMA UM GEL QUE MANTÉM A UMIDADE, PROMOVE A GRANULAÇÃO E AUXILIA O DESBRIDAMENTO AUTO-LÍTICO. TAMANHO: 10 X 10 CM.   | 200   | UNID  | CURATEC     | R\$ 23,82    | vinte e três reais e oitenta e dois centavos             | R\$ 4.764,00  | quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais.                     |
| 11 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PARA FERIDAS COM BAIXA E MÉDIO EXUDATO 10X20CM   | 120   | UNID  | CURATEC     | R\$ 33,07    | trinta e três reais e sete centavos                      | R\$ 3.968,40  | três mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos      |
| 12 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE EM PLACA 10 X 10 CM - CURATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE ESCARAS E FERIDAS EM GERAL. ALTA PERFORMANCE. ABSORVE MAIS E DURA MAIS. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO. COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS. RACHADURA DA PELE. ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS) ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL). PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO. EXCIÇÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS. INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. CAIXA COM 5 UNIDADES.  | 200   | CAIXA | CASEX       | R\$ 181,13   | cento e oitenta e um reais e treze centavos              | R\$ 36.226,00 | trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais                  |
| 14 | CURATIVO DO TIPO FILME TRANSPARENTE PARA PROFILAXIA LLP 06 X 07   | 150   | UNID  | VITAL DERME | R\$ 3,92     | três reais e noventa e dois centavos                     | R\$ 588,00    | quinhentos e oitenta e oito reais                                     |
| 15 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA -A CÉTICO), COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 10X10.   | 200   | UNID  | CONVATEC    | R\$ 167,34   | cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos | R\$ 33.468,00 | trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais               |
| 16 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA -ACÉTICO). COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERA - DA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO. PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15 X 15 | 100   | UNID  | CONVATEC    | R\$ 314,87   | trezentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos     | R\$ 31.487,00 | trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais                  |
| 18 | CURATIVO NÃO ADERENTE QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO - COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM 7,5 X 7,5   | 150   | UNID  | CURATEC     | R\$ 15,70    | quinze reais e setenta centavos                          | R\$ 2.355,00  | dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais                         |
| 20 | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 10M   | 100   | UNID  | VITAL DERME | R\$ 197,63   | cento e noventa e sete reais e sessenta e três centavos  | R\$ 19.763,00 | dezenove mil, setecentos e sessenta e três reais                      |
| 21 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NR 6-. MASCULINO COLETOR PENIANO EM LATEX COM TUBO COM EXTENSAO. A EXTREMIDADE DISTAL DO TUBO DEVERA SER COLOCADA EM RECEPTACULO (NÃO INCLUIDO) PARA COLETA DA URINA, ACOMPANHA PRESERVATIVO  | 1.200 | UNID  | EMBRAMED    | R\$ 13,76    | treze reais e setenta e seis centavos                    | R\$ 16.512,00 | dezessis mil, quinhentos e doze reais                                 |
| 22 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL COMO APARELHO LIFE 400 CMOS DRAKE ADULTO. COM CONECTOR PRETO   | 24    | UNID  | CMOS DRAKE  | R\$ 1.337,06 | mil trezentos e trinta e sete reais e seis centavos      | R\$ 32.089,44 | trinta e dois mil e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos |



|    |  |        |       |            |            |   |               |   |
|----|--|--------|-------|------------|------------|---|---------------|---|
| 23 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL -. EQUIPO DE INFUSAO DE USO UNICO. CONSTITUIDO DE PONTA PERFUCORTANTE ADAPTÁVEL AO SISTEMA FECHADO COM FILTRO AN - TIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL. TRANSPARENTE EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR (20 GOTAS/ML) COM FILTRO DE SOLUÇÃO DE ISMIRIA. TUBO FLEXÍVEL EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR. PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) INTERMEDIARJO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE. INJETOR LATERAL TIPO Y CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK. COM CAPA PROTETORA UTILIZADO PARA INFUSAO VIA PARENTERAL DE LÍQUIDOS FOTO SENSÍVEIS COMPATÍVEIS COM PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO SELADO. ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO. | 8.000  | UNID  | LAMEDID    | R\$ 8,61   | oito reais e sessenta e um centavos                 | R\$ 68.880,00 | sessenta e oito mil, quocentos e oitenta reais            |
| 24 | EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS. DE USO UNICO. ESTERILIZMJO POR RADIAÇÃO GAMA, COM MATERIAL ATOXICO E APIROGÊNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ADAPTA VEL PARA AMPOLAS DE SISTEMA FECHADO.   | 2.800  | UNID  | MEDSONDA   | R\$ 5,70   | cinco reais e setenta centavos                      | R\$ 15.960,00 | quinze mil, novecentos e sessenta reais                   |
| 25 | EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSAO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFORANTE, CÂMARA GOTEJAMENTO TRANSPARENTE PROJETADA PARA 20ML - FILTRO COM POROS DE 200 MICRA, REGULADOR DEFLUXO TIPO ROLETE, DUPLA CÂMARA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M, LUER MACHO, ESTÉRIL ATOXICO, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.  | 2.000  | UNID  | LAMEDID    | R\$ 9,03   | nove reais e três centavos                          | R\$ 18.060,00 | dezoito mil e sessenta reais                              |
| 26 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MÉDIO 119MM, ESTERIL, ATOXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO  | 26.000 | UNID  | KOLPLAST   | R\$ 2,72   | dois reais e setenta e dois centavos                | R\$ 70.720,00 | setenta mil, setecentos e vinte reais                     |
| 27 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO 107MM. ESTÉRIL ATOXICO E APIROGENICO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. PRODUTO DE USO ÚNICO   | 11.000 | UNID  | KOLPLAST   | R\$ 2,50   | dois reais e cinquenta centavos                     | R\$ 27.500,00 | vinte e sete mil e quinhentos reais                       |
| 28 | ETER SULFURICO LIQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE. INFLAMAVEL E VOLÁTIL   | 160    | LITRO | RIOQUIMICA | R\$ 80,88  | oitenta reais e oitenta e oito centavos             | R\$ 12.940,80 | doze mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos  |
| 29 | FIO PARA SUTURA EM ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM. FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL. SINTÉTICO. EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.  | 120    | CAIXA | SHALON     | R\$ 17,07  | dezessete reais e sete centavos                     | R\$ 2.048,40  | dois mil e quarenta e oito reais e quarenta centavos      |
| 30 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4.8CM FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVIVEL SINTÉTICO. EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.  | 160    | CAIXA | SHALON     | R\$ 17,07  | dezessete reais e sete centavos                     | R\$ 2.731,20  | dois mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos |
| 31 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4.0CM COM FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL. SINTÉTICO. EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TIPO DE ESTERELIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE  | 80     | CAIXA | SHALON     | R\$ 15,65  | quinze reais e sessenta e cinco centavos            | R\$ 1.252,00  | mil duzentos e cinquenta e dois reais                     |
| 33 | GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. HIDROGEL OU GEL HIDRA - TANTE COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CARBOXIMEFILCELULOSE (CMC). PROPILENOGLICOL E GRANDE QUANTIDADE DE AGUA, CAPAZ DE PROMOVER O DESBRIDAMESTO AUTOLÍTICO E FAVORECENDO A REMOÇÃO DAS ESCARAS E DO TECIDO NECROTICO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.   | 200    | UNID  | HELIANTO   | R\$ 117,45 | cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos | R\$ 23.490,00 | vinte e três mil, quatrocentos e noventa reais            |

|    |   |         |      |               |            |   |                |   |
|----|---|---------|------|---------------|------------|---|----------------|---|
| 34 | HIDROCOLOIDE - CURATIVO PRIMARIO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE E IMPERMEIA - VEL A AGUA - COMPOSTO POR UMA CAMADA EXTERNA AUTOADESIVA CONTENDO HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO, TAMANHO 15CM X 15CM.  | 100     | UNID | CURATEC       | R\$ 35,96  | trinta e cinco reais e noventa e seis centavos              | R\$ 3.596,00   | três mil, quinhentos e noventa e seis reais   |
| 36 | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G   | 200     | UNID | CURATEC       | R\$ 141,69 | cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos      | R\$ 28.338,00  | vinte e oito mil, trezentos e trinta e oito reais                                   |
| 37 | HIDROGEL COM PHMB. GEL AQUOSO OU HIDROGEL A BASE DE POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB). HIDROCOLOIDES NATURAIS (PECFINA E CELULOSE), PROPILENOGLICOL E AGUA PURIFICADA, ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO, EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.   | 700     | UNID | CASEX         | R\$ 66,12  | sessenta e seis reais e doze centavos                       | R\$ 13.224,00  | treze mil, duzentos e vinte e quatro reais  |
| 38 | LANCEIA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE)   | 119.000 | UNID | MEDLEVENSO HN | R\$ 0,11   | onze centavos de real                                       | R\$ 13.090,00  | treze mil e noventa reais   |
| 39 | PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, ESTÉRIL, ATOXICA E APIROGENICA ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | 6.600   | UNID | VAGISPEC      | R\$ 3,97   | três reais e noventa e sete centavos                        | R\$ 26.202,00  | vinte e seis mil, duzentos e dois reais   |
| 40 | PINCETA (ALMOTOLIA) MARRON 250ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | 230     | UNID | JON           | R\$ 7,06   | sete reais e seis centavos                                  | R\$ 1.623,80   | mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos                              |
| 41 | PINCETA (ALMOTOLIA) MARRON 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | 206     | UNID | JON           | R\$ 10,43  | dez reais e quarenta e três centavos                        | R\$ 2.148,58   | dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos                 |
| 42 | PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | 196     | UNID | JON           | R\$ 10,43  | dez reais e quarenta e três centavos                        | R\$ 2.044,28   | dois mil e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos                          |
| 43 | PIPETA PASTEUR PLÁSTICA 3ML - PIPIETA PASTEUR ESTERIL PARA TRANSFERENCIA DE SEGURA DE AMOSTRAS, FABRICADO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E NÃO TOXICO; BULBO MOLDADO EM UMA ÚNICA PEÇA, ELIMINANDO CONTAMINAÇÃO; TRANSPARENTES E COM PAREDES UNIFORMES; GRADUAÇÃO PRECISA DE 0,5-3,0 ML.  | 8.000   | UNID | LABOR IMPORT  | R\$ 0,55   | cinquenta e cinco centavos de real                          | R\$ 4.400,00   | quatro mil e quatrocentos reais   |
| 44 | PO DE HIDROCOLOIDE - PO QUE PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES NO LOCAL DO ESTOMA.  | 200     | UNID | COLOPLAST     | R\$ 193,43 | cento e noventa e três reais e quarenta e três centavos     | R\$ 38.686,00  | trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais                                |
| 45 | POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLUÇÃO DEGERMANTE UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VÍRUS E FUNGOS, EM ASSOCIAÇÃO COM TENSOATIVOS PROMOVE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MÃOS, BRAÇOS E CAMPO CIRÚRGICO 1000ML.  | 1.312   | UNID | RIOQUIMICA    | R\$ 101,52 | cento e um reais e cinquenta e dois centavos                | R\$ 133.194,24 | cento e trinta e três mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos |
| 46 | POVIDINE TÓPICO - SOLUÇÃO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP -10% DE IODO ATIVO), ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VÍRUS, FUNGOS, SEM IRRITAR A PELE 1000ML.  | 812     | UNID | RIOQUIMICA    | R\$ 99,15  | noventa e nove reais e quinze centavos                      | R\$ 80.509,80  | oitenta mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos                             |
| 47 | PROTETOR CUTANEO SPRAY FRASCO DE NO MINIMO 28ML. FORMA UMA PELICULA PROTETORA DURADORA, SOBRE A PELE INTACTA OU LESIONADA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DA PELE COM LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS E FEZES POR ATÉ 72 HORAS. PRODUTO INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DE OSTOMIAS, FERIDAS, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, AO REDOR DE CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO, TRAQUEOSTOMIA, DERMATITE E IRRITAÇÃO DA PELE PODE SER USADO POR BEBES, CRIANÇAS E ADULTOS. | 200     | UNID | 3M            | R\$ 267,95 | duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos | R\$ 53.590,00  | cinquenta e três mil, quinhentos e noventa reais                                    |
| 48 | SOLUÇÃO DE PHMB. LIQUIDO A BASE DE AGUA PURIFICADA. COMPOSTO POR BETAÍNA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO POR FORNECENDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO. INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS. EMBALAGEM COM 350 ML.            | 130     | UNID | PIELSANA      | R\$ 245,82 | duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos | R\$ 31.956,60  | trinta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos            |



|    |   |       |      |          |           |     |           |   |   |   |
|----|---|-------|------|----------|-----------|-----|-----------|---|---|---|
| 49 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nº14, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E A SECREÇÃO. DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES   | 300   | UNID | BIOTEC   | R\$ 75,94 | R\$ | 22.782,00 | setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos | setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos | setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos |
| 50 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nº16, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE. POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM O SISTEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES   | 300   | UNID | BIOTEC   | R\$ 75,94 | R\$ | 22.782,00 | setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos | setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos | setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos |
| 51 | SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA Nº22 LONGA DESCARTÁVEL. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE. COM BATOÇ. SILICONIZADA. COM ORIFÍCIOS LATERAIS. CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA.   | 120   | UNID | MARK MED | R\$ 3,77  | R\$ | 452,40    | três reais e setenta e sete centavos              | três reais e setenta e sete centavos              | três reais e setenta e sete centavos              |
| 52 | SONDA NASOENTERAL N 06 FR - CONFECCIONADA EM POLIÉTERANO BRANCO, RADIOOPACO. A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DO ESTOMAGO. COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y). QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS (I) DISTAIS DE PESO. OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIÉTERANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÓMAGO/DUODENO. E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL.  | 520   | UNID | MEDICONE | R\$ 21,00 | R\$ | 10.920,00 | vinete e um reais                                 | vinete e um reais                                 | vinete e um reais                                 |
| 53 | SONDA NASOENTERAL N 08 FR - CONFECCIONADA EM POLIÉTERANO BRANCO, RADIOOPACO. A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DO ESTOMAGO. COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y). QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS (I) DISTAIS DE PESO. OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIÉTERANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÓMAGO/DUODENO. E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL.  | 120   | UNID | MEDICONE | R\$ 21,00 | R\$ | 2.520,00  | vinete e um reais                                 | vinete e um reais                                 | vinete e um reais                                 |
| 54 | SONDA NASOENTERAL Nº 12 FR - CONFECCIONADA EM POLIÉTERANO BRANCO, RADIOOPACO. A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DO ESTOMAGO. COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y). QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS (I) DISTAIS DE PESO. OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIÉTERANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÓMAGO/DUODENO. E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | 1.280 | UNID | MEDICONE | R\$ 21,00 | R\$ | 26.880,00 | vinete e um reais                                 | vinete e um reais                                 | vinete e um reais                                 |

|                                |   |        |      |          |     |        |  |            |                     |   |
|--------------------------------|---|--------|------|----------|-----|--------|--|------------|---------------------|---|
| 55                             | SONDA NASOENTERAL Nº 14 FR - CONFECCIONADA EM POLIETILÉNO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MALEAVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ÁCIDO DO ESTOMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTIERS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM POLIETILÉNO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTOMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTERIL.   | 200    | UNID | MEDICONE | R\$ | 25,59  | vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos          | R\$        | 5.118,00            | cinco mil e noventa e oito reais  |
|                                | TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - MEDE UNID 99 TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; - POSSUI FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA-UMIDADE INTERNA; - POSSUI BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO °C OU °F; POSSUI BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA; - MATERIAL: PLÁSTICO ABS; ATENDE AS PORTARIAS RDC 21/2004 (SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) E RDC 4412009 (FARMÁCIAS DROGARIAS E OUTROS); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEM - PERATURA INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F)FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50 À 70 °C (-58 °F À 158°F); RESOLUÇÃO: 0,1 °C/°F; EXATIDÃO INT/EXT: +- 1°C DE 0 °C A 50°C, +- 2°C PARA O RESTANTE DA FAIXA. FAIXA DA UMIDADE: 15% A 95% UR RESOLUÇÃO: 1% UR; EXATIDÃO: +-5% UR; COMPRIMENTO DO CABO: +-2,40M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS 1.5V - AAA; (INCLUSAS)- DIMENSÕES: 86X64X22MM; PESO: 85G; | 90     | UNID | INCOTERM | R\$ | 236,99 | duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos | R\$        | 21.329,10           | vinte e um mil, trezentos e vinte e nove reais e dez centavos   |
| 58                             | TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS) COM LUER LOCK. CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, BIOCOMPATIVEL, MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS E CORPO DE TORNEIRA FORMANDO PEÇA ÚNICA, ESTERILIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO COM CONECTOR LOCK. COM VIA ADICIONAL DE PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. NIR. DO LOTE E REGISTRO NO MS. PROCEDENCIA NACIONAL.   | 16.000 | UNID | SOLIDOR  | R\$ | 1,41   | um real e quarenta e um centavos                         | R\$        | 22.560,00           | vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais   |
| <b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b> |   |        |      |          |     |        |  | <b>R\$</b> | <b>1.374.638,54</b> | um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos |

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

26 DE SETEMBRO DE 2023.



1/8



A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº PE 15/2023-SESA/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

| ITENS |   |       |      |              |             |       |          |            |   |
|-------|---|-------|------|--------------|-------------|-------|----------|------------|---|
| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UND  | MARCA        | VR UNITÁRIO |       | VR TOTAL |            |   |
| 1     | ATADURA DE CREPOM 15CMX 180M. CONTENDO 13 FIOS/CM. PESO 19.5G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | 40000 | ROLO | AAMED        | R\$         | 1,74  | R\$      | 69.600,00  | sessenta e nove mil e seiscentos reais                                    |
| 2     | ATADURA DE CREPOM 20CM X 180M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13.0G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | 49240 | ROLO | AAMED        | R\$         | 2,32  | R\$      | 114.236,80 | cento e quatorze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos   |
| 3     | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | 3200  | UNID | VITA MEDICAL | R\$         | 22,17 | R\$      | 70.944,00  | setenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais.                        |
| 4     | BOLSA PARA COLOSTOMIA/IELOSTOMIA DE UMA PEÇA DRENAVEL INFANTIL, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL 8-50MM (5/16-2") DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | 480   | UNID | CONVATEC     | R\$         | 70,77 | R\$      | 33.969,60  | trinta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos |
| 5     | BOTA DE UNNA - BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO BANDAGEM DE VISCOSE E POLIAMIDA COM ELASTICIDADE BIDIRECIONAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR ÓXIDO DE ZINCO, PROPIL-4-HIDROXIBENZOATO, METIL-4-HIDROXIBENZOATO, GELATINA, CLORETO DE CÁLCIO, GLICEROL 85%, ÁLCOOL SECUNDÁRIO, EMULSÃO ANTIESPUMANTE DE SILICONE E AGUA. EMBALADA UNITARIAMENTE EM ENVELOPE LAMINADO POR POLIETILENO E ALUMÍNIO. ROLO DE 10 CM 10 METROS.  | 150   | UNID | CASEX        | R\$         | 85,19 | R\$      | 12.778,50  | doze mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos          |
| 7     | CREME HIDRATANTE COM UREIA E ACIDO LACTICO. CREME BRANCO. VISCOSO. NÃO ESTÉRIL COMPOSTO POR AGUA, 10% UREIA (CARBAMIDA), PALMITATO DE ISOPROPIL. PALMITATO DE OCTILA. ESTEARATO DE GLICERILA. 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁCTICO), ÁLCOOL, ESTEARILICO, SORBITOL LACTATO DE AMÔNIO, ÁCIDO ESTEÁRICO, CETEARETE-25 E CETEARETE-6. INDICADO PARA HIDRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOLHAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRESENTEM RESSECAMENTO, ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS. SEM CONSERVANTES. CORANTES OU PERFUME. REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. EMBALAGEM COM 100 ML. | 250   | UNID | CIMED        | R\$         | 70,77 | R\$      | 17.692,50  | dezessete mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos     |



|    |  |     |       |              |            |  |               |   |
|----|--|-----|-------|--------------|------------|--|---------------|---|
| 8  | CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA (25UG/CM2). ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRUDAR NO LEITO DA LESÃO). FLEXIVEL E ESISTENTE, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATOXICA. HIPOALERGENICA, ESTÉRIL. TAMANHO: 10.5 CM X 19 CM.  | 100 | UNID  | VITA MEDICAL | R\$ 72,51  | setenta e dois reais e cinquenta e um centavos       | R\$ 7.251,00  | setenta e dois mil e cinquenta e um reais               |
| 9  | CURATIVO ANTIMICROBIANO NAO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA. COBERTURA NÃO ADESIVA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM ÍONS DE PRATA, FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE, SELETIVA, ESPESSURA MÍNIMA 4MM. SEM ADESIVO, RECORTEÁVEL, NÃO DEIXA RESÍDUO NA LESÃO. TAMANHO: 15 CM X 15 CM.   | 150 | UNID  | COLOPLAST    | R\$ 413,86 | quatrocentos e treze reais e oitenta e seis centavos | R\$ 62.079,00 | sessenta e dois mil e setenta e nove reais              |
| 10 | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. COBERTURAS COMPOSTAS POR FIBRAS DE ÁCIDO ALGÍNICO (ÁCIDO GULURÔNICO E ÁCIDO HIALURÔNICO) EXTRAÍDO DAS ALGAS MARINHAS MARRONS (LAMINARIA). CONTEM TAMBÉM IONS DE CÁLCIO E SÓDIO. CAMADA EXTERNA DE POLIJETERANO E CAMADA INTERNA COMPOSTA DE GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA. PROMOVE A HEMOSTASIA. ABSORVE EXSU DATO. FORMA UM GEL QUE MANTEM A UMIDADE, PROMOVE A GRANULAÇÃO E AUXILIA O DESBRIDAMENTO AUTOLITICO. TAMANHO: 10 X 10 CM.   | 200 | UNID  | CASEX        | R\$ 24,31  | vinte e quatro reais e trinta e um centavos          | R\$ 4.862,00  | quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais          |
| 11 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PARA FERIDAS COM BAIXA E MÉDIO EXUDATO 10X20CM  | 120 | UNID  | VITA MEDICAL | R\$ 33,78  | trinta e três reais e setenta e oito centavos        | R\$ 4.053,60  | quatro mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos |
| 12 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE EM PLACA 10 X 10 CM - CURATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE ESCARAS E FERIDAS EM GERAL. ALTA PERFORMANCE. ABSORVE MAIS E DURA MAIS. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO. COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS. RACHADURA DA PELE. ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS) ULCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL). PREVENÇÃO DE ULCERAS POR PRESSÃO. EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS. INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. CAIXA COM 5 UNIDADES.   | 200 | CAIXA | VITA MEDICAL | R\$ 185,05 | cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos       | R\$ 37.010,00 | trinta e sete mil e dez reais                           |
|    | CURATIVO DO TIPO FILME TRANSPARENTE PARA PROFILAXIA LLP 06 X 07  | 150 | UNID  | VITA MEDICAL | R\$ 4,02   | quatro reais e dois centavos                         | R\$ 603,00    | seiscentos e três reais                                 |
| 15 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE. 1.2 % DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA -A CÉTICO), COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTEADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO. PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 10X10. | 200 | UNID  | CONVATEC     | R\$ 170,93 | cento e setenta reais e noventa e três centavos      | R\$ 34.186,00 | trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais       |







|    |   |       |      |              |              |   |               |  |
|----|---|-------|------|--------------|--------------|---|---------------|--|
| 16 | CURATIVO ESTERIL NAO ADERENTE, EM PLACA. COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE. 1.2 % DE PRATA IONICA. CLORETO DE BENZEPÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA -ACÉTICO). COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME. COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERA - DA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUTADO. PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS. INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15 X 15   | 100   | UNID | CONVATEC     | R\$ 321,62   | trezentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos           | R\$ 32.162,00 | dois mil, cento e sessenta e dois reais              |
| 18 | CURATIVO NAO ADERENTE QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO - COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM 7,5 X 7,5   | 150   | UNID | CURATEC      | R\$ 16,02    | dezesais reais e dois centavos                                    | R\$ 2.403,00  | dois mil, quatrocentos e três reais                  |
| 20 | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 10M   | 100   | UNID | VITA MEDICAL | R\$ 201,86   | duzentos e um reais e oitenta e seis centavos                     | R\$ 20.186,00 | vinte mil, cento e oitenta e seis reais              |
| 21 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA NR 6-. MASCULINO COLETOR PENIANO EM LATEX COM TUBO COM EXTENSAO. A EXTREMIDADE DISTAL DO TUBO DEVERA SER COLOCADA EM RECEPTACULO (NAO INCLUÍDO) PARA COLETA DA URINA, ACOMPANHA PRESERVATIVO  | 1.200 | UNID | EMBRAMED     | R\$ 14,02    | quatorze reais e dois centavos                                    | R\$ 16.824,00 | dezesseis mil, oitocentos e vinte e quatro reais     |
| 22 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL COMO APARELHO LIFE 400 CMOS DRAKE ADULTO. COM CONECTOR PRETO   | 24    | UNID | CMOS DRAKE   | R\$ 1.365,75 | mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos | R\$ 32.778,00 | trinta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais |
| 23 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL -, EQUIPO DE INFUSAO DE USO UNICO. CONSTITUÍDO DE PONTA PERFUROCORTANTE ADAPTÁVEL AO SISTEMA FECHADO COM FILTRO AN - TIBACTERLANO DE AR E CAPA PROTETORA, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR (20 GOTAS/ML) COM FILTRO DE SOLUÇÃO DE ISMICRA. TUBO FLEXÍVEL EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR. PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) INTERMEDIARJO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE. INJETOR LATERAL TIPO Y CONECTOR TERMINAL TIPO LUER - LOCK. COM CAPA PROTETORA UTILIZADO PARA INFUSAO VIA PARENTERAL DE LÍQUIDOS FOTO SENSÍVEIS COMPATÍVEIS COM PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO SELADO. ESTEREIIZADO A OXÍDO DE ETILENO. | 8.000 | UNID | LAMEDID      | R\$ 8,82     | oito reais e oitenta e dois centavos                              | R\$ 70.560,00 | setenta mil, quinhentos e sessenta reais             |
| 24 | EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS. DE USO UNICO. ESTERILIZMJO POR RADIAÇÃO GAMA, COM MATERIAL ATOXICO E APIROGÊNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ADAPTA VEL PARA AMPOLAS DE SISTEMA FECHADO.  | 2.800 | UNID | MEDSONDA     | R\$ 5,83     | cinco reais e oitenta e três centavos                             | R\$ 16.324,00 | dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais      |



|    |   |        |       |              |            |   |               |  |
|----|---|--------|-------|--------------|------------|---|---------------|--|
| 25 | EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSAO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE, CÂMARA GOTEJAMENTO TRANSPARENTE PROJETADA PARA 20ML - FILTRO COM POROS DE 200 MICRA, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, DUPLA CÂMARA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M, LUER MACHO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 2.000  | UNID  | LAMEDID      | R\$ 9,24   | nove reais e vinte e quatro centavos                      | R\$ 18.480,00 | dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais                |
| 26 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MÊDIO 119MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO   | 26.000 | UNID  | KOLPLAST     | R\$ 2,79   | dois reais e setenta e nove centavos                      | R\$ 72.540,00 | setenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais          |
| 27 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO 107MM, ESTÉRIL ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO  | 11.000 | UNID  | KOLPLAST     | R\$ 2,53   | dois reais e cinquenta e três centavos                    | R\$ 27.830,00 | vinte e sete mil, oitocentos e trinta reais              |
| 28 | ETER SULFURICO LIQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLÁTIL  | 160    | LITRO | VIC PHARMA   | R\$ 82,59  | oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos          | R\$ 13.214,40 | treze mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos |
| 29 | FIO PARA SUTURA EM ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM, FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.   | 120    | CAIXA | SHALON       | R\$ 17,44  | dezessete reais e quarenta e quatro centavos              | R\$ 2.092,80  | dois mil e noventa e dois reais e oitenta centavos       |
| 30 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVIVEL SINTÉTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.   | 160    | CAIXA | SHALON       | R\$ 17,44  | dezessete reais e quarenta e quatro centavos              | R\$ 2.790,40  | dois mil, setecentos e noventa reais e quarenta centavos |
| 31 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM COM FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE   | 80     | CAIXA | SHALON       | R\$ 15,97  | quinze reais e noventa e sete centavos                    | R\$ 1.277,60  | mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos  |
| 33 | GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, HIDROGEL OU GEL HIDRATANTE COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMEFILCELULOSE (CMC), PROPILENOGLICOL E GRANDE QUANTIDADE DE AGUA, CAPAZ DE PROMOVER O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO E FAVORECENDO A REMOÇÃO DAS ESCARAS E DO TECIDO NECROTICO, EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.   | 200    | UNID  | CURATEC      | R\$ 119,97 | cento e dezanove reais e noventa e sete centavos          | R\$ 23.994,00 | vinte e três mil, novecentos e noventa e quatro reais    |
| 34 | HIDROCOLOIDE - CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE E IMPERMEIA - VEL A AGUA - COMPOSTO POR UMA CAMADA EXTERNA AUTOADESIVA CONTENDO HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POU-ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO, TAMANHO 15CM X 15CM.  | 100    | UNID  | VITA MEDICAL | R\$ 36,71  | trinta e seis reais e setenta e um centavos               | R\$ 3.671,00  | três mil, seiscentos e setenta e um reais                |
| 36 | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G   | 200    | UNID  | CURATEC      | R\$ 144,72 | cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos | R\$ 28.944,00 | vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais   |

|    |  |         |      |              |            |  |                |   |
|----|--|---------|------|--------------|------------|--|----------------|---|
| 37 | HIDROGEL COM PHMB, GEL AQUOSO OU HIDROGEL A BASE DE POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB), HIDROCOLOIDES NATURAIS (PECFINA E CELULOSE), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.  | 200     | UNID | CASEX        | R\$ 67,56  | sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos          | R\$ 13.512,00  | doze mil, quinhentos e doze reais   |
| 38 | LANCETA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO 0.4MM, PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE)  | 119.000 | UNID | G-TECH       | R\$ 0,12   | doze centavos de real                                      | R\$ 14.280,00  | quatorze mil, duzentos e oitenta reais                                      |
| 39 | PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON. ESTÉRIL. ATOXICA E APIROGENICA ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | 6.600   | UNID | KOLPLAST     | R\$ 4,06   | quatro reais e seis centavos                               | R\$ 26.796,00  | vinte e seis mil, setecentos e noventa e seis reais                         |
| 40 | PINCETA (ALMOTOLIA) MAKROM 250ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.  | 230     | UNID | J. PROLAB    | R\$ 7,22   | sete reais e vinte e dois centavos                         | R\$ 1.660,60   | mil seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos                         |
| 41 | PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.  | 206     | UNID | J. PROLAB    | R\$ 10,66  | dez reais e sessenta e seis centavos                       | R\$ 2.195,96   | dois mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos           |
|    | PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.  | 196     | UNID | J. PROLAB    | R\$ 10,66  | dez reais e sessenta e seis centavos                       | R\$ 2.089,36   | dois mil e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos                    |
| 43 | PIPETA PASTEUR PLÁSTICA 3ML - PIPETA PASTEUR ESTERIL PARA TRANSPERENCIA DE SEGURA DE AMOSTRAS, FABRICADO COM POLIETILENO DE BAIXA DENS DADE E NÃO TOXICO; BULBO MOLDADO EM UMA UNICA PEÇA. ELIMINANDO CONTAMINAÇÃO;TRANSPARENTES E COM PAREDES UNIFORMES: GRADUAÇÃO PRECISA DE 0,5-3,0 ML;   | 8.000   | UNID | LABOR IMPORT | R\$ 0,53   | cinquenta e três centavos de real                          | R\$ 4.240,00   | quatro mil, duzentos e quarenta reais                                       |
| 44 | PO DE HIDROCOLOIDE - PO QUE PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES NO LOCAL DO ESTOMA.   | 200     | UNID | COLOPLAST    | R\$ 197,58 | cento e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos   | R\$ 39.516,00  | trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais                       |
| 45 | POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLUÇÃO DEGERMANTE UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VIRUS E FUNGOS. EM ASSOCIAÇÃO COM TENSOATIVOS PROMOVE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MÃOS, BRAÇOS E CAMPO CIRÚRGICO 1000ML.   | 1.312   | UNID | VIC PHARMA   | R\$ 103,67 | cento e três reais e sessenta e sete centavos              | R\$ 136.015,04 | cento e trinta e seis mil e quinze reais e quatro centavos                  |
| 46 | POVIDINE TOPICO - SOLUÇÃO AQUOSA POUVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP —10% DE IODO ATIVO). ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VIRUS, FUNGOS. SEM IRRITAR A PELE 1000ML.  | 812     | UNID | VIC PHARMA   | R\$ 101,28 | cento e um real e vinte e oito centavos                    | R\$ 82.239,36  | oitenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos |
| 47 | PROTETOR CUTÁNEO SPRAY FRASCO DE NO MINIMO 28ML. FORMA UMA PELICULA PROTETORA DURADOURA. SOBRE A PELE INTACTA OU LESIONADA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DA PELE COM LIQUIDOS. FLUIDOS CORPORAIS E FEZES POR ATE 72 HORAS. PRODUTO INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DE OSTOMIAS, FERIDAS, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECAL, AO REDOR DE CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO, TRAQUEOSTOMIA, DERMATITE E IRRITAÇÃO DA PELE PODE SER USADO POR BEBES, CRIANÇAS E ADULTOS. | 200     | UNID | 3M           | R\$ 273,69 | duzentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos | R\$ 54.738,00  | cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais                    |



|    |   |     |      |          |            |  |               |  |
|----|---|-----|------|----------|------------|--|---------------|--|
| 48 | SOLUÇÃO DE PHMB, LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BETAÍNA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO POR PORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO. INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS. EMBALAGEM COM 350 ML.   | 130 | UNID | PIELSANA | R\$ 251,06 | duzentos e cinquenta e um reais e seis centavos  | R\$ 32.637,80 | trinta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos |
| 49 | SONDA DE ASPLRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nº14, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMERICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCISO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SLSTEMA E A SECREÇÃO. DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INIDCADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUCCÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES  | 300 | UNID | MEDIX    | R\$ 77,57  | setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos | R\$ 23.271,00 | vinte e três mil, duzentos e setenta e um reais                        |
| 50 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nº16, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLUCISO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INIDCADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUCCÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.   | 300 | UNID | MEDIX    | R\$ 77,57  | setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos | R\$ 23.271,00 | vinte e três mil, duzentos e setenta e um reais                        |
| 51 | SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA Nº22 LONGA DESCARTAVEL. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO. FLEXIVEL. TRANSPARENTE. COM BATOC. SIUCONIZADA. COM ORIFICIOS LATERAIS. CONECTOR UNIVERSAL. ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABER TURA ASSEPTICA.   | 120 | UNID | MARK MED | R\$ 3,81   | três reais e oitenta e um centavos               | R\$ 457,20    | quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos                   |
| 52 | SONDA NASOENTERAL N 06 FR - CONFECCIONADA EM POLIERUTANO BRANCO. RADIOPACO. A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MALLEÁVEL DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ACIDO DO ESTÔMAGO. COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y). QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS ILJ DISTAIS DE PESO. OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PO AO POLIERUTANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | 520 | UNID | SOLUMED  | R\$ 21,43  | vinte e um reais e quarenta e três centavos      | R\$ 11.143,60 | onze mil, cento e quarenta e três reais e sessenta centavos            |



|    |  |       |      |         |           |   |               |   |
|----|--|-------|------|---------|-----------|---|---------------|---|
| 53 | SONDA NASOENTERAL N 08 FR - CONFECCIONADA EM POLIURETANO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COMO PH ÁCIDO DO ESTOMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIURETANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL.    | 120   | UNID | SOLUMED | R\$ 21,43 | vinte e um reais e quarenta e três centavos | R\$ 2.571,60  | vinte e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos |
| 54 | SONDA NASOENTERAL Nº 12 FR - CONFECCIONADA EM POLIURETANO BRANCO, RADIOPACO, Sonda para alimentação enteral DOBBHOFF FLEXIVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COMO PH ÁCIDO DO ESTOMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS (H) DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIURETANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | 1.280 | UNID | SOLUMED | R\$ 21,43 | vinte e um reais e quarenta e três centavos | R\$ 27.430,40 | vinte e sete mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos     |
| 55 | SONDA NASOENTERAL Nº 14 FR - CONFECCIONADA EM POLIURETANO BRANCO, RADIOPACO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXIVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ÁCIDO DO ESTOMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIURETANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTOMAGODUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFINCTERES (CARDIA E PILORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL.   | 200   | UNID | SOLUMED | R\$ 26,14 | vinte e seis reais e quatorze centavos      | R\$ 5.228,00  | cinco mil, duzentos e vinte e oito reais                              |





|                                |   |        |      |         |            |  |                         |  |
|--------------------------------|---|--------|------|---------|------------|--|-------------------------|--|
| 57                             | <p>TERMÔMETRO DIGITAL DE GELEDEIRA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - MEDE UNID 90</p> <p>TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA;- POSSUI FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA- UMIDADE INTERNA;- POSSUI BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO °C OU °F;</p> <p>POSSUI BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA: - MATERIAL: PLÁSTICO ABS;</p> <p>ATENDE AS PORTARIAS RDC 21/2004 (SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) E RDC 4412009 (FARMÁCIAS DROGARIAS E OUTROS); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEM - PERATURA INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F)FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50 À 70 °C(-58 °F À 158°F); RESOLUÇÃO: 0.1 °C/°F; EXATIDÃO INT/EXT: +- 1°C DE 0 °C A 50°C. ± 22C PARA O RESTANTE DA FAIXA. FAIXA DA UMIDADE: 15% A 95% UR</p> <p>RESOLUÇÃO: 1% UR; EXATIDÃO: ±5% UR; COMPRIMENTO DO CABO: ±2,40M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS 1.5V - AAA; (INCLUSAS)- DIMENSÕES: 86X64X22MM; PESO: 85G;</p> | 90     | UNID | PYROMED | R\$ 242,07 | duzentos e quarenta e dois reais e sete centavos | R\$ 21.786,30           | uma e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos                                    |
| 58                             | <p>TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS) COM LUER LOCK. CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, BIOCOMPATIVEL, MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS E CORPO DE TORNEIRA FORMANDO PEÇA ÚNICA, ESTERILIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO COM CONECTOR LOCK. COM VIA ADICIONAL DE PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. NR. DO LOTE E REGISTRO NO MS. PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p>   | 16.000 | UNID | MEDIX   | R\$ 1,44   | um real e quarenta e quatro centavos             | R\$ 23.040,00           | vinte e três mil e quarenta reais  |
| <b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b> |   |        |      |         |            |  | <b>R\$ 1.403.456,42</b> | um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E MAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTO REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;



IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

26 DE SETEMBRO DE 2023.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



V/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE152023-SESA

DATA: 27/09/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM                            | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QUANT. | MARCA        | V. UNIT   | V. UNIT. EXTENSO                | V. TOTAL       | V. TOTAL EXTENSO                                      |
|---------------------------------|--|---------|--------|--------------|-----------|---------------------------------|----------------|---|
| 1                               | ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/CM². PESO 19,5G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | ROLO    | 40000  | ANAPOLIS     | R\$ 2,50  | dois reais e cinquenta centavos | R\$ 100.000,00 | cem mil reais   |
| 2                               | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS E ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | ROLO    | 49240  | ANAPOLIS     | R\$ 3,00  | três reais                      | R\$ 147.720,00 | cento e quarenta e sete mil, setecentos e vinte reais |
| 3                               | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL COM BARRHEIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | UNID    | 3200   | MASTER WIN   | R\$ 41,00 | quarenta e um reais             | R\$ 131.200,00 | cento e trinta e um mil e duzentos reais              |
| 23                              | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL - EQUIPO DE INFUSÃO DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDO DE PONTA PERFUROCORTANTE ADAPTÁVEL AO SISTEMA FECHADO COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTES EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR (20 GOTAS/ML) COM FILTRO DE SOLUÇÃO DE 15MICRA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) INTERMEDIÁRIO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE, INJETOR LATERAL TIPO Y CONECTOR TERMINAL TIPO LUER - LOCK, COM CAPA PROTETORA UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA PARENTERAL DE LÍQUIDOS FOTO SENSÍVEIS COMPATÍVEIS COM PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO SELADO, ESTERELIZADO A OXÍDE DE ETILENO. | UNID    | 8000   | LABOR IMPORT | R\$ 3,20  | três reais e vinte centavos     | R\$ 25.600,00  | vinte e cinco mil e seiscentos reais                  |
| 26                              | ESPELHO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO 119MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO.  | UNID    | 26000  | LABOR IMPORT | R\$ 6,00  | seis reais                      | R\$ 156.000,00 | cento e cinquenta e seis mil reais                    |
| 27                              | ESPELHO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 107MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO.  | UNID    | 11000  | LABOR IMPORT | R\$ 6,00  | seis reais                      | R\$ 66.000,00  | sessenta e seis mil reais                             |
| 38                              | LANCETA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE) UNIDADE  | UNID    | 119000 | LABOR IMPORT | R\$ 0,20  | vinte centavos de real          | R\$ 23.800,00  | vinte e três mil e oitocentos reais                   |
| 39                              | PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA ESTERILIZADO A OXÍDE DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNID    | 6600   | KOLPLAST     | R\$ 2,50  | dois reais e cinquenta centavos | R\$ 16.500,00  | dezesseis mil e quinhentos reais                      |
| <b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b> |  |         |        |              |           |                                 | <b>R\$</b>     | <b>666.820,00</b>                                     |

seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte reais

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DETERMINA O EDITAL  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor Proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao estabelecido na lei N.º 9.854, de 27/10/1999 publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao deste edital, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que inexistente qualquer fato superveniente e impeditivo para sua habilitação e contratação, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32.º, da Lei N.º 8.666/93.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que o seguinte: (1) da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos edital e dos produtos a serem ofertado no presente certame licitatório; (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; (4) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar do presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32.2, da Lei nº 8.666/93.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao edital e anexos, cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de "02" - documentos de habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002, e que não estar impedida de participar de licitações e de contratar com administração pública em razão de penalidade, nem de fatos impeditivos de sua habilitação; para participação do certame licitatório acima supracitado.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento a todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, indicados no local pela prefeitura, que serão executados conforme a exigência desse edital e contratual que serão iniciados a partir da data de recebimentos da ordem de compra.

Declara, sob as penalidade da lei, que atenders as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a fazenda nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

Fortaleza 26 de setembro de 2023



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023-SESA/SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023-SESA/SRP  
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 27 DE SETEMBRO DE 2023, 8H30M

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

### CARTA PROPOSTA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/MODELO/TIPO  | UNID. | QUANT. | VR UNIT  | EXTENSO                         | VR TOTAL       | EXTENSO       | PROCEDÊNCIA | CONDICIONAMENTO  | VALIDADE e GARANTIA | MARCA   | FABRICANTE |
|------|--|-------|--------|----------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|---------------------|---------|------------|
| 1    | ATADURA DE CREPOM 15CMX 1.80M. CONTENDO 13 FIOS/CM. PESO 19.56. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BOR-1 DAS DELIMITADAS ESLATICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM ROLO 40.000 FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA | ROLO  | 40000  | R\$ 2,50 | dois reais e cinquenta centavos | R\$ 100.000,00 | cem mil reais | NACIONAL    | Armazenado na embalagem original protegido da luz/umidade e conservado em temp. ambiente (15°C-30°C) | 24 MESES            | ORTOFEN | ORTOFEN    |

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias

Declara que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declara para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo, local e forma de entrega: parcelada, e os materiais deverão ser entregues no ALMOXARIFADO do Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, localizada à Avenida José Figueira s/n – Centro de Viçosa do Ceará - CE. Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora, podendo ser prorrogado justificadamente

Data: 27/09/2023





A PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 SESA/SRP

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/09/2023 ÀS 8:30

SESSÃO DE DISPUTA: 27/09/23 ÀS 9:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

1/9

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UND | MARCA                    | QTDE  | VL. UNIT.  |  | VL.TOTAL       |  |
|------|---|-----|--------------------------|-------|------------|--|----------------|--|
| 1.   | ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/CM². PESO 19,5G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | ROL | AMED                     | 40000 | R\$ 2,67   | dois reais e sessenta e sete centavos                        | R\$ 106.800,00 | cento e seis mil e oitocentos reais  |
| 2.   | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | ROL | AMED                     | 49240 | R\$ 4,11   | quatro reais e onze centavos                                 | R\$ 202.376,40 | duzentos e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos |
| 3.   | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | UND | CONVATEC-ESTEEM          | 3200  | R\$ 52,98  | cinquenta e dois reais e nove e oito centavos                | R\$ 169.536,00 | cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais                      |
| 4.   | BOLSA PARA COLOSTOMIA/IELOSTOMIA DE UMA PEÇA DRENÁVEL, INFANTIL, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL 8-50MM (5/16-2") DRENÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTÁVEIS DE 25MM A 70MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.   | UND | CONVATEC-ACTIVE LIFE     | 480   | R\$ 70,29  | setenta reais e vinte e nove centavos                        | R\$ 33.739,20  | trinta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos               |
| 5.   | BOTA DE UNNA – BANDAGEM DE ÓXIDO DE ZINCO. BANDAGEM DE VISCOSE E POLIAMIDA COM ELASTICIDADE BIDIRECCIONAL. IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR ÓXIDO DE ZINCO, PROPIL-4-HIDROXIBENZOATO, METIL-4-HIDROXIBENZOATO, GELATINA, CLORETO DE CÁLCIO, GLICEROL 85%, ÁLCOOL SECUNDÁRIO, EMULSÃO ANTIESPUMANTE DE SILICONE E ÁGUA. EMBALADA UNITARIAMENTE EM ENVELOPE LAMINADO POR POLIETILENO E ALUMÍNIO. ROLO DE 10 CM X 10 METROS.  | UND | CONVATEC-FLEXIDRESS      | 150   | R\$ 136,93 | cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos        | R\$ 20.524,50  | vinte mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos                  |
| 6.   | CREME DE BARREIRA. COMPOSTO POR ÁGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LINDOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPYLENOGLICOL. INDICADO PARA CRIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVOS, HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE RESSECADA EMBALAGEM COM 200G   | UND | ATHVIE                   | 250   | R\$ 111,30 | cento e onze reais e trinta centavos                         | R\$ 27.825,00  | vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais                                 |
| 7.   | CREME HIDRATANTE COM URÉIA E ÁCIDO LÁCTICO. CREME BRANCO, VISCOZO, NÃO ESTÉRIL. COMPOSTO POR ÁGUA, 10% URÉIA (CARBAMIDA), PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA-HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁCTICO), ÁLCOOL ESTEARÍLICO, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO, ÁCIDO ESTEÁRICO, CETEARETE-25 E CETEARETE-6. INDICADO PARA HIDRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS, OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRESENTEM RESSECAMENTO, ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME. REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. EMBALAGEM COM 100 ML. | UND | PIELIANA                 | 250   | R\$ 83,07  | oitenta e três reais e sete centavos                         | R\$ 20.767,50  | vinte mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos                 |
| 8.   | CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA (250G/CM2). ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRIUDAR NO LEITO DA LESÃO), FLEXÍVEL E RESISTENTE, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO. ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ESTÉRIL. TAMANHO: 10,5 CM X 19 CM.   | UND | ACTSORB PLUS             | 100   | R\$ 482,25 | quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos | R\$ 48.225,00  | quarenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais                                |
| 9.   | CURATIVO ANTIMICROBIANO NÃO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA. COBERTURA NÃO ADESIVA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA, ESPESSURA MÍNIMA 4MM, SEM ADESIVO, RECORTÁVEL. NÃO DEIXA RESÍDUO NA LESÃO. TAMANHO: 15 CM X 15 CM.  | UND | CONVATEC-AQUACEL FOAM AG | 150   | R\$ 324,42 | trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos  | R\$ 48.663,00  | quarenta e oito mil, seiscientos e sessenta e três reais                           |
| 10.  | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. COBERTURAS COMPOSTAS POR FIBRAS DE ÁCIDO ALGÍNICO (ÁCIDO GULURÔNICO E ÁCIDO MANURÔNICO) EXTRAÍDO DAS ALGAS MARINHAS MARRONS (LAMINÁRIA). CONTEM TAMBÉM IONS DE CÁLCIO E SÓDIO. CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO E CAMADA INTERNA COMPOSTA DE GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. PROMOVE A HEMOSTASIA, ABSORVE EXSUDATO, FORMA UM GEL QUE MANTÉM A UMIDADE, PROMOVE A GRANULAÇÃO E AUXILIA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. TAMANHO: 10 X 20 CM  | UND | CONVATEC-KALSTAT FORTEX  | 200   | R\$ 114,75 | cento e quatorze reais e setenta e cinco centavos            | R\$ 22.950,00  | vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais                                     |
| 11.  | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PARA FERIDAS COM BAINHA E MEIO EXUDATO 10X20CM   | UND | CONVATEC-KALSTAT         | 120   | R\$ 131,07 | cento e trinta e um reais e sete centavos                    | R\$ 15.728,40  | quinze mil, setecentos e vinte e quatro centavos                                   |
| 12.  | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE EM PLACA 10 X 10 CM - CURATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE ESCARAS E FERIDAS EM GERAL. ALTA PERFORMANCE, ABSORVE MAIS E DURA MAIS. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, FOCOS DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS, CAIXA COM 5 UNIDADES.   | CXA | CONVATEC                 | 200   | R\$ 226,50 | duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos           | R\$ 45.300,00  | quarenta e cinco mil e trezentos reais   |
| 13.  | CURATIVO DE HIDROFIBRA. COBERTURA DE FIBRAS GELIFICANTES, COMPOSTO POR 100% DE NÃO TECIDO ESTÉRIL DE FIBRAS DE ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA) ENTRELAÇADAS QUE POSSUAM UM ALTO PODER DE ABSORÇÃO VERTICAL, REDUZINDO O RISCO DE MACERAÇÃO. CAPAZ DE PROMOVER A UMIDADE NECESSÁRIA, AUXILIANDO NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. PODE SER MANTIDO POR ATÉ 7 DIAS NA LESÃO. TAMANHO: 15 X 15 CM.   | UND | CONVATEC-AQUACEL AG+     | 100   | R\$ 171,24 | cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos         | R\$ 17.124,00  | dezesete mil, cento e vinte e quatro reais   |

*[Handwritten signature]*



|    |   |     |                       |       |              |  |                |   |
|----|---|-----|-----------------------|-------|--------------|--|----------------|---|
| 15 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PIATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO), COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME, COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTEADO EM QUALQUER DIREÇÃO, ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA, INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME, TAMANHO 10 X 10   | UND | CONVATEC-AQUACEL AG+  | 200   | R\$ 171,34   | cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos       | R\$ 34.268,00  | trinta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais              |
| 16 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PIATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO), COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME, COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTEADO EM QUALQUER DIREÇÃO, ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA, INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME, TAMANHO 15 X 15   | UND | CONVATEC-AQUACEL AG+  | 100   | R\$ 322,23   | trezentos e vinte e dois reais e três centavos             | R\$ 32.223,00  | trinta e dois mil, duzentos e três reais                        |
| 17 | CURATIVO HIDROPOLÍMERO OU HIDROCELULAR COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS, SENDO UMA CENTRAL DE ESPUMA HIDROCELULAR OU HIDROPOLÍMERO (AMBOS EM POLIURETANO) QUE CONTROLA A ABSORÇÃO DO FLUIDO PELA EXPANSÃO DAS CÉLULAS A MEDIDA QUE ABSORVE O EXSUDATO, E DUAS OUTRAS NÃO ADERENTES, A AGRESSÃO AOS TECIDOS NA SUA REMOÇÃO, FUNCIONAM PELA MANUTENÇÃO DA UMIDADE ABSORVENDO E RETENDO O EXCESSO DE EXSUDATO EM SUA ESTRUTURA POROSA QUE SE EXPANDE MOLDANDO-SE AO LEITO DA FERIDA.  | UND | CONVATEC-FOAM LITE    | 150   | R\$ 101,52   | cento e um reais e cinquenta e dois centavos               | R\$ 15.228,00  | quinze mil, duzentos e vinte e oito reais                       |
| 18 | CURATIVO NÃO ADERENTE QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO – COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLIATUM 7,5 X 7,5  | UND | ADAPTIC               | 150   | R\$ 21,03    | vinte e um reais e três centavos                           | R\$ 3.154,50   | três mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos |
| 19 | CURATIVO POLY TUBE ESTÉRIL 9 X 9 CM - COBERTURA DESTINADO AO CUIDADO DAS TRAQUEOSTOMIAS, GASTROSTOMIAS, DRENOS E PELE PERIESTOMA, CONSTITUÍDO POR UMA MEMBRANA DE POLIURETANO, QUE É COMPOSTA POR UM AGENTE DE LIMPEZA, GLICERINA E GOMA SUPERABSORVENTE E MATRIZ REVESTIDA POR FILME SEMIPERMEÁVEL.  | UND | POLY TUBE             | 200   | R\$ 236,40   | duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos         | R\$ 47.280,00  | quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais                   |
| 20 | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 10M   | UND | PHARMA FIX            | 100   | R\$ 408,00   | quatrocentos e oito reais                                  | R\$ 40.800,00  | quarenta mil e oitocentos reais                                 |
| 21 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NIH 6 - MASCULINO COLETOR PENIANO EM LATEX COM TUBO COM EXTENSÃO. A EXTREMIDADE DISTAL DO TUBO DEVERA SER COLOCADA EM RECEPTÁCULO (NÃO INCLUIDO) PARA COLETA DA URINA, ACOMPANHA PRESERVATIVO.  | UND | URO CONTROL           | 1200  | R\$ 5,34     | cinco reais e trinta e quatro centavos                     | R\$ 6.408,00   | seis mil, quatrocentos e oito reais                             |
| 22 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR COMPATÍVEL COM O APARELHO LIFE 400 CMOS DRAKE ADULTO, COM CONECTOR PRETO  | UND | CMOS DRAKE            | 24    | R\$ 1.980,00 | mil novecentos e oitenta reais                             | R\$ 47.520,00  | quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais                   |
| 23 | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL – EQUIPO DE INFUSÃO DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDO DE PONTA PERFURADORA ADAPTÁVEL AO SISTEMA FECHADO COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR (20 GOTAS/ML) COM FILTRO DE SOLUÇÃO DE 15MICRA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC COM COMPONENTE FOTOPROTETOR, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) INTERMEDIÁRIO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE, INJETOR LATERAL TIPO Y CONECTOR TERMINAL TIPO LUER – LOCK, COM CAPA PROTETORA UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA PARENTERAL DE LÍQUIDOS FOTO SENSÍVEIS COMPATÍVEIS COM PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO SELADO, ESTERELIZADO A OXÍDO DE ETILENO. | UND | BIOSANI               | 8000  | R\$ 7,56     | sete reais e cinquenta e seis centavos                     | R\$ 60.480,00  | sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais                      |
| 24 | EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, DE USO ÚNICO, ESTERELIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, COM MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ADAPTÁVEL PARA AMPOLAS DE SISTEMA FECHADO  | UND | BIOSANI               | 2800  | R\$ 5,91     | cinco reais e noventa e um centavos                        | R\$ 16.548,00  | dezesseis mil, quinhentos e quarenta e oito reais               |
| 25 | ESPELHO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO 119MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO  | UND | KOLPLAST              | 26000 | R\$ 4,65     | quatro reais e sessenta e cinco centavos                   | R\$ 120.900,00 | cento e vinte mil e novecentos reais                            |
| 27 | ESPELHO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 107MM, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRODUTO DE USO ÚNICO.   | UND | KOLPLAST              | 11000 | R\$ 4,26     | quatro reais e vinte e seis centavos                       | R\$ 46.860,00  | quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais                |
| 28 | ETER SULFÚRICO LÍQUIDO INCOLOR, DE ODDOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL E VOLÁTIL.  | LTR | VICPHARMA             | 160   | R\$ 124,65   | cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos   | R\$ 19.944,00  | dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais              |
| 33 | GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, HIDROGEL OU GEL HIDRATANTE COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), PROPILENOGLICOL E GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA, CAPAZ DE PROMOVER O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO E FAVORECENDO A REMOÇÃO DAS ESCARAS E DO TECIDO NECRÓTICO, EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.   | UND | CONVATEC-SAF GEL      | 200   | R\$ 154,92   | cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos | R\$ 30.984,00  | trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais                 |
| 34 | Objeto/Lote/Item: 34 HIDROCOLÓIDE – CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE E IMPERMEÁVEL À ÁGUA – COMPOSTO POR UMA CAMADA EXTERNA AUTOADESIVA CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CMC – CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI-ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO. TAMANHO 15CM X 15CM.  | UND | CONVATEC-D.EXTRA FINO | 100   | R\$ 83,43    | oitenta e três reais e quarenta e três centavos            | R\$ 8.343,00   | oito mil, trezentos e quarenta e três reais                     |
| 35 | HIDROGEL A BASE DE ÁGUA, HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR UM POLÍMERO MODIFICADO DE 2,3% DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), 20% DE PROPILENO GLICOL E 77,7% DE ÁGUA. NÃO ADERE NO LEITO DA FERIDA. É INDICADO PARA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE ÁREAS NECROSADAS E/OU COM ESFACELADO E NA ESTIMULAÇÃO DO CRESCIMENTO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO, LESÕES SUPERFICIAIS E QUEIMADURAS, EMBALAGEM COM 15 GRAMAS. UND. 200  | UND | CONVATEC              | 200   | R\$ 79,47    | setenta e nove reais e quarenta e sete centavos            | R\$ 15.894,00  | quinze mil, oitocentos e noventa e quatro reais                 |
| 36 | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G   | UND | CONVATEC-SAF GEL      | 200   | R\$ 154,92   | cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos | R\$ 30.984,00  | trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais                 |
| 37 | HIDROGEL COM PHMB, GEL AQUOSO OU HIDROGEL À BASE DE POLIHEXA METIL BISQUANIDA (PHMB), HIDROCOLÓIDES NATURAIS (PECTINA E CELULOSE), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.  | UND | PIELSANA              | 200   | R\$ 94,53    | noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos         | R\$ 18.906,00  | dezoito mil, novecentos e seis reais                            |



|    |   |     |                         |        |     |        |   |     |            |   |
|----|---|-----|-------------------------|--------|-----|--------|---|-----|------------|---|
| 38 | LANCETA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE)   | UND | GTECH                   | 119000 | R\$ | 0,60   | sessenta centavos de real                                   | R\$ | 7.140,00   | setenta e um mil e quatrocentos reais   |
| 39 | FINÇA DESCARTÁVEL CHERRION, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UND | KOLPLAST                | 6600   | R\$ | 6,39   | seis reais e trinta e nove centavos                         | R\$ | 42.174,00  | quarenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais                             |
| 40 | PINCELA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UND | J. PROLAB               | 230    | R\$ | 10,35  | dez reais e trinta e cinco centavos                         | R\$ | 2.380,50   | dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos                        |
| 41 | PINCELA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UND | J. PROLAB               | 206    | R\$ | 18,06  | dezoito reais e seis centavos                               | R\$ | 3.720,36   | três mil, setecentos e vinte reais e seis centavos                              |
| 42 | PINCELA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ML - RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UND | J. PROLAB               | 196    | R\$ | 18,06  | dezoito reais e seis centavos                               | R\$ | 3.539,76   | três mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos            |
| 44 | PO DE HIDROCLORÍDE - PO QUE PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES NO LOCAL DO ESTOMA.  | UND | CONVATEC-STOMAHESIVE PO | 200    | R\$ | 172,14 | cento e setenta e dois reais e quatorze centavos            | R\$ | 34.428,00  | trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais                          |
| 45 | POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VÍRUS E FUNGOS, EM ASSOCIAÇÃO COM TENSIOATIVOS PROMOVE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MÃOS, BRAÇOS E CAMPO CIRÚRGICO LÚDICO.   | UND | VICPHARMA               | 1312   | R\$ | 158,61 | cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos     | R\$ | 208.096,32 | duzentos e oito mil e noventa e seis reais e trinta e dois centavos             |
| 46 | POLIVINIL TÓPICO - SOLUÇÃO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO ATIVO), ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, VÍRUS, FUNGOS, SEM IRRITAR A PELE 1000ML.  | UND | VICPHARMA               | 812    | R\$ | 154,74 | cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos          | R\$ | 125.648,88 | cento e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos |
| 47 | PROTECTOR CUTANEO SPRAY FRASCO DE NO MINIMO 28ML, FORMA UMA PELICULA PROTETORA DURADORA SOBRE A PELE INTACTA OU LESIONADA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DA PELE COM LÍQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS E FEZES POR ATÉ 72 HORAS. PRODUTO INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DE OSTOMIAS, FERIDAS, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, AO REDOR DE CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO, TRAQUEOSTOMIA, DERMATITE E IRRITAÇÃO DA PELE, PODE SER USADO POR BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS.  | UND | CONVATEC-ESSENTA SPRAY  | 200    | R\$ | 322,23 | trezentos e vinte e dois reais e três centavos              | R\$ | 64.446,00  | sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais                     |
| 48 | SOLUÇÃO DE PHMB, LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BETAINA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE COCERES SEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO PROPORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO, INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS, EMBALAGEM COM 350 ML.   | UND | PIELIANA                | 130    | R\$ | 333,57 | trezentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos | R\$ | 43.364,10  | quarenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos         |
| 49 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR N°14, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.  | UND | MEDIKA                  | 300    | R\$ | 94,80  | noventa e quatro reais e oitenta centavos                   | R\$ | 28.440,00  | vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais                                 |
| 50 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR N°16, CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES.  | UND | MEDIKA                  | 300    | R\$ | 94,80  | noventa e quatro reais e oitenta centavos                   | R\$ | 28.440,00  | vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais                                 |
| 52 | SONDA NASOENTERAL Nº 06 FR - CONFECCIONADA EM POLIURETANO BRANCO, RADIOPAÇO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIURETANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFÍNCTERES (CARDIA E PÍLORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | UND | MEDIKA                  | 520    | R\$ | 33,12  | trinta e três reais e doze centavos                         | R\$ | 17.222,40  | dezesete mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos                 |
| 53 | SONDA NASOENTERAL Nº 08 FR - CONFECCIONADA EM POLIURETANO BRANCO, RADIOPAÇO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIURETANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFÍNCTERES (CARDIA E PÍLORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | UND | MEDIKA                  | 120    | R\$ | 33,12  | trinta e três reais e doze centavos                         | R\$ | 3.974,40   | três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos               |
| 54 | SONDA NASOENTERAL Nº 12 FR - CONFECCIONADA EM POLIURETANO BRANCO, RADIOPAÇO, A SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOBBHOFF FLEXÍVEL, MALLEÁVEL, DURÁVEL E NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM O PH ÁCIDO DO ESTÔMAGO, COM CONECTOR PROXIMAL LILÁS EM DUPLA DERIVAÇÃO (FORMATO Y), QUE SE AJUSTA FACILMENTE EM TODOS DOS TIPOS DE EQUIPOS E PONTEIRAS DISTAIS DE PESO, OBTIDO PELA ADIÇÃO DE TUNGSTÊNIO EM PÓ AO POLIURETANO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUA SUSTENTAÇÃO NO ESTÔMAGO/DUODENO, E UM FIO GUIA DE CONDUÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOX. SEU CALIBRE FINO PERMITE O FECHAMENTO DOS ESFÍNCTERES (CARDIA E PÍLORO) DURANTE O TRAJETO. PRODUTO ESTÉRIL. | UND | MEDIKA                  | 1280   | R\$ | 33,12  | trinta e três reais e doze centavos                         | R\$ | 42.393,60  | quarenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos       |



|  |   |     |           |       |     |        |  |            |                     |   |
|--|---|-----|-----------|-------|-----|--------|--|------------|---------------------|---|
| 57   | TERMÔMERO DIGITAL DE GELEADERIA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - MEDIDA TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; POSSUI FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA; UMIDADE INTERNA; POSSUI BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO: °C OU °F; POSSUI BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; ATENDE AS PORTARIAS RDC 212/2004 (SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) E RDC 44/2009 (FARMÁCIAS, DROGARIAS E OUTROS); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F); FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F); RESOLUÇÃO: 0,1°C / °F; EXATIDÃO INT/EXT: ± 1°C DE 0°C A 50°C, ± 2°C PARA O RESTANTE DA FAIXA, FAIXA DA UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 1% UR; EXATIDÃO: ±5% UR; COMPRIMENTO DO CABO: ±2,40M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS 1,5V - AAA - (INCLUSAS) - DIMENSÕES: 86X64X22MM; PESO: 85G; | UND | INCO/TERM | 90    | R\$ | 345,99 | trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos | R\$        | 31.139,10           | trinta e um mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos |
| 58   | TORNEIRA DESCARTÁVEL (3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, BIODEGRÁVEL, MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS E CORPO DE TORNEIRA FORMANDO PEÇA ÚNICA, ESTERILIZADA A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, COM CONECTOR LOCK, COM VIA ADICIONAL DE PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÕES SIMULTÂNEAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MS - PROCEDÊNCIA NACIONAL.   | UND | GAMMA     | 16000 | R\$ | 2,04   | dois reais e quatro centavos                                 | R\$        | 32.640,00           | trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais              |
| <b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>   |   |     |           |       |     |        |  | <b>R\$</b> | <b>2.159.710,92</b> |   |
| dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e dez reais e noventa e dois centavos |   |     |           |       |     |        |  |            |                     |   |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (dez) dias úteis

DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



DATA: 27/09/23



PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ /CE

ATT. SR(A) PREGOEIRO(A).

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023-SESA/SRP

DATA E HORA DA ABERTURA: 27 DE SETEMBRO DE 2023 às 08:30hrs

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS, CASO SEJAMOS VENCEDO(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS QUE SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, ESTADO DO CEARÁ, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS. PELO QUE POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDOS AS REMUNERAÇÕES, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, PRETES, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LÚCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARAMOS TER CIÊNCIA SOBRE A FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO.

DECLARAMOS: SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, QUE ESTAMOS SOB O REGIME DE MICROEMPRESA - ME, CONFORME ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E QUE NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DESTA MESMO ARTIGO, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO, NO QUE COUBER, NOS ARTIGOS 42 A 49 DA CITADA LEI COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014. DECLARA-SE AINDA QUE, NÃO POSSUI NENHUMA RESTRIÇÃO FISCAL REFERENTE AOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESSE CERTAME, FICANDO CIENTE DE INFORMAR QUALQUER VICIO, PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, CONFORME MODELO CONSTANTE DOS ANEXOS DESTA EDITAL, BEM COMO, CONHECE E CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS O CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO PRODUTO A SER OFERTADO DO PRESENTE EDITAL E OBJETO A SER CONTRATADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO.

DECLARAMOS QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

PRazo DE ENTREGA DO OBJETO: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.  
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QUANT. | MARCA       | VALOR UNIT | VALOR TOTAL    |   |
|------|--|---------|--------|-------------|------------|----------------|---|
| 1    | ATADURA DE CREPOM 15CM X 1.80M.CONTENDO 13 FIOS/CM- PESO 19.5G.CONFEC-CIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM AS BOR-DAS DELIMITADAS ESLATICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EMFORMA CILINDRICA)ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOSDE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | ROLO    | 40.000 | ANAPOLIS    | R\$ 3,56   | R\$ 142.400,00 | três reais e cinquenta e seis centavos<br>cento e quarenta e dois mil e quatrocentos reais                                |
| 2    | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1.80M.CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13.0G.CON-FECCIONADA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COMASBORDAS DELIMITADAS ESLATICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE(EM FORMA CILÍNDRICA)ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | ROLO    | 49.240 | ANAPOLIS    | R\$ 4,32   | R\$ 212.716,80 | quatro reais e trinta e dois centavos<br>duzentos e doze mil, setecentos e dezessets reais e oitenta centavos             |
| 3    | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTAVEIS DE 25MM A 70MM DE DIAMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.   | UNID    | 3.200  | CONVATEC    | R\$ 100,00 | R\$ 320.000,00 | cem reais<br>trezentos e vinte mil reais  |
| 4    | BOLSA PARA COLOSTOMIA/IELOSTOMIA DE UMA PEÇA DRENAVELINFANTIL TRANSPARENT, RECORTÁVEL 8-50MM [5/16-2] DRENAVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE.TRANSPARENTES OU OPACA E RECORTAVEIS DE 25MM A 70MM DE DIAMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA COM UM CLIPE DE FECHAMENTO.  | UNID    | 480    | CONVATEC    | R\$ 187,32 | R\$ 89.913,60  | cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos<br>oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos |
| 6    | CREME DE BARREIRA.COMPOSTO POR AGUA,PARAFINA LIQUIDA,PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA,OLEATO DE GLICEROL,ALCOOL DE LANOLINA, ACIDO CÍTRICO,CITRATO DE MAGNESIO,CICLOMETICONE, GLICERINA,METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENGLICOL.INDICADO PARA CRIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVO.HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE RESSECADA EMBALAGEM COM 100G | UNID.   | 250    | COLOPLAST   | R\$ 309,28 | R\$ 77.320,00  | trezentos e nove reais e vinte e oito centavos<br>setenta e sete mil, trezentos e vinte reais                             |
| 8    | CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DECARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREG-NADO COM PRATA(25UG/CM2),ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXAADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRUDAR NO LEITO DA LESÃO), FLEXIVEL E RESIS-TENTE,SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICA,HIPDALERGENICA, ESTÉRILTAMANHO: 10.5 CM X 19 CM.           | UNID.   | 100    | VITAMEDICAL | R\$ 268,68 | R\$ 26.868,00  | duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos<br>vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais       |

*[Handwritten signature]*

|    |  |         |       |             |              |  |                |   |
|----|--|---------|-------|-------------|--------------|--|----------------|---|
| 9  | CURATIVO ANTIMICROBIANO NÃO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COMPRATA. COBERTURA NÃO ADESIVA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IM-PREGNADA COM IONS DE PRATA, FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ESPESSURA MINIMA 4MM, SEM ADESIVO. RECORTAVEL. NÃO DEIXA RE-SÍDUO NA LESÃO. TAMANHO: 15 CM X 15 CM.  | UNID.   | 150   | VITAMEDICAL | R\$ 368,04   | trezentos e sessenta e oito reais e quatro centavos          | R\$ 55.206,00  | cinquenta e cinco mil, duzentos e seis reais  |
| 11 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PARA FERIDAS COM BAIXA E MÉDIO EXUDATO 10X20CM  | UNIDADE | 120   | VITAMEDICAL | R\$ 112,48   | cento e doze reais e quarenta e oito centavos                | R\$ 13.497,60  | treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos                          |
| 12 | CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA 10 X 10 CM-CURATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE ESCARAS E FERIDAS EM GERAL, ALTA PERFORMANCE, ABSORVE MAIS EDURA MAIS, INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERA-DA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASOES E LACERACOES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ULCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ULCERAS DIABETI-GAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ULCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS, CAIXA COM 5 UNIDADES.  | CAIXA   | 200   | CASEX       | R\$ 243,68   | duzentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos  | R\$ 48.736,00  | quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais                                       |
| 13 | CURATIVO DE HIDROFIBRA. COBERTURA DE FIBRAS GELIFICANTES, COMPOSTO POR 100% DE NÃO TECIDO ESTÉRIL DE FIBRAS DE ALCÓOL POLIVINÍLICO (PVA) ENTRELACADAS QUE POSSUAM UM ALTO PODER DE ABSORÇÃO VERTICAL, REDUZINDO O RISCO DE MACERAÇÃO. CAPAZ DE PROMOVER A UMIDADE NECESSÁRIA, AUXILIANDO NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. PODE SER MANTIDO POR ATÉ 7 DIAS NA LESÃO. TAMANHO: 15 X 15 CM.  | UNID.   | 100   | CONVATEC    | R\$ 799,76   | setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos  | R\$ 79.976,00  | setenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais                                       |
| 14 | CURATIVO DO TIPO FILME TRANSPARENTE PARA PROFILAXIA. LLP 06 X 07   | UNID.   | 150   | VITAMEDICAL | R\$ 11,20    | onze reais e vinte centavos                                  | R\$ 1.680,00   | mil seiscentos e oitenta reais  |
| 15 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERA-DA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO, ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREEN-CHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 10X 10. | UNID.   | 200   | CONVATEC    | R\$ 506,12   | quinhentos e seis reais e doze centavos                      | R\$ 101.224,00 | cento e um mil, duzentos e vinte e quatro reais   |
| 16 | CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COMPONENTES ESTES QUE NÃO PERMITE A REFORMULAÇÃO DE BIOFILME, COBERTURA EFICAZ PARA TRATAMENTO DE LESÕES COM BIOFILME. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERA-DA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO, ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREEN-CHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15 X 15 | UNID.   | 100   | CONVATEC    | R\$ 936,52   | novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 93.652,00  | noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais                                     |
| 20 | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 10M  | UNID.   | 100   | SKYNUPPER   | R\$ 556,08   | quinhentos e cinquenta e seis reais e oito centavos          | R\$ 55.608,00  | cinquenta e cinco mil, seiscentos e oito reais  |
| 21 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NR 6-MASCULINO COLETOR PENIANO EM LATEX COM TUBO COM EXTENSÃO. A EXTREMIDADE DISTAL DO TUBO DEVERÁ SER COLOCADA EM RECEPTÁCULO (NÃO INCLUIDO) PARA COLETA DA URINA, ACOMPANHIA PRESERVATIVO.   | UNID    | 1.200 | MEDSONDA    | R\$ 8,52     | oito reais e cinquenta e dois centavos                       | R\$ 10.224,00  | dez mil, duzentos e vinte e quatro reais  |
| 22 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR COMPATÍVEL COM O APARELHO LIFE 400 CMOS DRAKE ADULTO, COM CONECTOR PRETO   | UNID    | 24    | CMOS DRAKE  | R\$ 5.973,12 | cinco mil, novecentos e setenta e três reais e doze centavos | R\$ 143.354,88 | cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos |
| 24 | EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, COM MATERIAL ATÓXICO E APIRÓGENICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ADAPTÁVEL PARA AMPOLAS DE SISTEMA FECHADO.   | UNID.   | 2.800 | SOLIDOR     | R\$ 6,00     | seis reais   | R\$ 16.800,00  | dezesseis mil e oitocentos reais  |

*[Assinatura]*

|    |  |          |         |            |              |   |                |  |
|----|--|----------|---------|------------|--------------|---|----------------|--|
| 45 | EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSAO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE,CAMARA GOTEJAMENTO TRANSPARENTE PROJETADA PARA 20ML,FILTROCOM POROS DE 200 MICRA,REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE,DUPLA CAMARAFLEXIVEL TRANSPARENTE,MEDINDO NO MINIMO 1,20M,LUER MACHO,ESTERIL,ATOXICO,APIROGENICO.EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICOCOM FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PÉTALA.CONSTANDO DADOSDE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,PRAZO DEVALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. | UNID.    | 2.000   | SOLIDOR    | R\$ 24,76    | vinte e quatro reais e setenta e seis centavos                | R\$ 49.520,00  | quarenta e nove mil, quinhentos e vinte reais  |
| 26 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO 119MM,ESTERIL,ATOXICO E APIROGENICO.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.PRODUTO DE USO UNICO.   | UNID.    | 26.000  | CRAL       | R\$ 7,16     | sete reais e dezesseis centavos                               | R\$ 186.160,00 | cento e oitenta e seis mil, cento e sessenta reais                                       |
| 27 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO 107MM,ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.PRODUTO DE USO UNICO.  | UNID.    | 11.000  | CRAL       | R\$ 6,76     | seis reais e setenta e seis centavos                          | R\$ 74.360,00  | setenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais   |
| 28 | ETER SULFURICO LIQUIDO INCOLOR,DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL.   | LITRO    | 160     | VIC PHARMA | R\$ 159,04   | cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos              | R\$ 25.446,40  | vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos              |
| 29 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO O COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM. FIO COM 90 CM DE COMPRIMENTO. ABSORVIVEL,SINTETICO.EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA.COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.TIPO DE ESTERELIZAÇÃO.APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE 1 UNIDADE.   | CAIXA    | 120     | SHALON     | R\$ 1.455,80 | mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos | R\$ 174.696,00 | cento e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais                          |
| 30 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,8CM FIOCOM 90 CM DE COMPRIMENTO.ABSORVIVEL,SINTETICO.EMBALAGEM ESTERIL EMPAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. COM DADOS DE IDENTIFI-CAÇÃO.TIPO DE ESTERELIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 ENVELOPES DE1 UNIDADE.   | CAIXA    | 160     | SHALON     | R\$ 1.455,80 | mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos | R\$ 232.928,00 | duzentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais                            |
| 31 | FIO PARA SUTURA EM ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM.COM FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO.ABSORVIVEL,SINTETICO.EMBALAGEMESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA.COM DADOSDE IDENTIFICAÇÃO.TIPO DE ESTERELIZAÇÃO.APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 EN-VELOPES DE 1 UNIDADE.  | CAIXA    | 80      | SHALON     | R\$ 1.334,80 | mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos      | R\$ 106.784,00 | cento e seis mil, seicentos e oitenta e quatro reais                                     |
| 36 | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85G  | UNID.    | 200     | CASEX      | R\$ 81,24    | oitenta e um reais e vinte e quatro centavos                  | R\$ 16.248,00  | dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais  |
| 38 | LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL TAMANHO 0.4MM. PARA PUNÇÃO DIGITAL (UNIDADE)  | UNIDA-DE | 119.000 | MEDIX      | R\$ 0,64     | sessenta e quatro centavos de real                            | R\$ 76.160,00  | setenta e seis mil, cento e sessenta reais   |
| 39 | PINCA DESCARTAVEL CHERRON.ESTERIL ATOXICA E APIROGENICA ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UNID.    | 6.600   | CRAL       | R\$ 10,00    | dez reais   | R\$ 66.000,00  | sessenta e seis mil reais  |
| 40 | PINCETA(ALMOTOLIA)MARROM 250ML-RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO OU SIMILAR,COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UNID.    | 230     | J. PROLAB  | R\$ 17,84    | dezessete reais e oitenta e quatro centavos                   | R\$ 4.103,20   | quatro mil, cento e três reais e vinte centavos  |
| 41 | PINCETA(ALMOTOLIA) MARROM 500ML-RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO OU SIMILAR,COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.  | UNID.    | 206     | J. PROLAB  | R\$ 23,44    | vinte e três reais e quarenta e quatro centavos               | R\$ 4.828,64   | quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos                 |
| 42 | PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ML-RECIPIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO OU SIMILAR,COM BICO RETO E TAMPA PROTETORA ACOPLADA.   | UNID.    | 196     | J. PROLAB  | R\$ 23,44    | vinte e três reais e quarenta e quatro centavos               | R\$ 4.594,24   | quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos                |
| 45 | POVIDINE DEGERMANTE-POLIVINIL PIRROLIDONA-IODO EM SOLUÇÃO DEGER-MANTE,UM COMPLEXO ESTAVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMEN-TE.E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTERIAS NÃO ESPORULADAS. VI-RUS E FUNGOS,EM ASSOCIAÇÃO COM TENSOATIVOS PROMOVE LIMPEZA E DESIN-FECCÃO DE MÃOS. BRAÇOS E CAMPO CIRÚRGICO 1000ML.  | UNID.    | 1.312   | VIC PHARMA | R\$ 192,92   | cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos        | R\$ 253.111,04 | duzentos e cinquenta e três mil, cento e onze reais e quatro centavos                    |
| 46 | POVIDINE TOPICO-SOLUÇÃO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA-IODO(PVP-10% DE IODO ATIVO).ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS,VIRUS.FUNGOS,SEM IRRITAR A PELE 1000ML.   | UNID.    | 812     | VIC PHARMA | R\$ 192,68   | cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos       | R\$ 156.456,16 | cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos |

